

Planilha1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20221103003

Prefeitura Municipal de Paragominas

RESPONSÁVEL :

NOME: ANTONIA MARIA CLEIA BRITO GONÇALVES

PROponente :

NOME: MEDIAL SERV.DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA-ME

ENDEREÇO : Trav. B. do Triunfo,Passagem N.S. das Graças nº55

BAIRRO : Marco CIDADE : Belém - PA

CNPJ : 02.221.289/0001-02

O município de Paragominas, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Paragominas.

Paragominas, 08 de Novembro de 2022

ANTONIA MARIA CLEIA BRITO GONÇALVES
Responsável



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
4E+05	AGITADOR DE KLINE 110 VOLTS			5,000 UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Frequência de velocidade ajustável: 0 - 230 rpm, Raio de agitação orbital: 22 mm, Dimensões aproximadas da plataforma: Largura: 224 mm, Altura: 80 mm, Profundidade: 152 mm.						
4E+05	BERÇO AQUECIDO COM SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE.	OLIDEF CZ		10,000 UNIDADE	29235,000	292350,00

Planilha

Especificação : Leito com altura fixa ou ajustável, Sistema de controle eletrônico microprocessado. Com Relógio Agarr, Modos de operação manual e automático (servo controle). Aquecedor giratório (180º). Laterais rebatíveis em acrílico, acionada com somente uma das mãos. Sistema de inclinação do leito com auxílio hidráulico ou elétrico. Balança integrada ao leito. Leito construído em material radio-transparente, com gaveta para cassetes para radiografia. Bivolt

4E+05 FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CÚPULAS	BARRFAB	3,000 UNIDADE	78565.000	235695,00
---	---------	---------------	-----------	-----------

Especificação : Possuir nível de luminosidade mínimo de 240.000 lux (120.000 lux por cúpula) Temperatura de cor: 3.000 - 6.000K consumo de energia entre 70 a 100VA, dissipação de calor sem a necessidade de uso de cooler, ventoinhas entre outros, Vida útil do LED: 50.000 horas. Voltagem 110volts ou bivolt

4E+05 FOCO CIRÚRGICO MÓVEL COM RODÍZIO	BARRFAB	12,000 UNIDADE	33119.900	397438,80
--	---------	----------------	-----------	-----------

Especificação : Composto por base móvel com rodízio, de cúpula única e bateria interna recarregável. Possuir nível de luminosidade mínimo de 110.000 lux, filtro cabrílico, sistema de alimentação por rede elétrica e sistema de emergência com carregador automático de bateria, consumo de energia entre 70 a 100VA, temperatura de cor entre 3.000 a 6.000K, sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável, sistemas de braços articuláveis para movimentos mínimos de torção e flexão, dissipação de calor sem a necessidade de uso de cooler, ventoinhas entre outros. Acessórios básicos: Cabo de alimentação conforme ABNT, com no mínimo 2m, lambadas sobressalentes, manopla esterilizável extra. Voltagem 110volts ou bivolt

4E+05 INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLÓGICO		2,000 UNIDADE	0,000	0,00
---	--	---------------	-------	------

Especificação : Para incubar e realizar leituras automáticas de indicadores biológicos 3 horas a 60°C para um resultado negativo de leitura de fluorescência em 3 horas, números de cavidades 12, temperatura incubação 60°C +/- 1°C, saída para impressora, voltagem 110volts.

4E+05 INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTOCONTÍDIDO		100,000 CAIXA	0,000	0,00
---	--	---------------	-------	------

Especificação : Para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo, suporta variações de 118°C a 137°C de temperatura, com tempo de leitura final em 3 horas. CAIXA COM 50 UNIDADES

4E+05 MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA FORMATO TIPO T	BARRFAB	3,000 UNIDADE	81648.000	244944,00
--	---------	---------------	-----------	-----------

Especificação : Chapa de aço inox, 120x120, 100x100, 80x80, 60x60, 40x40, 30x30, 20x20, 10x10, 5x5, 2,5x2,5, 1,25x1,25, 0,625x0,625, 0,3125x0,3125, 0,15625x0,15625, 0,078125x0,078125, 0,0390625x0,0390625, 0,01953125x0,01953125, 0,009765625x0,009765625, 0,0048828125x0,0048828125, 0,00244140625x0,00244140625, 0,001220703125x0,001220703125, 0,0006103515625x0,0006103515625, 0,00030517578125x0,00030517578125, 0,000152587890625x0,000152587890625, 0,0000762939453125x0,0000762939453125, 0,00003814697265625x0,00003814697265625, 0,000019073486328125x0,000019073486328125, 0,0000095367431640625x0,0000095367431640625, 0,00000476837158203125x0,00000476837158203125, 0,000002384185791015625x0,000002384185791015625, 0,0000011920928955078125x0,0000011920928955078125, 0,00000059604644775390625x0,00000059604644775390625, 0,000000298023223876953125x0,000000298023223876953125, 0,0000001490116119384765625x0,0000001490116119384765625, 0,00000007450580596923828125x0,00000007450580596923828125, 0,000000037252902984619140625x0,000000037252902984619140625, 0,0000000186264514923095703125x0,0000000186264514923095703125, 0,00000000931322574615478515625x0,00000000931322574615478515625, 0,000000004656612873077392578125x0,000000004656612873077392578125, 0,0000000023283064365386962890625x0,0000000023283064365386962890625, 0,00000000116415321826934814453125x0,00000000116415321826934814453125, 0,000000000582076609134674072265625x0,000000000582076609134674072265625, 0,0000000002910383045673370361328125x0,0000000002910383045673370361328125, 0,00000000014551915228366851806640625x0,00000000014551915228366851806640625, 0,000000000072759576141834259033203125x0,000000000072759576141834259033203125, 0,0000000000363797880709171295166015625x0,0000000000363797880709171295166015625, 0,00000000001818989403545856475830078125x0,00000000001818989403545856475830078125, 0,000000000009094947017729282379150390625x0,000000000009094947017729282379150390625, 0,0000000000045474735088646111895751953125x0,0000000000045474735088646111895751953125, 0,00000000000227373675443230559478759765625x0,00000000000227373675443230559478759765625, 0,000000000001136868377216152797393798828125x0,000000000001136868377216152797393798828125, 0,0000000000005684341886080763986968994140625x0,0000000000005684341886080763986968994140625, 0,00000000000028421709430403819934844970703125x0,00000000000028421709430403819934844970703125, 0,000000000000142108547152019099674224853515625x0,000000000000142108547152019099674224853515625, 0,0000000000000710542735760095498371124267578125x0,0000000000000710542735760095498371124267578125, 0,00000000000003552713678800477491855621337890625x0,00000000000003552713678800477491855621337890625, 0,000000000000017763568394002387459278106689453125x0,000000000000017763568394002387459278106689453125, 0,0000000000000088817841970011937296390533447265625x0,0000000000000088817841970011937296390533447265625, 0,00000000000000444089209850059686481952667236328125x0,00000000000000444089209850059686481952667236328125, 0,000000000000002220446049250298432409763336181640625x0,000000000000002220446049250298432409763336181640625, 0,0000000000000011102230246251492162048816680908203125x0,0000000000000011102230246251492162048816680908203125, 0,00000000000000055511151231257460810244083340541015625x0,00000000000000055511151231257460810244083340541015625, 0,000000000000000277555756156287304051220416702705078125x0,000000000000000277555756156287304051220416702705078125, 0,0000000000000001387778780781436520256102083513525390625x0,0000000000000001387778780781436520256102083513525390625, 0,00000000000000006938893903907182601280510417567626953125x0,00000000000000006938893903907182601280510417567626953125, 0,000000000000000034694469519535913006402552087838134765625x0,000000000000000034694469519535913006402552087838134765625, 0,0000000000000000173472347597679565032012760439190673828125x0,0000000000000000173472347597679565032012760439190673828125, 0,00000000000000000867361737988397775160063802195953369140625x0,00000000000000000867361737988397775160063802195953369140625, 0,000000000000000004336808689941988875800319010979766845703125x0,000000000000000004336808689941988875800319010979766845703125, 0,000000000000000002168404344970994437900159505489883428515625x0,000000000000000002168404344970994437900159505489883428515625, 0,0000000000000000010842021724854972189500797527449417142578125x0,0000000000000000010842021724854972189500797527449417142578125, 0,000000000000000000542101086242748609475039876372470857142890625x0,000000000000000000542101086242748609475039876372470857142890625, 0,000000000000000000271050543121374304737519938186235428571428125x0,000000000000000000271050543121374304737519938186235428571428125, 0,0000000000000000001355252715606871523687599690931177142857140625x0,0000000000000000001355252715606871523687599690931177142857140625, 0,00000000000000000006776263578034357618437998454655885714285703125x0,00000000000000000006776263578034357618437998454655885714285703125, 0,000000000000000000033881317890171788092189992273279428571428515625x0,000000000000000000033881317890171788092189992273279428571428515625, 0,00000000000000000001694065894508589404609499613663971428571428125x0,00000000000000000001694065894508589404609499613663971428571428125, 0,000000000000000000008470329472542947023047499068319857142857140625x0,000000000000000000008470329472542947023047499068319857142857140625, 0,0000000000000000000042351647362714735115237495341599285714285703125x0,0000000000000000000042351647362714735115237495341599285714285703125, 0,00000000000000000000211758236813573675576187476707996428571428515625x0,00000000000000000000211758236813573675576187476707996428571428515625, 0,0000000000000000000010587911840678683777809373835399821428571428125x0,0000000000000000000010587911840678683777809373835399821428571428125, 0,00000000000000000000052939559203393418889046869176999107142857140625x0,00000000000000000000052939559203393418889046869176999107142857140625, 0,000000000000000000000264697796016967094445234345884995535714285703125x0,000000000000000000000264697796016967094445234345884995535714285703125, 0,0000000000000000000001323488980084835472227621729424977678571428515625x0,0000000000000000000001323488980084835472227621729424977678571428515625, 0,000000000000000000000066174449004241773611381086471248883928571428125x0,000000000000000000000066174449004241773611381086471248883928571428125, 0,0000000000000000000000330872245021208868056905432356244419642857140625x0,0000000000000000000000330872245021208868056905432356244419642857140625, 0,00000000000000000000001654361225106044340284527161781222098214285703125x0,00000000000000000000001654361225106044340284527161781222098214285703125, 0,000000000000000000000008271806125530221701422635808906110491071428515625x0,000000000000000000000008271806125530221701422635808906110491071428515625, 0,00000000000000000000000413590306276511085071131790445305524553571428125x0,00000000000000000000000413590306276511085071131790445305524553571428125, 0,0000000000000000000000020679515313825554253556589522265276277857140625x0,0000000000000000000000020679515313825554253556589522265276277857140625, 0,00000000000000000000000103397576569127771267782947611326381388928571428125x0,00000000000000000000000103397576569127771267782947611326381388928571428125, 0,000000000000000000000000516987882845638856338914738056631906944142857140625x0,000000000000000000000000516987882845638856338914738056631906944142857140625, 0,000000000000000000000000258493941422819442816957369028315953472071428515625x0,000000000000000000000000258493941422819442816957369028315953472071428515625, 0,00000000000000000000000012924697071140972140847868451415797673603571428125x0,00000000000000000000000012924697071140972140847868451415797673603571428125, 0,000000000000000000000000064623485355704860704239342257078988368017857140625x0,000000000000000000000000064623485355704860704239342257078988368017857140625, 0,000000000000000000000000032311742677852430352119671128539494434008928571428125x0,000000000000000000000000032311742677852430352119671128539494434008928571428125, 0,0000000000000000000000000161558713389262151760598355642697472170044642857140625x0,0000000000000000000000000161558713389262151760598355642697472170044642857140625, 0,0000000000000000000000000080779356694631075880299177821348736085022321428571428125x0,0000000000000000000000000080779356694631075880299177821348736085022321428571428125, 0,000000000000000000000000004038967834731553794014958891067436804251116071428515625x0,000000000000000000000000004038967834731553794014958891067436804251116071428515625, 0,00000000000000000000000000201948391736577689700747944553371840212555803571428125x0,00000000000000000000000000201948391736577689700747944553371840212555803571428125, 0,000000000000000000000000001009741958682888448503739722766859201062779017857140625x0,000000000000000000000000001009741958682888448503739722766859201062779017857140625, 0,00000000000000000000000000050487097934144422425186986138342960053139508928571428125x0,00000000000000000000000000050487097934144422425186986138342960053139508928571428125, 0,0000000000000000000000000002524354896707221121259349306917148002656975491428515625x0,0000000000000000000000000002524354896707221121259349306917148002656975491428515625, 0,0000000000000000000000000001262177448353610560629674653458574001328487747071428125x0,0000000000000000000000000001262177448353610560629674653458574001328487747071428125, 0,00000000000000000000000000006310887241768052803148373267292870006642438735357140625x0,00000000000000000000000000006310887241768052803148373267292870006642438735357140625, 0,00000000000000000000000000003155443620884026401574186633646435003321219367678571428125x0,00000000000000000000000000003155443620884026401574186633646435003321219367678571428125, 0,000000000000000000000000000015777218104420132007870933168232175016606096838392857140625x0,000000000000000000000000000015777218104420132007870933168232175016606096838392857140625, 0,000000000000000000000000000007888609052210066003935466584116087508330304819196428515625x0,000000000000000000000000000007888609052210066003935466584116087508330304819196428515625, 0,00000000000000000000000000000394430452610503300196773329205804375416515240959821428125x0,00000000000000000000000000000394430452610503300196773329205804375416515240959821428125, 0,0000000000000000000000000000019721522630525165009838666460290218770775762047991071428515625x0,0000000000000000000000000000019721522630525165009838666460290218770775762047991071428515625, 0,00000000000000000000000000000098607613152625825004919332230145109353878810239955357140625x0,00000000000000000000000000000098607613152625825004919332230145109353878810239955357140625, 0,000000000000000000000000000000493038065763129125002459661150725546769394051199778571428125x0,000000000000000000000000000000493038065763129125002459661150725546769394051199778571428125, 0,0000000000000000000000000000002465190328815645625001228305753627733846970255998892857140625x0,000000000000000000000000000000246519032881

Especificação : Microscópio Biológico Binocular com Objetivas Planacromáticas e Óptica Infinit, Vientem 110volts. Composição: 1 estativa e base compensada (corpo), 1 tubo binocular 30º (tipo Siedentopf), 2 oculares WF- 10 x - com campo de 22mm, 1 objetiva PL 4 x planacromática, 1 objetiva PL 10 x planacromática, 1 objetiva PL 20 x planacromática, 1 objetiva PL 40 x planacromática (retrátil), 1 objetiva PL 100 x planacromática (retrátil de imersão), 1 lâmpada de planacromática (retrátil), 1 condensador tipo ABBE 1,25 N.A. (campo claro) LED, que proporciona melhor visualização.

Antonia M. Guzmán
Suplente
Mat. 100119
Presidencia Municipal de Guaymas



de aproximadamente: 250 litros; Tipo/Número de portas Volante Central (2PVC) Potência: Tensão: 220V Trifásico; Funcionamento: Através de gerador elétrico acoplado (E) secagem: Bomba de vácuo de 1,5 HP 220/380V 60Hz trifásica Instrumentos: Manôvacuômetro indicativo para pressão no vácuo na câmara interna Instrumentos: Manômetro indicativo para pressão na câmara externa (jaqueta) e gerador de vapor Instrumentos: Dois sensores de temperatura tipo PT-100 classe 1 Instrumentos: Dois transmissores de pressão Acompanha bomba de vácuo Possibilita a configuração da temperatura de trabalho de 90 a 135°C e tempo de esterilização e secagem de até 99 minutos cada. Possui entrada analógica para sensor PT-100, para controle da pressão do gerador/câmara externa e para controle de pressão e vácuo da câmara interna. Possui entradas digitais sendo porta aberta, pressostato e controle de nível do gerador de vapor alto e baixo. CÂMARAS - Câmara interna em formato retangular com capacidade de aproximadamente 200 litros, fabricada em aço inoxidável AISI 316L, e câmara externa fabricada em aço inoxidável AISI 304. Possui isolamento térmico, através de camadas de lã de rocha aluminizada, e revestimento

Condições de pagamento :	CONFORME EMPENHO		Total : 2079427,80
Prazo de entrega :	45 A 60 DIAS		
Validade da proposta :	60	dias.	
Valor por extenso :	Dois milhões, setenta e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos .		

Data : 10/11/2022

carimbo e assinatura

Germano Santos
(91) 3226-6200 / 3348-6200
Medial Service LTDA



Antonia Maria da Conceição
Suplemento
Mat.: 015/09
Prefeitura Municipal de Paragominas

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Paragominas
Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas



Antônia Maria da B. Gonçalves
Suprimentos e Armazenado
Mat: 10.57109
Prefeitura Municipal de Paragominas

Prezado(s) Senhor(es),

POLYMEDH.EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 63.848.345/0001-10, Inscrição Estadual nº. 15.160.219-0, Inscrição Municipal nº. 53477-0, sediada na Avenida Presidente Vargas, nº 4547 Bairro Iaketama, Castanhal-PA, CEP 68.745-000, vem apresentar Cotação de Preços para o Material especificado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AGITADOR DE KLINE 110 VOLTS -Especificação : Frequência de velocidade ajustável: 0 - 230 rpm, Raio de agitação orbital: 22 mm, Dimensões aproximadas da plataforma: Largura: 224 mm, Altura: 80 mm, Profundidade: 152 mm.	UND	5	BENFER	R\$ 2.967,80	R\$ 14.839,00
2	BERÇO AQUECIDO COM SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE.- Especificação : Leito com altura fixa ou ajustável, Sistema de controle eletrônico microprocessado. Com Relógio Apgar, Modos de operação manual e automático (servo controle). Aquecedor giratório (180º). Laterais rebatíveis em acrílico, acionada com somente uma das mãos. Sistema de inclinação do leito com auxílio hidráulico ou elétrico. Balança integrada ao leito. Leito construído em material radio-transparente, com gaveta para cassette para radiografia. Bivolt	UND	10	OLIDEF	R\$ 24.224,20	R\$ 242.242,00
3	FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CÚPULAS - Especificação : Possuir nível de luminosidade mínimo de 240.000 lux (120 000 lux por cúpula) Temperatura de cor: 3.000 - 6.000K consumo de energia entre 70 a 100VA, dissipação de calor sem a necessidade de uso de cooler, ventoinhas entre outros, Vida útil do LED: 50 000 horas. Voltagem 110volts ou bivolt	UND	3	MEDLIGHT	R\$ 50.380,00	R\$ 151.140,00
4	FOCO CIRURGICO MÓVEL COM RODÍZIO -Especificação: Composto por base móvel com rodízio, de cúpula única e bateria interna recarregável. Possuir nível de luminosidade mínimo de 110.000 lux, filtro calorico, sistema de alimentação por rede elétrica e sistema de emergência com carregador automático de bateria, consumo de energia entre 70 a 100VA, temperatura de cor entre 3.000 a 6.000K, sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável, sistemas de braços articuláveis para movimentos mínimos de torção e flexão, dissipação de calor sem a necessidade de uso de cooler, ventoinhas entre outros. Acessórios básicos: Cabo de alimentação conforme ABNT, com no mínimo 2 m, lambadas sobressalentes, manopla esterilizável extra. Voltagem 110volts ou bivolt	UND	12	DELTA LIFE	R\$ 12.540,00	R\$ 150.480,00
5	INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLÓGICO -Especificação : Para incubar e realizar leituras automáticas de indicadores biológicos 3 horas a 60°C para um resultado negativo de leitura de fluorescência em 3 horas, números de cavidades 12, temperatura incubação 60°C +/- 1°C, saída para impressora, voltagem 110volts.	UND	2	CRISTOFOLI	R\$ 9.427,00	R\$ 18.854,00

6	INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTOCONTIDO -Especificação : Para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo, suporta variações de 118°C a 137°C de temperatura, com tempo de leitura final em 3 horas. CAIXA COM 50 UNIDADES	UND	100	ATTEST	R\$ 3.517,80	R\$ 351.780,00
7	MESA CIRURGICA ELETRICA FORMATO TIPO T -Especificação : Chapa de aço 1020, com acabamento em pintura epóxi, sistema de fixação e movimentação realizado através de rodízios e pés retráteis, CHASSI confeccionado em chapas de aço, com reforço estrutural, possui acabamento em pintura epóxi e carenagem em aço inoxidável, Com Régua Laterais para colocação de acessórios fabricadas em aço inoxidável TAMPO Radiotransparente dividido em 5 seções, sendo elas: cabeça, renal, dorso, assento e perneiras bipartidas. Movimentos de elevação através de sistema elétrico acionado por controle remoto a cabo e controle de emergência no próprio painel da mesa. Capacidade de Carga de até 300 Kg. MOVIMENTOS: Elevação e Regresso do Tampo Trendelemburg e Reverso Trendelemburg Elevação e Regresso do Dorso Lateral Esquerda e Direita Rotação de Perneiras e Inversão de Perneiras com Cabeceira Deslizamento Longitudinal. Acessórios: 01 jogo de colchonetes injetados em PU, 01 arco de narcose, 01 par de portas coxas, 01 par de suporte de braço, 01 par e ombreira. Dimensões aproximadas: Comprimento 2040 mm, Largura 550mm, Altura Máxima 1070mm, Altura mínima 750mm.	UND	3	MECSUL	R\$ 79.970,00	R\$ 239.910,00
8	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR. -Especificação : Microscópio Biológico Binocular com Objetivas Planacromáticas e Óptica Infindit, Voltagem 110volts. Composição: 1 estativa e base compensada (corpo), 1 tubo binocular 30° (tipo Siedentopf), 2 oculares WF 10 x - com campo de 22mm, 1 objetiva PL 4 x planacromática, 1 objetiva PL 10 x planacromática, 1 objetiva PL 20 x planacromática, 1 objetiva PL 40 x planacromática (retrátil), 1 objetiva PL 100 x planacromática (retrátil de inersão), 1 lâmpada de LED, que proporciona melhor visualização, 1 condensador tipo ABBE 1,25 N.A. (campo claro)	UND	5	LABOR IMPORT	R\$ 5.083,17	R\$ 25.415,85


 Antonia Maria de Jesus B. Gonçalves
 Suplente do Almoxtarifado
 Mat. 0015109
 Prefeitura Municipal de Paragominas



MONITOR MULTIPARAMÉTRICO.-Especificação : Com bateria interna de lítio, com duração mínima de 90 minutos, para a monitoração dos seguintes parâmetros de sinais vitais: ECG, RESP(Respiração), SpO2 (Saturação de Oxigênio), PNI (Pressão Não Invasiva), e Debito Cardíaco; Deve possuir tela de cristal líquido colorida (LCD), sensível ao toque de, pelo menos, 12" (polegadas); Deve permitir a execução de cálculos de parâmetros hemodinâmicos; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros; Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 72 horas; Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo), com níveis de prioridade estabelecidos (baixo, médio e alto), e alarmes funcionais relacionados ao monitor multiparamétrico e seus acessórios (sensor, eletrodo solto, etc.); Deve permitir possibilidade de conexão a uma Central de Monitorização. Especificações dos parâmetros de monitoração: ECG - Monitoração em 7(sete) Derivações (I, II, III, aVF, aVR, aVL, V) através de um Cabo de ECG 5 (cinco) Vias; Faixa de medida da Frequência Cardíaca (FC): 30 a 300 BPM; Resolução da medida de FC: 1 BPM; Deve possuir Análise de Segmento ST em todas as derivações de forma simultânea; Deve possuir pelo menos 20 Análises de Arritmias (Assistolia, Fibrilação Ventricular / Taquicardia Ventricular, Fib Atrial, etc.), detecção automática de pulso Marca Passo Deve monitorizar parâmetros de QT/QTc com cabo de 05 ou 06 vias no máximo Acessórios: 1 (um) cabo de ECG 5 ou 6 vias. RESPIRAÇÃO - Aquisição da Frequência Respiratória através da tecnologia de Impedância Transtorácica, feita pelo Cabo de ECG; Faixa de medida da Frequência Respiratória (FR): 6 a 100 RPM; Resolução da medida da FR: 1 RPM; Deve permitir ajuste de alarme de apnéia. OXIMETRIA (SpO2)- Deve apresentar a curva pletismográfica, índice de perfusão com indicação gráfica e numérica; Faixa de Saturação de O2 (SpO2): Precisão entre 70% e 100% de saturação, não superior a $\pm 2\%$ Resolução da medida de SpO2: 1%; Faixa da Frequência de Pulso (FP): 40 a 300BPM; Resolução da medida de FP: 1 BPM; Acessórios: 1 (uma) extensão para sensor de SpO2, 1 (um) sensor de SpO2 reutilizável adulto; PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) - Deve apresentar os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS) de no mínimo 40 a 260mmHg Pressão Arterial Diastólica (PAD) de no mínimo 25 a 220 mmHg e Pressão Arterial Média (PAM) de no mínimo 25 a 250 mmHg; Modos de medida: Manual, Automático Acessórios: 1 (uma) extensões de ar 1 (uma) braçadeira adulto. TEMPERATURA-Deve possuir, pelo menos, 2 (dois) canais de monitoração da Temperatura; Deve permitir a medida da Temperatura por sensor aderido na pele do paciente, ou através de cavidades, como o esôfago ou reto; Faixa de medida da Temperatura: 5 a 45 °C; Acessórios: 1 (um) sensor de temperatura reutilizável tipo pele. VOLTAGEM: BIVOLT	UND	45	BIOLIGHT	R\$ 40.671,95	R\$ 1.830.237,75
--	-----	----	----------	---------------	------------------

Antônio de Paula B. Gonçalves
 Suplente de Alvararjado
 Matr. 015109
 Prefeitura Municipal de Paragominas



10 VENTILADOR PULMONAR -Especificação : Ventilador mecânico pulmonar micro processado, com monitor gráfico de ventilação LCD colorido sensível ao toque de no mínimo 12 polegadas, destinado a beira de leito e ao transporte intra-hospitalar de pacientes adultos, pediátricos, neonatais deve operar por rede de O2 e gerar o ar comprimido por sistema de turbina ou compressor. O ventilador deve possuir sistema de auto teste para detecção de vazamento no circuito respiratório bem como medir a complacência e resistência do circuito para maior precisão de leitura deve possuir válvulas (insp e exp) protegidas internas ao equipamento totalmente autoclaváveis inclusive sensor de fluxo. Deve possuir sensibilidade de disparo a fluxo ou a pressão com resolução de 0,1 em toda a faixa ciclagem a fluxo com ajuste manual nas modalidades que permitam a utilização da pressão de suporte blender de O2 eletrônico interno, com calibração do sensor de oxigênio deve possuir ajuste de alarmes e deverá armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados quando o aparelho for colocado em modo de espera (stand-by) deve possuir baterias internas com autonomia de no mínimo 120 minutos, braço articulado para suporte do circuito respiratório. Modos de ventilação: VCV - ventilação controlada a volume PCV - ventilação controlada a pressão PRVC - pressão controlada com garantia de volume corrente SIMV/VC+PS - ventilação mandatória intermitente sincronizada a volume controlado, associada a pressão de suporte SIMV/PC+PS - ventilação mandatória intermitente sincronizada a pressão controlada, associada a pressão de suporte APRV - ventilação com dois níveis de pressão (pressão baixa e pressão alta), ciclada a tempo e que permite ao paciente respirar em qualquer fase do ciclo respiratório, permitindo também a inversão de relação i.e BINIVEL, BILEVEL, DUOLEVEL ou similar - ventilação com dois níveis de pressão (pressão baixa e pressão alta), ciclada a tempo e que permite ao paciente respirar em qualquer fase do ciclo respiratório, associada a pressão de suporte PSV - pressão de suporte e ventilação não invasiva nos modos PSV e PC, com compensação automática de fuga. Modo ou recurso ventilatório que permita a transição automática entre a ventilação espontânea e controlada de acordo com a mecânica pulmonar do paciente. HFNC - terapia de alto fluxo ventilador com ajuste do tempo de apnéia de até 60 segundos, com ventilação de back-up, nos modos espontâneos, que permita o retorno automático do paciente ao modo de origem caso o paciente apresente estímulo respiratório novamente. Ajustes: frequência respiratória programável de no mínimo 01 até 100 ciclos/min tempo inspiratório programável de no mínimo 0,2 a 5,0 segundos volume corrente programável de no mínimo 20ml até 2000 ml fluxo inspiratório livre de no mínimo 200 l/min pressão controlada inspiratória ajustável de no mínimo 05 a 60 cmh2o pressão de suporte até 60 cmh2o PEEP/CPAP até 40 cmh2o concentração de oxigênio: 21 - 100% pausa inspiratória e expiratória manual de até 2,0 segundos no mínimo e ajuste de alarmes. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. ACESSÓRIOS: 02 (dois) circuito reutilizável adulto/pediátrico/neonatal 01 (um) kit de válvula expiratória adicional ou cassete respiratório completo: 01 (uma) base móvel com rodízios e freios 01 (um) braço articulado com suporte para os circuitos respiratórios 01 (um) mangueira para O2. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 VOLTS ou Bivolt	UND	10	COMEN	R\$ 91.608,84	R\$ 916.088,40
TOTAL GERAL					R\$ 3.940.987,00

Validade da Proposta: 30 dias.

Prazo de entrega: A Combinar

Prazo de pagamento: 30 dias

Castanhal/PA, em 17 de Novembro de 2022.

POLYMEDH
EIRELI:6384
834500011
0

Assinado de forma digital por
POLYMEDH EIRELI:63848345000110
DN: c=BR, st=PA, l=CASTANHAL,
o=ICP-Brasil, ou=000001009698701,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,
ou=AC SERASA RFB v5,
ou=21286543000197,
ou=PRESENCIAL, cn=POLYMEDH
EIRELI:63848345000110
Dados: 2022.11.17 18:30:20 -03'00'

Antonia M^{te} Cléia B. Gonçalves
Suplente e Autorizada
Mat.: 15409
Prefeitura Municipal de Paragominas



Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20221103003

Prefeitura Municipal de Paragominas

RESPONSÁVEL :

NOME: ANTONIA MARIA CLEIA BRITO GONÇALVES

PROPOSTANTE :

NOME: F. CARDOSO & CIA LTDA

ENDEREÇO : RUA JOÃO NUNES DE SOUZA, N 125

BAIRRO : AGUAS BRANCAS CIDADE : Ananindeua - PA

CNPJ : 04.949.905/0001-63

CGF : 15.051.578-2

Antonia Maria Cleia Brito Gonçalves
Suprimentos e Equipamentos
Mar: 10/10/2022
Prefeitura Municipal de Paragominas

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	AGITADOR DE KLINE 110 VOLTS <i>Especificação : Frequência de velocidade ajustável: 0 - 230 rpm, Raio de agitação orbital: 22 mm, Dimensões aproximadas da plataforma: Largura: 224 mm, Altura: 80 mm, Profundidade: 152 mm.</i>	BENFER	5,000	UNIDADE	1500,000	7500,00
2	BERÇO AQUECIDO COM SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. <i>Especificação : Leito com altura fixa ou ajustável, Sistema de controle eletrônico microprocessado. Com Relógio Apgar, Modos de operação manual e automático (servo controle). Aquecedor giratório (180º). Laterais rebatíveis em acrílico, acionada com somente uma das mãos. Sistema de inclinação do leito com auxílio hidráulico ou elétrico. Balança integrada ao leito. Leito construído em material radio-transparente, com gaveta para cassete para radiografia. Bivolt</i>	OLIDEF	10,000	UNIDADE	29509,000	295090,00
3	FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CÚPULAS <i>Especificação : Possuir nível de luminosidade mínimo de 240.000 lux (120 000 lux por cúpula) Temperatura de cor: 3.000 - 6.000K consumo de energia entre 70 a 100VA, dissipação de calor sem a necessidade de uso de cooler, ventoinhas entre outros, Vida útil do LED: 50 000 horas. Voltagem 110volts ou bivolt</i>	INPROMED	3,000	UNIDADE	30000,000	90000,00
4	FOCO CIRURGICO MÓVEL COM RODÍZIO <i>Especificação : Composto por base móvel com rodízio, de cúpula única e bateria interna recarregável. Possuir nível de luminosidade mínimo de 110.000 lux, filtro calorífico, sistema de alimentação por rede elétrica e sistema de emergência com carregador automático de bateria, consumo de energia entre 70 a 100VA, temperatura de cor entre 3.000 a 6.000K, sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável, sistemas de braços articuláveis para movimentos mínimos de torção e flexão, dissipação de calor sem a necessidade de uso de cooler, ventoinhas entre outros. Acessórios básicos: Cabo de alimentação conforme ABNT, com no mínimo 2 m, lambdas sobressalentes, manopla esterilizável extra. Voltagem 110volts ou bivolt</i>	MINDRAY	12,000	UNIDADE	5000,000	60000,00
5	INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLÓGICO <i>Especificação : Para incubar e realizar leituras automáticas de indicadores biológicos 3 horas a 60°C para um resultado negativo de leitura de fluorescência em 3 horas, números de cavidades 12, temperatura incubação 60°C +/- 1°C, saída para impressora, voltagem 110volts.</i>	SISPACK	2,000	UNIDADE	1250,000	2500,00
6	INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTOCONTIDO	SISPACK	100,000	CAIXA	750,000	75000,00



Especificação : Para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo, suporta variações de 118°C a 137°C de temperatura, com tempo de leitura final em 3 horas. CAIXA COM 50 UNIDADES

7	MESA CIRURGICA ELETRICA FORMATO TIPO T	LANZA	3,000	UNIDADE	15000,000	45000,00
---	--	-------	-------	---------	-----------	----------

Especificação : Chapa de aço 1020, com acabamento em pintura epóxi, sistema de fixação e movimentação realizado através de rodízios e pés retráteis, CHASSI confeccionado em chapas de aço, com reforço estrutural, possui acabamento em pintura epóxi e carenagem em aço inoxidável, Com Régua Lateral para colocação de acessórios fabricadas em aço inoxidável TAMPO Radiotransparente dividido em 5 seções, sendo elas: cabeça, renal, dorso, assento e perneiras bipartidas. Movimentos de elevação através de sistema elétrico acionado por controle remoto a cabo e controle de emergência no próprio painel da mesa. Capacidade de Carga de até 300 Kg. MOVIMENTOS: Elevação e Regresso do Tampo Trendelemburg e Reverso Trendelemburg Elevação e Regresso do Dorso Lateral Esquerda e Direita Rotação de Perneiras e Inversão de Perneiras com Cabeceira Deslizamento Longitudinal. Acessórios: 01 jogo de colchonetes injetados em PU, 01 arco de narcose, 01 par de portas coxas, 01 par de suporte de braço, 01 par e ombreira. Dimensões aproximadas: Comprimento 2040mm, Largura 550mm, Altura Máxima 1070mm, Altura mínima 750mm.

	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR.	OPTON	5,000	UNIDADE	3500,000	17500,00
--	----------------------------------	-------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Microscópio Biológico Binocular com Objetivas Planacromáticas e Óptica Infinit, Voltagem 110volts. Composição: 1 estativa e base compensada (corpo), 1 tubo binocular 30° (tipo Siedentopf), 2 oculares WF 10 x - com campo de 22mm, 1 objetiva PL 4 x planacromática, 1 objetiva PL 10 x planacromática, 1 objetiva PL 20 x planacromática, 1 objetiva PL 40 x planacromática (retrátil), 1 objetiva PL 100 x planacromática (retrátil de imersão), 1 lâmpada de LED, que proporciona melhor visualização, 1 condensador tipo ABBE 1,25 N.A. (campo claro)

9	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO.	DIXTAL	45,000	UNIDADE	6289,000	283005,00
---	---------------------------	--------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Com bateria interna de lítio, com duração mínima de 90 minutos, para a monitoração dos seguintes parâmetros de sinais vitais: ECG, RESP(Respiração), SpO2 (Saturação de Oxigênio), PNI (Pressão Não Invasiva), e Débito Cardíaco; Deve possuir tela de cristal líquido colorida (LCD), sensível ao toque de, pelo menos, 12"(polegadas); Deve permitir a execução de cálculos de parâmetros hemodinâmicos; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros; Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 72 horas; Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo), com níveis de prioridade estabelecidos (baixo, médio e alto), e alarmes funcionais relacionados ao monitor multiparamétrico e seus acessórios (sensor, eletrodo solto, etc.); Deve permitir possibilidade de conexão a uma Central de Monitorização. Especificações dos parâmetros de monitoração: ECG - Monitoração em 7(sete) Derivações (I, II, III, aVF, aVR, aVL, V) através de um Cabo de ECG 5 (cinco) Vias; Faixa de medida da Frequência Cardíaca (FC): 30 a 300 BPM; Resolução da medida de FC: 1 BPM; Deve possuir Análise de Segmento ST em todas as derivações de forma simultânea; Deve possuir pelo menos 20 Análises de Arritmias (Assistolia, Fibrilação Ventricular / Taquicardia Ventricular, Fib Atrial, etc.), detecção automática de pulso Marca Passo Deve monitorizar parâmetros de QT/QTc com cabo de 05 ou 06 vias no máximo Acessórios: 1 (um) cabo de ECG 5 ou 6 vias. RESPIRAÇÃO - Aquisição da Frequência Respiratória através da tecnologia de Impedância Transtorácica, feita pelo Cabo de ECG; Faixa de medida da Frequência Respiratória (FR): 6 a 100 RPM; Resolução da medida da FR: 1 RPM; Deve permitir ajuste de alarme de apneia. OXIMETRIA (SpO2)- Deve apresentar a curva pletismográfica, índice de perfusão com indicação gráfica e numérica; Faixa de Saturação de O2 (SpO2): Precisão entre 70% e 100% de saturação, não superior a $\pm 2\%$ Resolução da medida de SpO2: 1%; Faixa da Frequência de Pulso (FP): 40 a 300BPM; Resolução da medida de FP: 1 BPM; Acessórios: 1 (uma) extensão para sensor de SpO2, 1 (um) sensor de SpO2 reutilizável adulto; PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) - Deve apresentar os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS) de no mínimo 40 a 260mmHg Pressão Arterial Diastólica (PAD) de no mínimo 25 a 220 mmHg e Pressão Arterial Média (PAM) de no mínimo 25 a 250 mmHg; Modos de medida: Manual, Automático Acessórios: 1 (uma) extensões de ar 1 (uma) braçadeira adulto. TEMPERATURA-Deve possuir, pelo menos, 2 (dois) canais de monitoração da Temperatura; Deve permitir a medida da Temperatura por sensor aderido na pele do paciente, ou através de cavidades, como o esôfago ou reto; Faixa de medida da Temperatura: 5 a 45 °C; Acessórios: 1 (um) sensor de temperatura reutilizável tipo pele. VOLTAGEM: BIVOLT

10	VENTILADOR PULMONAR	CMOS DRAKE	10,000	UNIDADE	110000,000	1100000,00
----	---------------------	------------	--------	---------	------------	------------

Antônia Maria de Aguiar Gonçalves
Suplente de Vereador
Mat: 1345409
Prefeitura Municipal de Paragominas



Especificação : Ventilador mecânico pulmonar micro processado, com monitor gráfico de ventilação LCD colorido sensível ao toque de no mínimo 12 polegadas, destinado à beira de leito e ao transporte intra-hospitalar de pacientes adultos, pediátricos, neonatais deve operar por rede de O2 e gerar o ar comprimido por sistema de turbina ou compressor. O ventilador deve possuir sistema de auto teste para detecção de vazamento no circuito respiratório bem como medir a complacência e resistência do circuito para maior precisão de leitura deve possuir válvulas (Insp e exp) protegidas internas ao equipamento totalmente autoclaváveis inclusive sensor de fluxo. Deve possuir sensibilidade de disparo a fluxo ou a pressão com resolução de 0,1 em toda a faixa ciclagem a fluxo com ajuste manual nas modalidades que permitam a utilização da pressão de suporte blander de O2 eletrônico interno, com calibração do sensor de oxigênio deve possuir ajuste de alarmes e deverá armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados quando o aparelho for colocado em modo de espera (stand-by) deve possuir baterias internas com autonomia de no mínimo 120 minutos, braço articulado para suporte do circuito respiratório. Modos de ventilação: VCV - ventilação controlada a volume PCV - ventilação controlada a pressão PRVC - pressão controlada com garantia de volume corrente SIMV/VC+PS - ventilação mandatória intermitente sincronizada a volume controlado, associada a pressão de suporte SIMV/PC+PS - ventilação mandatória intermitente sincronizada a pressão controlada, associada a pressão de suporte APRV - ventilação com dois níveis de pressão (pressão baixa e pressão alta), ciclada a tempo e que permite ao paciente respirar em qualquer fase do ciclo respiratório, permitindo também a inversão de relação I:e BINIVEL, BILEVEL, DUOLEVEL ou similar - ventilação com dois níveis de pressão (pressão baixa e pressão alta), ciclada a tempo e que permite ao paciente respirar em qualquer fase do ciclo respiratório, associada a pressão de suporte PSV - pressão de suporte e ventilação não invasiva nos modos PSV e PC, com compensação automática de fuga. Modo ou recurso ventilatório que permita a transição automática entre a ventilação espontânea e controlada de acordo com a mecânica pulmonar do paciente. HFNC - terapia de alto fluxo ventilador com ajuste do tempo de apnéia de até 60 segundos, com ventilação de back-up, nos modos espontâneos, que permita o retorno automático do paciente ao modo de origem caso o paciente apresente estímulo respiratório novamente. Ajustes: frequência respiratória programável de no mínimo 01 até 100 ciclos/min tempo inspiratório programável de no mínimo 0,2 a 5,0 segundos volume corrente programável de no mínimo 20ml até 2000 ml fluxo inspiratório livre de no mínimo 200 l/min pressão controlada inspiratória ajustável de no mínimo 05 a 60 cmh2o pressão de suporte até 60 cmh2o PEEP/CPAP até 40 cmh2o concentração de oxigênio: 21 - 100% pausa inspiratória e expiratória manual de até 2,0 segundos no mínimo e ajuste de alarmes. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. ACESSÓRIOS: 02 (dois) circuito reutilizável adulto/pediátrico/neonatal 01 (um) kit de válvula expiratória adicional ou cassete respiratório completo: 01 (uma) base móvel com rodízios e freios 01 (um) braço articulado com suporte para os circuitos respiratórios 01 (um) mangueira para O2. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 VOLTS ou 310vlt

Antonio Carlos B. Gonçalves
Suplente de Prefeito
Município de Paragominas
Matr. 1046109
Prefeitura Municipal de Paragominas

11	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA	PHOENIX	2,000	UNIDADE	185000,000	370000,00
----	----------------------------------	---------	-------	---------	------------	-----------

Especificação : Comando: Controlador microprocessado PHA-08; Capacidade nominal da câmara de aproximadamente: 250 litros; Tipo/Número de portas Volante Central (2P/VC) Potência: Tensão: 220V Trifásico; Funcionamento: Através de gerador elétrico acoplado (E) secagem: Bomba de vácuo de 1,5 HP 220/380V 60Hz Trifásica Instrumentos: Manovacuômetro indicativo para pressão e vácuo na câmara interna Instrumentos: Manômetro indicativo para pressão na câmara externa (jaqueta) e gerador de vapor Instrumentos: Dois sensores de temperatura tipo PT-100 classe 1 Instrumentos: Dois transmissores de pressão Acompanha bomba de vácuo Possibilita a configuração da temperatura de trabalho de 90 a 135°C e tempo de esterilização e secagem de até 99 minutos cada. Possui entrada analógica para sensor PT-100, para controle da pressão do gerador/câmara externa e para controle de pressão e vácuo da câmara interna. Possui entradas digitais sendo porta aberta, pressostato e controle de nível do gerador de vapor alto e baixo. CÂMARAS - Câmara interna em formato retangular com capacidade de aproximadamente 200 litros, fabricada em aço inoxidável AISI 316L, e câmara externa fabricada em aço inoxidável AISI 304. Possui isolamento térmica, através de camadas de lã de rocha aluminizada, e revestimento externo com chapas galvanizadas.

		Total :		2345595,00
Condições de pagamento :		30 DIAS		
Prazo de entrega :		45 DIAS		
Validade da proposta :		60	dias.	
Valor por extenso :		Dois Milhões, Trezentos e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais.		

Data : 24/11/2022

FRANK
FRAIHA
Digitally signed by FRANK FRAIHA
DN: cn=FRANK FRAIHA, o=F.
CARDOSO & CIA. LTDA.,
ou=Vendas,
email=frankfraiha@shoppingdasa
udeonline.com.br, c=BR
Date: 2021.06.19 08:55:14 -03'00'

F. Cardoso & Cia. Ltda
04.949.905/0001-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

CNPJ: 05.193.057/0001-78

Telefone: (91) 3729-8001

Departamento: COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADOS



Relatório de Cotação: COTAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - HMP E UPA

Pesquisa realizada entre 04/11/2022 13:49:11 e 25/11/2022 12:16:19

Relatório gerado no dia 28/11/2022 09:17:08 (IP: 177.74.58.82)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que contera: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Máximo	Total
1) AGITADOR DE KLINE 110 VOLTS	2	5 Unidades	R\$ 1.739,67 (un)	-	R\$ 1.739,67 ✓	R\$ 8.698,35
2) AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA	3	2 Unidades	R\$ 266.188,01 (un)	-	R\$ 266.188,01 ✓	R\$ 532.376,02
3) BERÇO AQUECIDO COM SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE	3	10 Unidades	R\$ 28.477,78 (un)	-	R\$ 28.477,78 ✓	R\$ 284.777,80
4) FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CÚPULAS	3	3 Unidades	R\$ 58.315,87 (un)	-	R\$ 58.315,87 ✓	R\$ 174.947,61
5) FOCO CIRURGICO MÓVEL COM RODÍZIO	3	12 Unidades	R\$ 29.029,03 (un)	-	R\$ 29.029,03 ✓	R\$ 348.348,36
6) INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLÓGICO	3	2 Unidades	R\$ 7.138,68 (un)	-	R\$ 7.138,68 ✓	R\$ 14.277,36
7) INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTOCONTIDO	4	100 Caixas	R\$ 2.632,69 (un)	-	R\$ 2.632,69 ✓	R\$ 263.269,00
8) MESA CIRURGICA ELETRICA FORMATO TIPO T	3	3 Unidades	R\$ 94.962,49 (un)	-	R\$ 94.962,49 ✓	R\$ 284.887,47
9) MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR.	3	5 Unidades	R\$ 5.973,56 (un)	-	R\$ 5.973,56 ✓	R\$ 29.867,80
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO.	4	45 Unidades	R\$ 38.500,00 (un)	-	R\$ 38.500,00 ✓	R\$ 1.732.500,00
11) VENTILADOR PULMONAR	3	10 Unidades	R\$ 66.988,56 (un)	-	R\$ 66.988,56 ✓	R\$ 669.885,60

Valor Global: R\$ 4.343.835,37

Detalhamento dos itens

Antônio Alexandre B. Gonçalves
Suprimentos e Almoxarifado
Mat. 15109
Prefeitura Municipal de Paragominas



Item 1: AGITADOR DE KLINE 110 VOLTS

Preço Estimado: R\$ 1.739,67 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 1.739,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.739,67

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Especificação : Frequência de velocidade ajustável: 0 - 230 rpm, Raio de agitação orbital: 22 mm, Dimensões aproximadas da plataforma: Largura: 224 mm, Altura: 80 mm, Profundidade: 152 mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos permanentes para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde..

Descrição: Bomba Centrífuga - Peça / Componente - AGITADOR TIPO VDRL OU KLINE COM MOTOR COMPLETAMENTE SELADO E POR INDUÇÃO. SEM ESCOVAS E VELOCIDADE AJUSTÁVEL. BAIXO RUÍDO. BANDEJA REVESTIDA COM BORRACHA RESISTENTE A CORROSÃO E AINDA EQUIPADO COM TIMER 0 A 15 MINUTOS. FREQUÊNCIA 0 A 230 RPM (VELOCIDADE A - AGITADOR TIPO VDRL OU KLINE COM MOTOR COMPLETAMENTE SELADO E POR INDUÇÃO. SEM ESCOVAS E VELOCIDADE AJUSTÁVEL. BAIXO RUÍDO. BANDEJA REVESTIDA COM BORRACHA RESISTENTE A CORROSÃO E AINDA EQUIPADO COM TIMER 0 A 15 MINUTOS. FREQUÊNCIA 0 A 230 RPM (VELOCIDADE AJUSTÁVEL). RAO DE AGITAÇÃO 22 MM. DIMENSÕES PLATAFORMA 224 X 152 X 80. CARGA MÁXIMA SUPTADA PARA AGITAÇÃO 1.5 KG. VOLTAGEM 110 / 220 VOLTS.

CatMat: 132071 - BOMBA CENTRÍFUGA - PEÇA / COMPONENTE, BOMBA CENTRIFUGA - PEÇA/COMPONENTE

Data: 15/03/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:52022 / UASG:984683

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MG

R\$ 1.498,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	R\$ 1.498,00
* VENCEDOR *	EIRELI	

Descrição: AGITADOR TIPO VDRL OU KLINE COM MOTOR COMPLETAMENTE SELADO E POR INDUÇÃO. SEM ESCOVAS E VELOCIDADE AJUSTÁVEL. BAIXO RUÍDO. BANDEJA REVESTIDA COM BORRACHA RESISTENTE A CORROSÃO E AINDA EQUIPADO COM TIMER 0 A 15 MINUTOS. FREQUÊNCIA 0 A 230 RPM (VELOCIDADE A - AGITADOR TIPO VDRL OU KLINE COM MOTOR COMPLETAMENTE SELADO E POR INDUÇÃO. SEM ESCOVAS E VELOCIDADE AJUSTÁVEL. BAIXO RUÍDO. BANDEJA REVESTIDA COM BORRACHA RESISTENTE A CORROSÃO E AINDA EQUIPADO COM TIMER 0 A 15 MINUTOS. FREQUÊNCIA 0 A 230 RPM (VELOCIDADE AJUSTÁVEL). RAO DE AGITAÇÃO 22 MM. DIMENSÕES PLATAFORMA 224 X 152 X 80. CARGA MÁXIMA SUPTADA PARA AGITAÇÃO 1.5 KG. VOLTAGEM 110 / 220 VOLTS MARCA:GT

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DE GOIÁS/GO

Objeto: Aquisição de mobiliários e outros para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rosa de Goiás.

Descrição: AGITADOR DE KLINE - ROTAÇÃO VARIÁVEL - AGITADOR DE KLINE - ROTAÇÃO VARIÁVEL

Data: 27/12/2021 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 34185

Lote/Item: 54/54

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: GO

R\$ 1.981,33

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.377.015/0001-12	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	R\$ 1.674,00

Descrição: Descrição não informada

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 1.970,00
--------------------	---	--------------

Descrição: Descrição não informada

10.830.704/0001-45	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.300,00
--------------------	--------------------------------------	--------------



Descrição: Descrição não informada



Item 2: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA

Preço Estimado: R\$ 266.188,01 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 266.188,01

Média dos Preços Obtidos: R\$ 266.188,01

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Especificação : Comando: Controlador microprocessado PHA-08; Capacidade nominal da câmara de aproximadamente: 250 litros; Tipo/Número de portas Volante Central (2P/VC) Potência: Tensão: 220V Trifásico; Funcionamento: Através de gerador elétrico aco plado (E) secagem: Bomba de vácuo de 1,5 HP 220/380V 60Hz trifásica Instrumentos: Manovacuômetro indicativo para pressão e vácuo na câmara interna Instrumentos: Manômetro indicativo para pressão na câmara externa (jaqueta) e gerador de vapor Instrumentos: Dois sensores de temperatura tipo PT-100 classe 1 Instrumentos: Dois transmissores de pressão Acompanha bomba de vácuo Possibilita a configuração da temperatura de trabalho de 90 a 135°C e tempo de esterilização e secagem de até 99 minutos cada. Possui entrada analógica para sensor PT-100, para controle da pressão do gerador/câmara externa e para controle de pressão e vácuo da câmara interna. Possui entradas digitais sendo porta aberta, pressostato e controle de nível do gerador de vapor alto e baixo. CÂMARAS - Câmara interna em formato retangular com capacidade de aproximadamente 200 litros, fabricada em aço inoxidável AISI 316L, e câmara externa fabricada em aço inoxidável AISI 304. Possui isolamento térmica, através de camadas de lã de rocha aluminizada, e revestimento externo com chapas galvanizadas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 294.307,53

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Aquisição de Equipamento/Material permanente (Autoclave Hospitalar, Foco Cirúrgico de Teto, Arco Cirúrgico, Bisturi Elétrico), visando atender as necessidades do Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II – HEPSJP/II..

Descrição: AVENTAL - Autoclave Hospitalar Horizontal - Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com display touch screen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico - tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível... Descritivo completo no Anexo III do Edital.

CatMat: 150734 - AVENTAL

Data: 13/06/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:7872021 /
UASG:925373

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/07/2022 14:15

Homologação: 22/07/2022 10:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

58.344.359/0001-66

H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 260.000,00

Descrição: AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL Autoclave hospitalar horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de 300 litros. Funcionamento através de vapor saturado, possui toda estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável dotado de 9 programas, sendo 5 ciclos com perfil de densidade de 101°C a 135°C, 2 ciclos perfil líquidos de 101°C a 135°C, 1 ciclo Bowie & Dick e 1 ciclo Leak Test. CLP com display touch screen, dotado de manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316 L com isolamento térmica, a câmara interna possui dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Dotado de 2 (duas) portas, sistema de barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical, tipo guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico com tubulações e conexões do conjunto hidráulico em material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor em aço inoxidável. Dotado de bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que impossibilita o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos e dotado de alarmes audiovisuais. O ruído não ultrapassa ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Acessórios inclusos: 2 (dois) carros externos para acomodação dos materiais, 1 (um) carro interno/rack para acomodação dos materiais, 1 (um) sistema de purificador de água por osmose reversa de 20l/h, 1 (uma) impressora térmica que permite a documentação do processo com registros: nome do estabelecimento, esterilizador, data, hora, ciclo, código de carga, fases e ocorrência de falha caso ocorra e 1 (um) compressor de ar comprimido. Alimentação elétrica 220V/380V. Modelo: HI SPEED II B0111-300P Marca/Fabricante: Baumer S/A Procedência: Nacional RMS: 10345500099



Relatório gerado no dia 25/11/2022 12:19:15 (IP: 177.74.58.82)

Código Validação: XHamiWku%2f5nMLK6rUImNOZk45eUI7PEcuHNBHedwt1AqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=XHamiWku%2f5nMLK6rUImNOZk45eUI7PEcuHNBHedwt1AqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

12.704.512/0001-18 TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

R\$ 300.000,00

Descrição: Autoclave Hospitalar Horizontal - Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com display touch screen, manômetro e manovacuômetro desenhados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmico, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guilhotina com sistema de segurança anesmagamento. Sistema hidráulico - tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 carros externos para acomodação dos materiais, 01 carro interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave), 1 impressora, compressor se necessário para fornecimento de ar, Medidas máximas largura 1,10 m e Comprimento 1,30m, devido a área da CME. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

28.767.561/0001-30 LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

R\$ 322.922,60

Descrição: AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL AUTOMATICA CAPACIDADE 250 LITROS C/02 PORTAS DESLIZANTES + ACESSÓRIOS MODELO: OHFV-B2 50ET MARCA/FABRICANTE: "ONIX CIENTÍFICA" REGISTRO ANVISA: 81559170001 PROCEDÊNCIA: Nacional Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com display touch screen, manômetro e manovacuômetro desenhados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmico, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guilhotina com sistema de segurança anesmagamento. Sistema hidráulico - tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 carros externos para acomodação dos materiais, 01 carro interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificação de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave), 1 impressora, compressor se necessário para fornecimento de ar, Medidas máximas largura 1,10 m e Comprimento 1,30m, devido a área da CME. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 247.256,50

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

Data: 27/12/2021 10:00

Objeto: O objeto consiste na formalização da Ata de Registro de Preço para contratação de empresas especializadas no fornecimento, eventual e parcelado, de equipamentos permanentes, a fim de compor as unidades de Saúde da Atenção Primária e Atenção Especializada, vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde do Jabotão dos Guararapes..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:12021 / UASG:982457

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PE

Descrição: Máquina universal ensaios, peças e acessórios - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL-EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 350 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO NA FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE 121°C A 134°C E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI-CORROSIVO E REVESTIMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA E DISPLAY EM LCD E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO TECLADO NUMÉRICO PARA CONTROLE COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS CICLOS PROGRAMADOS, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL. SISTEMA HIDRÁULICO (TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTI-CORROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL; Conforme Edital e especificações do TR

CatMat: 150435 - MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

44.239.382/0001-86 PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA

R\$ 247.230,00

* VENCEDOR *



Descrição: Autoclave horizontal marca Luferco, modelo 39209, capacidade de 365 litros, procedência nacional, Registro ANVISA nº 80004710004, funciona por meio de vapor saturado na faixa de temperatura entre 121°C a 134°C, estrutura em material anti-corrosivo e revestimento externo por chapa de aço inoxidável. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com painel e comando com botão liga/desliga e display em LCD, possui teclado numérico para controle com membrana de proteção para visualização dos ciclos programados, manômetro e manovacuômetro. câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna possui dreno. 02 (duas) portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical. Sistema hidráulico tubulações e conexões do conjunto hidráulico de material anti-corrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor em aço inox; possui bomba de vácuo tipo anel líquido e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que impossibilita o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Contem caixa de comando para proteção de sobrecarga. O ruído não excede ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Acessórios: 02 (dois) carros externos para acomodação dos materiais, 01 (um) carro interno para acomodação dos materiais, 01 (um) sistema de purificador de água por osmose, 01 (uma) impressora matricial. Alimentação elétrica trifásica.

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

R\$ 247.283,00

Descrição: AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL-EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA DE NO MÍNIMO 350 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO NA FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE 121°C A 134°C E A PRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTI-CORROSIVO E REVESTIMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, COM PAINEL E COMANDO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA E DISPLAY EM LCD E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO TECLADO NUMÉRICO PARA CONTROLE COM MEMBRANA DE PROTEÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS CICLOS PROGRAMADOS, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADAS EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA. FECHAMENTO DAS PORTAS REALIZADO POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL. SISTEMA HIDRÁULICO (TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO CONJUNTO HIDRÁULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTI-CORROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR DEVE SER EM AÇO INOX OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL; Conforme Edital e especificações do TR

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 257.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

Data: 12/08/2022 00:00

Objeto: Aquisição de Material Permanente (equipamentos hospitalares) e Material de Consumo para inauguração da Unidade de Pronto Atendimento

Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços

SRP: NÃO

Identificação: 510340-7-030-2022

Lote/Item: 1/9

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MT



Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL DE BARREIRA PARA CENTRAL DE ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 500 LTS COM DUAS PORTAS TIPO BARREIRA CONSTRUÍDO CONFORME NORMAS NBR 11816, GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE ACO C - AUTOCLAVE HORIZONTAL - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL DE BARREIRA PARA CENTRAL DE ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 500 LTS COM DUAS PORTAS TIPO BARREIRA CONSTRUÍDO CONFORME NORMAS NBR 11816, GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE ACO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO PROVIDO NO MINIMO DE MANOMETRO, MANOVACUOMETRO, TERMOMETRO DIGITAL, TEMPORIZADOR, CHAVE SELETORA, BOTAO LIGA/DESLIGA, ALARME SONORO E VISUAL, LAMPADA INDICADORA, OPERACAO AUTOMATICA ACIONADA ATRAVES DE CHAVE GERAL E BOTAO LIGA/DESLIGA PELO OPERADOR, TUBULACOES EM ACO INOX AISI 316, DOTADO DE REVESTIMENTO QUE POSSIBILITE PERFEITA ISOLACAO TERMICA, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE DE TEMPERATURA NO AMBIENTE, TEMPERATURA REGULAVEL NO MINIMO 120 GRAUS - 130 GRAUS, ESTERILIZACAO ATRAVES DE VAPOR SATURADO UMIDO, REMOCAO DO AR POR BOMBA DE AUTO VACUO, COM CAMARA INTERNA DUPLA EM ACO INOX AISI 316 DE NO MINIMO 05MM DE ESPESSURA, COM DUAS PORTAS TIPO BARREIRA COM FECHAMENTO TIPO GUILHOTINA VERTICAL E ACIONAMENTO AUTOMATICO, CONSTRUÍDAS INTERNAMENTE EM ACO INOXIDAVEL AISI 316, COM FECHAMENTO UNIFORME, SOB GUARNICAO DE SILICONE, DOTADA DE TRAVA DE SEGURANCA QUE IMPOSSIBILITE ABERTURA DA TAMPA NA EXISTENCIA DE PRESSAO INTERNA, SISTEMA AUTO-TRAVANTE PARA A PORTA, QUANDO SUBMETIDA A PRESSAO, COM VALVULA DE RAPIDO ESCOAMENTO, TERMOSTATO DE SEGURANCA PARA CONTROLE DA TEMPERATURA, DISPLAY DE LCD TIPO TOUCH SCREEN, PROVIDO DE IMPRESSORA PARA REGISTRO DOS DADOS, DEVE ACOMPANHAR: 02 CARROS PARA TRANSPORTE DOS CESTOS COM RACKS, 12 CESTOS PARA CARREGAMENTO DA CAMARA EM NO MINIMO ACO INOXIDAVEL AISI 304 EM DIMENSOES COMPATIVAS COM AS DA CAMARA INTERNA, 01 IMPRESSORA, 01 SISTEMA DE OSMOSE REVERSA COM CAPACIDADE PARA FORNECER AGUA AO EQUIPAMENTO EM QUALIDADE E QUANTIDADE SUFICIENTES AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, 01 CAVALETE DE AR COMPRIMIDO, GERADOR DE VAPOR, 01 QUADRO ELETRICO PARA AUTOCLAVE, 01 QUADRO ELETRICO PARA GERADOR DE VAPOR, TENSAO DE ALIMENTACAO 380VOLTS / 60HZ., GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA CORROSAO DA CAMARA INTERNA, GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS, MANUAIS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA NBR IEC 11816 DE ESTERILIZACAO A VAPOR COM VACUO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E ANVISA, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA ESTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE.



CNPJ Razão Social do Fornecedor

61.374.161/0001-30 BAUMER S A
* VENCEDOR *

Valor da Proposta Inicial

R\$ 257.000,00

Descrição: Descrição não informada

Item 3: BERÇO AQUECIDO COM SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE.

Preço Estimado: R\$ 28.477,78 (un)

Percentual: - Preço Máximo: R\$ 28.477,78

Média dos Preços Obtidos: R\$ 28.477,78

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Especificação: Leito com altura fixa ou ajustável, Sistema de controle eletrônico microprocessado. Com Relógio Apgar, Modos de operação manual e automático (servo controle). Aquecedor giratório (180º). Laterais rebativeis em acrílico, acionada com somente uma das mãos. Sistema de inclinação do leito com auxílio hidráulico ou elétrico. Balança integrada ao leito. Leito construído em material radio-transparente, com gaveta para cassete para radiografia. Bivolt	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 28.866,67



Relatório gerado no dia 25/11/2022 12:19:15 (IP: 177.74.58.82)
Código Validação: XHamiWku%2f5nMLK6rUImNOZk45eUI7PEcuhNbHedwt1AqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=XHamiWku%252f5nMLK6rUImNOZk45eUI7PEcuhNbHedwt1AqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades da Maternidade e Clínicas de Mulheres Bárbara Heliodora, contempladas com as Portarias Nº 3.101/2013, 3.099/2013, 1.857/2014, 2.589/2016, 2.628/2017, 1.262/2019 e 1.684/2019 no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.

Descrição: Berço hospitalar - Berço hospitalar, tipo: aquecido, componentes: sistema calor irradiante, componentes 1: misturador gases, fototerapia led, painel controle: ajuste digital, visor gráfico, base do leito: leito mesa acrílico, mecânico, sensor: sensores temperatura, pés: pés rodízios, acessórios: suporte soro, balança, acessórios 01: iluminação auxiliar, tipo uso: radiotransparente

CatMat: 443175 - BERÇO HOSPITALAR, TIPO:AQUECIDO, COMPONENTES:SISTEMA CALOR IRRADIANTE, COMPONENTES 1:MISTURADOR GASES, FOTOTERAPIA LED, PAINEL CONTROLE:AJUSTE DIGITAL, VISOR GRÁFICO, BASE DO LEITO:LEITO MESA ACRÍLICO, MECÂNICO, SENSOR:SENSORES TEMPERATURA, PÉS:PÉS RODÍZIOS, ACESSÓRIOS:SUPORTE SORO, BALANÇA, ACESSÓRIOS 01:ILUMINAÇÃO AUXILIAR, TIPO USO:RADIOTRANSARENTE

Data: 27/04/2022 10:25

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:2192021 / UASG:927996

Lote/Item: /7

Ata: LinkAta

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF:



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

62.413.869/0001-15 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.

R\$ 21.600,00

* VENCEDOR *

Descrição: BERÇO AQUECIDO BERÇO AQUECIDO GRN – MODELO NEOSOLUTION Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico; Possui sistema de proteção térmica através de dispositivo de detecção eletrônica para sobrecarga no elemento aquecedor; Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento PVC removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi, mobilidade através de rodízios de 4" com freios e para-choques frontal e traseiro. Painel de controle frontal integrado com display alfanumérico de cristal líquido (LCD) de alta resolução com iluminação de fundo para indicação de temperatura e potência desejada, com acabamento liso que evita a penetração de líquidos e com teclas tipo toque-suave; Memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apgar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente, baixa e alta temperatura do paciente, alta temperatura do elemento aquecedor com desligamento automático. Sistema que interrompe o aquecimento quando o elemento aquecedor permanecer na máxima potência determinada por um tempo consecutivo de 10 Minutos. Sistema de proteção térmica por dispositivo de detecção eletrônica de sobrecarga no elemento aquecedor permite indicações simultâneas de temperatura da pele, da temperatura de ajuste, da temperatura ambiente, do nível de potência de aquecimento em uso. Alarme de advertência a cada 10 minutos no modo RN para verificação da rotina de temperatura do paciente. Sistema de auto-teste constante das funções, indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 30 à 38º C com resolução de 0,1ºC., Sistema pelo qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a temperatura do AR. Bip de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potências. Retenção de memória na falta de energia dos valores programados Teclas para seleção do modo de operação: Modo RN/automático (Servo controle) ou Modo Manual (Potência). Tecla de inibição de alarme (áudio). Tecla "liga" e "desliga" do equipamento. Tecla de auto teste do sistema Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica 127/220 volts (Bivolt Seleccionável) – 50 ou 60 Hz, fusíveis de proteção para os circuitos. Acompanha o equipamento: Prateleira sob o leito para armazenamento de materiais diversos, conjunto com 02 prateleiras giratórias para monitores que suportam a carga de 10 kg cada, haste para bomba de infusão e suporte de soro, suporte flexível para posicionar os circuitos de ventiladores, sensor de pele, foco de luz fria para procedimentos, relógio APGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos e alça para locomoção. Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas NBR IEC 60601-1 mais as Emendas Obrigatórias – Prescrições Gerais para Segurança NBR IEC 60601-1-2 – Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança. NBR IEC 60601-2-21 mais as Emendas Obrigatórias – Prescrições Particulares para Segurança de Berço Aquecido REGISTRO ANVISA-MS Nº 10228740032 PROCEDENCIA NACIONAL - GARANTIA 12 MESES - ENTREGA 90 DIAS - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI

R\$ 30.000,00

Descrição: Berço hospitalar, tipo: aquecido, componentes: sistema calor irradiante, componentes 1: misturador gases, fototerapia led, painel controle: ajuste digital, visor gráfico, base do leito: leito mesa acrílico, mecânico, sensor: sensores temperatura, pés: pés rodízios, acessórios: suporte soro, balança, acessórios 01: iluminação auxiliar, tipo uso: radiotransparente

22.173.882/0001-20 AC EMPREEDIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI

R\$ 35.000,00

Descrição: Berço hospitalar, tipo: aquecido, componentes: sistema calor irradiante, componentes 1: misturador gases, fototerapia led, painel controle: ajuste digital, visor gráfico, base do leito: leito mesa acrílico, mecânico, sensor: sensores temperatura, pés: pés rodízios, acessórios: suporte soro, balança, acessórios 01: iluminação auxiliar, tipo uso: radiotransparente

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 27.766,67

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS/MA

Data: 25/01/2022 09:00



Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos/material permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme descrição. Do município de Anapurus/MA.

Descrição: Berço Aquecido - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento - Berço Aquecido - Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 35166

Lote/Item: 3/3

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.504.008/0001-19	EXPANSAO COMERCIO LTDA	R\$ 27.500,00
Descrição: Descrição não informada		
30.778.749/0001-25	G.P. VEZONO EIRELI	R\$ 27.800,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Descrição não informada		
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 28.000,00
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 28.800,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS E HOSPITAL TRAMANDAÍ E HOSPITAL TRAMANDAÍ

Data: 14/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico (13.191/09) - Registro de Pre

SRP: NÃO

Identificação: 0231/2021

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Homologação: 16/12/2021 14:22

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: RS



Descrição: 8169 BERÇO AQUECIDO PARA UTI / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO, DEVE POSSUIR ALETAS DIRECIONADORAS PARA AQUECIMENTO UNIFORME. POSSUIR GIRO BILAT - 8169 BERÇO AQUECIDO PARA UTI / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO, DEVE POSSUIR ALETAS DIRECIONADORAS PARA AQUECIMENTO UNIFORME. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; DEVE POSSUIR GAVETA PARA CASSETE PARA RADIOGRAFIA. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIO TRANSPARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE, O LEITO DEVE TER ALTURA AJUSTÁVEL; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APGAR E ALARMES DE ADVERTÊNCIA; SENSOR DE PELE E BIP DE ALERTA PARA INFORMAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AJUSTE DAS TEMPERATURAS E POTENCIAIS; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS; CRONÔMETRO COM ALARME; TECLA INIBIDORA DE SOM; ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO AUXILIAR; LED INDICADOR DE STAND BY; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; RELÓGIO APGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERtermia; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE ROTINA. DEVERÁ TER BALANÇA INTEGRADA AO LEITO, QUE PERMITE A OBTENÇÃO DE RADIOGRAFIAS SEM REMOÇÃO DO PACIENTE. DEVERÁ TER NO EQUIPAMENTO BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. DEVE TER TECLA DE "LIGA" E "DESLIGA". ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V. EQUIPAMENTO FABRICADO E CERTIFICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
62.413.869/0001-15 * VENCEDOR *	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	R\$ 21.000,00
Descrição:		
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	R\$ 36.600,00
Descrição:		

Item 4: FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CÚPULAS

Preço Estimado: R\$ 58.315,87 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 58.315,87 Média dos Preços Obtidos: R\$ 58.315,87

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Especificação : Possuir nível de luminosidade mínimo de 240.000 lux (120 000 lux por cúpula) Temperatura de cor: 3.000 - 6.000K consumo de energia entre 70 a 100VA, dissipação de calor sem a necessidade de uso de cooler, ventoinhas entre outros, Vida útil do LED: 50 000 horas. Voltagem 110volts ou bivolt	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 62.666,67

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Data: 13/06/2022 09:30



Relatório gerado no dia 25/11/2022 12:19:15 (IP: 177.74.58.82)
Código Validação: XHamiWku%2f5nMLK6rUImNOZk45eUI7PEcuhNbHedwt1AqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=XHamiWku%252f5nMLK6rUImNOZk45eUI7PEcuhNbHedwt1AqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Aquisição de Equipamento/Material permanente (Autoclave Hospitalar, Foco Cirúrgico de Teto, Arco Cirúrgico, Bisturi Elétrico), visando atender as necessidades do Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II – HEPSJP/II..

Descrição: Avental - Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta... Descritivo completo no Anexo III do Edital.

CatMat: 150734 - AVENTAL

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:7872021

UASG:925373

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/07/2022 14:15

Homologação: 22/07/2022 10:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 50.000,00

Descrição: Foco Cirúrgico de Teto - Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo o aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. RMS: 81205910005 MARCA: MENDEL MODELO: TETO LED DUPLEX 3LE/3LE

42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	R\$ 68.000,00
--------------------	---	---------------

Descrição: Foco Cirúrgico de Teto - Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo o aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Conforme edital. Prazo de Entrega: Conforme edital. Prazo de Pagamento: Conforme edital. Prazo de Garantia: Conforme o edital.

37.426.131/0001-45	JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 70.000,00
--------------------	--	---------------

* VENCEDOR *



Descrição: FOCO TETO DUPLO Foco Cirúrgico de Teto com 02 cúpulas com lâmpadas LED'S brancos - Equipamento fabricado e certificado conforme as normas técnicas: NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-2 / NBR IEC 60601-1-6 / NBR IEC 60601-1-9 / NBR IEC 60601-2-41 TNBR.25605. Grau de Proteção IP 54 (cúpulas totalmente vedadas e sem reentrâncias que evitam a entrada de sujeiras e líquidos que possam vir a danificar o equipamento, e possui superfície lisa que facilita a limpeza com bactericidas comuns). Potência/consumo do equipamento: 110 watts máximo (por cúpula: 55 watts). Alimentação de energia Bivolt automático (127/220V). Frequência Hz 50/60. Diâmetro interno das cúpulas - 520 mm / Diâmetro total das cúpulas: 610 mm cada cúpula / Luminosidade: Módulos com lentes de alto rendimento permitem atingir uma intensidade luminosa máxima de 120.000 lux por cúpula a uma distância de 1 metro do campo operatório, (Quantidade de LEDs: 56 por cúpula) Índice de reprodução de cor RA >96% e R9 >96%, diâmetro do campo luminoso/focal de 180 a 320 mm para cada uma das cúpulas; Profundidade de iluminação do campo (L1+L2) 20 cm. Profundidade do campo de iluminação de 1,30 metros. Fornece iluminação de alta qualidade com baixo aquecimento, sem infravermelho e ultravioleta no campo operatório e alta vida útil dos LEDs, tudo isso aliado ao baixo consumo de energia. Possui controle de isenção das sombras com sistema de compensação de luz. A luz é fornecida com temperatura de cor ajustável pelo próprio usuário através do painel de controle na faixa de 3.000 a 6000K, oferecendo além das condições similares a luz do dia, luz com aspecto mais frio ou mais quente. Ajuste/controle de iluminação de 0 a 100%. Isto permite ao cirurgião reconhecer com maior facilidade os diferentes tipos de tecidos, o que diminui o risco de erros. MODO PENUMBRA (ENDO): Em vídeo-cirurgia o Foco pode ser ajustado para o modo PENUMBRA (ENDO), com luz ambiente suficiente para realização dos procedimentos e permitir maior concentração da equipe nos monitores de vídeo. Esse sistema serve para procedimentos menos invasivos como endoscopia, laparoscopia e fluoroscopia bastando ativar modo para que a intensidade seja fraca (<500). SISTEMA DE BRAÇOS Fixação através de haste única. Possui estação de ancoragem que permite, em torno do seu eixo a rotação 360° ilimitado dos braços. O moderno sistema de braços (05 articulações) apresenta suave operação e máxima segurança durante o uso, pois permite movimentação de 360° ilimitado em três eixos verticais e preciso posicionamento. Dispõe de mais duas articulações horizontais, para atender por completo todas as necessidades de posicionamento durante as cirurgias. 45° para cima e 50° para baixo. Partes metálicas recebem revestimento em pintura eletrostática a pó. Regulagens e manutenções podem ser realizadas facilmente pelo lado externo dos braços. Painel de Controle: Todas as funções do equipamento (09 níveis de ajuste) podem ser realizadas no moderno painel eletrônico de controle em LCD disposto na cúpula ou no próprio braço da cúpula (configurável), e é protegido por uma membrana em policarbonato facilitando a limpeza e desinfecção do conjunto e outro fixado na parede e via manopla de focalização existente no centro da cúpula. Possui aviso sonoro luminoso e botão liga/desliga. A alimentação dos LEDs é feita por Driver Eletrônico que mantém a corrente constante, não permitindo oscilações indesejáveis da luz emitida. Possui controle eletrônico inteligente que monitora a temperatura dos módulos de LED, o que permite alcançar uma vida útil de 60.000 a 100.000 horas, minimizando as rotineiras manutenções de focos convencionais. Proteção do sistema eletrônico com fusível substituível. Material da Cúpula: É composto em alumínio / fiberglass com gel coat isoftálico, totalmente selada e com design ideal para evitar o acúmulo de poeira externa e dificuldades na higienização. Seu diâmetro interno de 520 mm combinado a perfeita disposição dos LEDs evitam a incidência de sombras no campo operatório. O equipamento possui sistema de dissipação de calor por convecção natural que transmite o calor para fora do campo cirúrgico e mantém a temperatura adequada para o cirurgião e o paciente. NOTA: Os LEDs não emitem raios infravermelhos (IR) e nem de ultravioletas (UV), portanto não há riscos de queimadura dos tecidos do paciente (dessecação ou sepse por conta de degeneração de tecidos) dentro do campo operatório e não há aumento de temperatura na cabeça do cirurgião. Cúpula é dotada de sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural. Não necessita utilização de filtros absorventes de calor. Uma das cúpulas permite ficar a 1 metro do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesa (iluminação de cavidades). Possui manopla em alumínio, facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, a qual propicia um local seguro para focalização do feixe luminoso e movimento...



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 61.333,33

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – CNES 2808579 - CONVÊNIO Nº 424/PGE-202, PROCESSO SEI Nº 0005.171547/2021-81, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Data: 13/05/2022 09:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 41475

Lote/Item: 8/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 2

Unidade: und

UF: RO



Descrição: FOCO CENTRAL PARA TETO – com as seguintes especificações mínimas:
 Equipamento fabricado conforme as normas NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-1; Alimentação de energia Bivolt automático (127/220V);
 Luminosidade: Módulos com lentes de alto rendimento permit - FOCO CENTRAL PARA TETO – com as seguintes especificações mínimas:
 Equipamento fabricado conforme as normas NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-1; Alimentação de energia Bivolt automático (127/220V); Luminosidade: Módulos com lentes de alto rendimento permitem atingir uma intensidade luminosa máxima de 160.000 lux por cúpula a uma distância de 1 metro do campo operatório, índice de reprodução de cor >95% e diâmetro do campo luminoso de 100 a 200 mm. A luz é fornecida com temperatura de cor ajustável pelo próprio usuário através do painel de controle na faixa de 3500K a 5000K, oferecendo além das condições similares a luz do dia, luz com aspecto mais frio ou mais quente. Isto permite ao cirurgião reconhecer com maior facilidade os diferentes tipos de tecidos, o que diminui o risco de erros. Em vídeo-cirurgia o Foco pode ser ajustado para o modo ENDO, com luz ambiente na cor verde suficiente para realização dos procedimentos e aumentando a concentração da equipe nos monitores de vídeo; Sistema de braços: O moderno sistema de braços apresenta suave operação e máxima segurança durante o uso, pois permite movimentação de 360° ilimitado em três eixos verticais e preciso posicionamento. Dispõe de mais duas articulações horizontais, para atender por completo todas as necessidades de posicionamento durante as cirurgias. Partes metálicas recebem revestimento em pintura eletrostática a pó. Regulagens e manutenções podem ser realizadas facilmente pelo lado externo dos braços; Painel de Controle: Todas as funções do equipamento podem ser realizadas no moderno painel de controle em LCD que fica localizado no braço da cúpula, e é protegido por uma membrana em policarbonato facilitando a limpeza e desinfecção do conjunto. A alimentação dos LEDs é feita por Driver Eletrônico que mantém a corrente constante, não permitindo oscilações indesejáveis da luz emitida. Possui controle eletrônico inteligente que monitora a temperatura dos módulos de LED, o que permite alcançar uma vida útil de 50.000 horas, minimizando as rotineiras manutenções de focos convencionais; Cúpula: a cúpula é confeccionada em fiberglass com gel coat isoftálico, totalmente selada e com design ideal para evitar o acúmulo de poeira externa e dificuldades na higienização. Seu diâmetro de 650 mm combinado a perfeita disposição dos LEDs evitam a incidência de sombras no campo operatório. Possui manopla em alumínio, retrátil e autoclavável, a qual propicia um local seguro para focalização do feixe luminoso e movimentação da cúpula em todas as direções pelo próprio cirurgião, sem risco de contaminação. A equipe também pode movimentar a cúpula facilmente através de alças externas; inclusos lâmpadas para reposição, bem como garantia de 12 meses, manual em português e certificado de garantia devidamente preenchido.



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.603.766/0001-29	CLARA MARIA PEREIRA MARQUES	R\$ 55.000,00
Descrição: Descrição não informada		
79.805.263/0001-28	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	R\$ 60.000,00
Descrição: Descrição não informada		
10.493.078/0001-49	IBI LIFE MEDICAL EIRELI	R\$ 69.000,00
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 50.947,62

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS/MA

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos/material permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme descrição. Do município de Anapurus/MA.

Data: 25/01/2022 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 35166

Lote/Item: 18/18

Ata: Link Ata



Relatório gerado no dia 25/11/2022 12:19:15 (IP: 177.74.58.82)
 Código Validação: XHamiWku%2f5nMLK6rUlmNOZk45eUI7PEcuHNBHedwt1AqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=XHamiWku%2f5nMLK6rUlmNOZk45eUI7PEcuHNBHedwt1AqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Descrição: Foco Cirúrgico de Teto - Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas - Foco Cirúrgico de Teto - Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: MA



CNPJ Razão Social do Fornecedor

01.501.826/0001-05 VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI

Valor da Proposta Inicial

R\$ 42.842,86

Descrição: Descrição não informada

34.075.280/0001-19 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 50.000,00

Descrição: Descrição não informada

79.805.263/0001-28 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 60.000,00

Descrição: Descrição não informada

Item 5: FOCO CIRURGICO MÓVEL COM RODÍZIO

Preço Estimado: R\$ 29.029,03 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 29.029,03

Média dos Preços Obtidos: R\$ 29.029,03

Quantidade Descrição

12 Unidades

Especificação : Composto por base móvel com rodízio, de cúpula única e bateria interna recarregável. Possuir nível de luminosidade de mínimo de 110.000 lux, filtro calórico, sistema de alimentação por rede elétrica e sistema de emergência com carregador automático de bateria, consumo de energia entre 70 a 100VA, temperatura de cor entre 3.000 a 6.000K, sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável, sistemas de braços articuláveis para movimentos mínimos de torção e flexão, dissipação de calor sem a necessidade de uso de cooler, ventoinhas entre outros. Acessórios básicos: Cabo de alimentação conforme ABNT, com no mínimo 2 m, lâmpadas sobressalentes, manopla esterilizável extra. Voltagem 110volts ou bivolt

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

R\$ 23.064,42

Órgão: PREF.MUN.DE DUQUE DE CAXIAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, em atendimento às Unidades: Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo e Upa Parque Beira Mar, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos..

Data: 18/07/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:412022 / UASG:985833

Lote/Item: /45

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20



Relatório gerado no dia 25/11/2022 12:19:15 (IP: 177.74.58.82)

Código Validação: XHamiWku%2f5nMLK6rUImNOZk45eUI7PEcuHNBHedwt1AqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=XHamiWku%2f5nMLK6rUImNOZk45eUI7PEcuHNBHedwt1AqHU8nPtm6WA%253d%253d

Descrição: Locação de Materiais Permanentes - FOCO MÓVEL DE LUZ FRIA FOCO CIRURGICO AUXILIAR MÓVEL SOBRE RODÍZIOS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E AMBULATORIAIS. MODALIDADE DE ILUMINAÇÃO: MULTIFOCAL COM TECNOLOGIA LED ; ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI, COM A(S) CÚPULA EM FIBRA DE VIDRO ANTI-CHAMA E GELCOAT; COM A QUANTIDADE MÍNIMA DE BULBOS 3 (TRÊS) BULBOS POR CÚPULA; COM NO MÍNIMO 63 (SESSENTA E TRÊS) LED'S POR CÚPULA; POTÊNCIA MÍNIMA APROXIMADA POR CÚPULA (LUX): 120.000 LUX (AFERIDO A UM METRO DE DISTANCIA ENTRE A CÚPULA E O CAMPO ILUMINADO); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (RA) 95 ±3; TEMPERATURA DE COR FIXA EM: 5000 K (KELVIN); AJUSTE DE FOCO NA MANOPLA EM ALUMÍNIO AUTOCLAVÁVEL; PROFUNDIDADE DO CAMPO (MM): 1500 MM; DIÂMETRO DO CAMPO (MM): 150 - 350 MM; DIMMER: 100% A 10% DA POTÊNCIA DO FOCO CIRURGICO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE PENUMBRA, COMPOSTO DE CONJUNTO DE LEDS AUXILIARES MONTADOS FORA DOS BULBOS, EXISTENTE NA(S) CÚPULA(S) PERMITINDO ASSIM O MELHOR DESEMPENHO NAS VÍDEOS CIRURGIAS COM ILUMINAÇÃO AMBIENTE INDEPENDENTE DOS BULBOS; TENSÃO (V): 110V-220V; POTÊNCIA (W): 120W; FREQUÊNCIA (HZ): 50HZ/60HZ; PROTEÇÃO DOS BULBOS DE LED'S EM VIDRO TEMPERADO OU ACRÍLICO. VERIFICAR O ANEXO II DO EDITAL.

Unidade: UNIDADE

UF: RJ



CatSer: 4413 - LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

CNPJ Razão Social do Fornecedor

13.200.879/0001-67 LUANNA FREIRE FELIX LTDA

* VENCEDOR *

Valor da Proposta Inicial

R\$ 20.000,00

Descrição: Foco Cirúrgico de Solo Móvel Foco cirúrgico auxiliar composto por 01 cúpula em polímero de alto impacto com alta resistência, com geração de luz através de Leds brancos, tecnologia de diodos emissores de luz, que mantém a restituição cromática estável. Luz branca, fria, circular e homogênea através de eixos de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes. Não produzem infravermelhos, tornando o ambiente cirúrgico mais confortável, produtivo e evita a desidratção dos tecidos durante procedimentos de longa duração. Devido ao seu conjunto ótico remove quaisquer sombras no campo operatório. Equipamento isento de espelhos. Cada cúpula possui painel de controle com display em touch screen de liga/desliga, controle de iluminação e controle de temperatura de cor com visual mais branco, 5.000k. Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços de 360° (rotação infinita) em todos os eixos verticais. Sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso. Movimento dos braços realizado de maneira suave e com pouco esforço. Vida útil 60.000 horas. Redução do calor irradiado convertendo grande proporção de eletricidade em luz visível com ajuste de iluminação em até 120.000 lux. Manoplas em alumínio, removíveis e esterilizáveis em autoclave. Fonte de alimentação elétrica com controle de corrente chaveada e adequada aos requisitos normativos legais proporcionando mais conforto e segurança a equipe médica e ao paciente durante longas operações. Base composta por quatro rodízios giratórios sendo dois com freio. Acompanha bateria; sistema de emergência com autonomia de 03 horas; modo endo (penumbra). Índice de reprodução de cor: 96,1 Temperatura da cor: 5.000k Diâmetro da cúpula: 600mm Diâmetro do campo luminoso: 230mm Profundidade do campo: 1500mm Alimentação elétrica: bivolt automático Manopla: alumínio autoclavável p/ alto padrão de higiene. Luminosidade por cúpula: 120.000 Lux. Vida útil dos Leds: 60.000 Horas Consumo de energia: 60 VA Indústria brasileira Marca/Fabricante: Medlight Modelo: FA APOLLO 03x04 Bulbos Led ANVISA: 80712710007

23.750.682/0001-55 ATLAS BJ EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 24.193,27

Descrição: FOCO MÓVEL DE LUZ FRIA - FOCO CIRURGICO AUXILIAR MÓVEL SOBRE RODÍZIOS, PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E AMBULATORIAIS. MODALIDADE DE ILUMINAÇÃO: MULTIFOCAL COM TECNOLOGIA LED ; ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI, COM A(S) CÚPULA EM FIBRA DE VIDRO ANTI-CHAMA E GELCOAT; COM A QUANTIDADE MÍNIMA DE BULBOS 3 (TRÊS) BULBOS POR CÚPULA; COM NO MÍNIMO 63 (SESSENTA E TRÊS) LED'S POR CÚPULA; POTÊNCIA MÍNIMA APROXIMADA POR CÚPULA (LUX): 120.000 LUX (AFERIDO A UM METRO DE DISTANCIA ENTRE A CÚPULA E O CAMPO ILUMINADO); ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (RA) 95 ±3; TEMPERATURA DE COR FIXA EM: 5000 K (KELVIN); AJUSTE DE FOCO NA MANOPLA EM ALUMÍNIO AUTOCLAVÁVEL; PROFUNDIDADE DO CAMPO (MM): 1500 MM; DIÂMETRO DO CAMPO (MM): 150 - 350 MM; DIMMER: 100% A 10% DA POTÊNCIA DO FOCO CIRURGICO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE PENUMBRA, COMPOSTO DE CONJUNTO DE LEDS AUXILIARES MONTADOS FORA DOS BULBOS, EXISTENTE NA(S) CÚPULA(S) PERMITINDO ASSIM O MELHOR DESEMPENHO NAS VÍDEOS CIRURGIAS COM ILUMINAÇÃO AMBIENTE INDEPENDENTE DOS BULBOS; TENSÃO (V): 110V-220V; POTÊNCIA (W): 120W; FREQUÊNCIA (HZ): 50HZ/60HZ; PROTEÇÃO DOS BULBOS DE LED'S EM VIDRO TEMPERADO OU ACRÍLICO, DANDO MAIS RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO EQUIPAMENTO; COMANDOS DE LIGA/DESLIGA, DIMMER, PENUMBRA, LOCALIZADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO; MOVIMENTAÇÃO: LEVE E PRECISA, SEM O USO DE CONTRAPESOS; DEVERÁ POSSUIR DESIGN MODERNO, COM GRANDE MOBILIDADE E ESTABILIDADE DOS MOVIMENTOS, ATENDENDO PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. POSSUIR SISTEMA DE FREIO EM PELO MENOS DOS RODÍZIOS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE FONTE CHAVEADA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA, ONDE NA FALTA OU FALHA DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTINUAR FUNCIONANDO PELO TEMPO MÍNIMO DE 90 MINUTOS. INFORMAÇÕES COMPLETARIAS: EQUIPAMENTO ENQUADRADO ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR IEC 60.601-1/1994 + EMENDA 01/1997 E NBR IEC 60.601-1-2. O FABRICANTE OU Fornecedor DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA Marca: Medpej Modelo FL-2000 ALD 24E LED Procedência: Nacional - Registro ANVISA nº 80127840018

79.805.263/0001-28 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA

R\$ 25.000,00



Descrição: Fornece iluminação de alta qualidade com baixo aquecimento no campo operatório e alta vida útil dos LEDs, tudo isso aliado ao baixo consumo de energia. Módulos com lentes de alto rendimento permitem atingir uma intensidade luminosa de 0 a 120.000 lux a uma distância de 1 metro do campo operatório, índice de reprodução de cor (IRC) >96% e diâmetro do campo luminoso de 100 a 300 mm. A luz é fornecida com temperatura de cor ajustável pelo próprio usuário através do painel de controle na faixa de 3000K a 6000K, oferecendo além das condições similares a luz do dia, luz com aspecto mais frio ou mais quente. Isto permite ao cirurgião reconhecer com maior facilidade os diferentes tipos de tecidos, o que diminui o risco de erros. (Luminosidade pode apresentar variação de $\pm 10\%$). Em vídeo-cirurgia o Foco pode ser ajustado para o modo ENDO, com luz ambiente suficiente para realização dos procedimentos e aumentando a concentração da equipe nos monitores de vídeo. Todas as funções do equipamento podem ser realizadas no moderno painel de controle em LCD com níveis de intensidade e temperatura de cor que fica localizado no braço da cúpula (0 a 100%), botão liga/desliga, é protegido por uma membrana em policarbonato facilitando a limpeza e desinfecção do conjunto. Possui controle eletrônico inteligente que monitora a temperatura dos módulos de LED, o que permite alcançar uma vida útil de 60.000 a 100.000 horas, minimizando as rotineiras manutenções de focos convencionais. Possui conformidade com fluxo laminar (distúrbio no fluxo inferior a 35). A cúpula é confeccionada em fiberglass com gel coat isoftálico, totalmente selada e com design ideal para evitar o acúmulo de poeira interna e xterna e dificuldades na higienização. Diâmetro da Cúpula: interno: 520 mm, combinado a perfeita disposição dos ULTRA LEDs divididos em 04 pétalas, evitam a incidência de sombras no campo operatório. Altura da cúpula (holofote) variável entre 1,00 a 2,20 metros (básculo: +30° / - 40°). O equipamento possui sistema de dissipação de calor por convecção natural que transmite o calor para fora do campo cirúrgico e mantém a temperatura adequada. Característica da cúpula – Energia radiante média gerada: 3,7mW/m2 lx. Dimensões: (CxL) 67 x 62 cms. Iluminação: 120.000 lux. Irradiância máxima: 400 W/m2. Diâmetro do campo operatório: D10 a 1 metro de distância: 55 cms. Diâmetro do campo luminoso/focal de 180 a 320 mm. Profundidade do campo luminoso (L1+L2): 1.300 mm. Índice de retribuição da cor (CRI): 96. Temperatura de Cor: de 3000 a 6000K com 09 níveis de ajuste. Quantidade de Led's: 56 Led's. Fusível 5x20 MM T3, 15 A 250V (IEC 60127). Características elétricas e mecânicas: Consumo de energia: 55 W/VA. Vida útil dos Led's: 60.000 a 100.000 horas. Tensão: Bi-volt automático (127/220V). Possui manopla em alumínio, facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, a qual propicia um local seguro para movimentação da cúpula em todas as direções pelo próprio usuário e focalização do feixe luminoso, sem risco de contaminação. A equipe "não estéril" pode movimentar a cúpula facilmente através de alças externas. O moderno sistema de braços apresenta suave operação e máxima segurança durante o uso, pois permite movimentação de 360° ilimitado na cúpula e preciso posicionamento sem o uso de contrapeso. O conjunto incluindo a cúpula possui 03 articulações. Partes metálicas recebem revestimento em pintura eletrostática a pó. Base confeccionada em material termoplástico de alto reforço em formato "H" livre de ferrugem/oxidação /corrosão e dotada de 04 rodízios em PVC com sistema de freio em todas as rodas para maior segurança proporcionando giro livre de 360°. Caixa em PSAI na base onde estão armazenadas as Baterias internas, circuitos eletrônicos e na parte superior da caixa a chave liga desliga e na lateral conector de rede com porta fusível projetado para ser acessado externamente. Regulagens e manutenções podem ser realizadas facilmente pelo lado externo dos braços. Equipamento fabricado conforme as normas: NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-2 / NBR IEC 60601-1-6 / NBR IEC 60601-1-9 / NBR IEC 60601-2-41. Acompanha par de manoplas esterilizáveis e autoclaváveis. Grau de Proteção IP 54 (cúpulas totalmente vedadas e sem reentrâncias que evitam a entrada de sujeiras e líquidos que possam vir a danificar o equipamento, e possui superfície lisa que facilita a limpeza com bactericidas comuns). Alimentação de energia Bivolt automático (127/220V), condições para operação: temperatura ambiente recomendada de 15°C a 25°C e umidade relativa do ar < 90%, sem condensação. Temperatura no campo operatório 10° C e temperatura na cabeça do cirurgião 2°C. Dotado de Sistema de Emergência a Bateria apresenta Autonomia: mínima de 3 horas de duração de luz plena (acompanha conjunto de baterias). Registro Ministério da Saúde.



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 33.022,67

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUMBIARA-FMS/GO

Data: 08/07/2022 08:00

Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO, tipo "Menor Preço", sob o julgamento de menor preço por Item, objetivando Aquisição de materiais e equipamentos que serão utilizados no CAIS (Centro de Atenção Integrada à Saúde) de Itumbiara-GO, com recursos oriundos da PROPOSTA: 04394.796000/1210-02, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 44720

Lote/Item: 13/13

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Descrição: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL - DE PRIMEIRA QUALIDADE - FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL - DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO LED DE 81.000 A 130.000 LUX, POSSUI SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA, PEDESTAL COM RODÍZIOS, BRAÇO ARTICULADO, PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS, AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA, BIVOLT OU 220V, PRODUTO DEVE CONTER DADOS DO FABRICANTE, ASSISTÊNCIA NO ESTADO DE GOIÁS.

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: GO

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

31.770.650/0001-40

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

R\$ 33.000,00

* VENCEDOR *

EIRELI

Descrição: Descrição não informada



Relatório gerado no dia 25/11/2022 12:19:15 (IP: 177.74.58.82)

Código Validação: XHamiWku%2f5nMLK6rUlmNOZk45eUI7PEuhNbHedwt1AqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=XHamiWku%2f5nMLK6rUlmNOZk45eUI7PEuhNbHedwt1AqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 29.334.988/0001-07 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI
 Descrição: Descrição não informada
 28.790.815/0001-30 INFOKO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Descrição: Descrição não informada

Valor da Proposta Inicial

R\$ 33.000,00

R\$ 33.068,00



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 31.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO

Objeto: Formação de Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de Material e Equipamentos Permanentes conforme necessidade do Centro Cirúrgico Municipal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição: FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR É UM EQUIPAMENTO MÓVEL COMPOSTO POR UM SISTEMA DE UM BRAÇO E UMA CÚPULA. OS MÓDULOS COM LENTES DE ALTO RENDIMENTO PERMITEM QUE CADA CÚPULA ATINJA UMA INTENSIDADE LUMINOSA DE 120.000 LUX A UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO DO CAMPO OPERATÓRI - FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR É UM EQUIPAMENTO MÓVEL COMPOSTO POR UM SISTEMA DE UM BRAÇO E UMA CÚPULA. OS MÓDULOS COM LENTES DE ALTO RENDIMENTO PERMITEM QUE CADA CÚPULA ATINJA UMA INTENSIDADE LUMINOSA DE 120.000 LUX A UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO DO CAMPO OPERATÓRIO. OS LED'S BRANCOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO UNIDOS A LENTES DE ALTO DESEMPENHO GARANTEM UM MAIOR CAMPO LUMINOSO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. O EQUIPAMENTO FORNECE ILUMINAÇÃO DE QUALIDADE E ALTA VIDA ÚTIL DOS LEDS, SEM EMISSÃO DE RADIAÇÃO INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA GARANTINDO A MÍNIMA GERAÇÃO DE CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO, O QUE IMPEDE A DESSECAÇÃO DOS TECIDOS. POSSUI CONTROLE ELETRÔNICO INTELIGENTE QUE MONITORA A TEMPERATURA DOS MÓDULOS DE LED, O QUE PERMITE ALCANÇAR GRANDE VIDA ÚTIL DO PRODUTO, MINIMIZANDO AS ROTINEIRAS MANUTENÇÕES DE FOCOS CONVENCIONAIS. A PROTEÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO É FEITA COM FUSÍVEL SUBSTITUÍVEL. PAINEL DE CONTROLE: AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA E AJUSTE DE TEMPERATURA DE COR FEITO VIA PAINEL DE CONTROLE EM LCD LOCALIZADO NO BRAÇO DA CÚPULA. AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA. FUNÇÃO ENDO (MODO PENUMBRA). FUNÇÃO LIGA E DESLIGA. SISTEMA DE BRAÇOS E MOVIMENTAÇÕES: POSSIBILITA O MOVIMENTO CIRCULAR EM TORNO DA BASE, BASCULANTE EM TORNO DA ARTICULAÇÃO DA HASTE, TORÇÃO DA CÚPULA EM TORNO DO BRAÇO MÓVEL E FLEXÃO DA CÚPULA EM TORNO DE SEU EIXO. BRAÇO ARTICULADO VERTICAL: 30°. PARA CIMA E 45°. PARA BAIXO NA VERTICAL. O ARCO DUPLO, DIRETAMENTE CONECTADO A CÚPULA, PERMITE O MOVIMENTO DE 270°. BASE CONFECCIONADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO REFORÇO EM FORMATO "H" LIVRE DE CORROSÃO. 04 RODÍZIOS EM PVC COM SISTEMA DE FREIO EM TODAS AS RODAS PARA MAIOR SEGURANÇA PROPORCIONANDO GIRO LIVRE DE 360° SISTEMA DE EMERGÊNCIA: SISTEMA DE BACKUP PARA CASOS DE FALTA DE ENERGIA, QUE AUTOMATICAMENTE TRANSFERE A ALIMENTAÇÃO DA REDE PARA UMA FONTE AUXILIAR (BATERIA). QUANDO OPERADO PELO SISTEMA DE EMERGÊNCIA, A CÚPULA PERMANECE EM FUNCIONAMENTO POR UM PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS, VOLTANDO À OPERAÇÃO NORMAL DO EQUIPAMENTO QUANDO RESTABELECIDA A ENERGIA DA REDE. A CARGA DA BATERIA PODE SER MONITORADA POR LEDS INDICATIVOS NA CAIXA DA BATERIA.

Data: 16/05/2022 09:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 41600

Lote/Item: 13/13

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [licitanet.com.br](#)

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: RO

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 06.253.085/0001-04 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTAES LTDA
 * VENCEDOR *

Valor da Proposta Inicial

R\$ 24.000,00

Descrição: Descrição não informada

24.237.168/0001-83 TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 30.000,00



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

Descrição: ESTUFA BACTERIOLÓGICA – MOD. SLSB 85L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna com pintura eletrostática em epóxi liso; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Pannel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 70°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 85 Litros; - Medidas internas: A = 45 x L = 45 x C = 42 cm; - Medidas externas: A = 66 x L = 56 x C = 57 cm; - Potência: 600 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço carbono; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 3.953,33

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: UNESP-CAMPUS EXPERIMENTAL DE DRACENA
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DRACENA

Data: 03/06/2022 17:23

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 102329100612022OC00031

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: SP

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS – ENTREGA IMEDIATA
Descrição: INCUBADORA LABORATORIAL PARA INDICADORES BIOLOGICOS CAP 75 L -
INCUBADORA LABORATORIAL, PARA INDICADORES MICROBIOLOGICOS COM
TEMPERATURA MAXIMA DE 75 GRAUS CELSIUS, PROCESSO DE
ESTERILIZACAO A VAPOR; DETECCAO E LEITURA DE CRESCIMENTO
BACTERIANO, CAPACIDADE APROXIMADA DE 75 LITROS, ALIMENTACAO
BIVOLT, ACOMPANHA MANUAL EM LINGUA PORTUGUESA; GARANTIA MIN DE
12 MESES; ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 2.720,00

Descrição: INCUBADORA LABORATORIAL, PARA INDICADORES MICROBIOLOGICOS COM TEMPERATURA MAXIMA DE 75 GRAUS CELSIUS, PROCESSO DE ES
TERILIZACAO A VAPOR; DETECCAO E LEITURA DE CRESCIMENTO BACTERIANO, CAPACIDADE APROXIMADA DE 75 LITROS, ALIMENTACAO BIVOLT, ACOMPANHA
MANUAL EM LINGUA PORTUGUESA; GARANTIA MIN DE 12 MESES; ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

38.419.205/0001-89 CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI

R\$ 3.590,00

Descrição: INCUBADORA LABORATORIAL, PARA INDICADORES MICROBIOLOGICOS COM TEMPERATURA MAXIMA DE 75 GRAUS CELSIUS, PROCESSO DE ES
TERILIZACAO A VAPOR; DETECCAO E LEITURA DE CRESCIMENTO BACTERIANO, CAPACIDADE APROXIMADA DE 75 LITROS, ALIMENTACAO BIVOLT, ACOMPANHA
MANUAL EM LINGUA PORTUGUESA; GARANTIA MIN DE 12 MESES; ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

11.232.743/0001-03 SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

R\$ 5.550,00

Descrição: INCUBADORA LABORATORIAL, PARA INDICADORES MICROBIOLOGICOS COM TEMPERATURA MAXIMA DE 75 GRAUS CELSIUS, PROCESSO DE ES
TERILIZACAO A VAPOR; DETECCAO E LEITURA DE CRESCIMENTO BACTERIANO, CAPACIDADE APROXIMADA DE 75 LITROS, ALIMENTACAO BIVOLT, ACOMPANHA
MANUAL EM LINGUA PORTUGUESA; GARANTIA MIN DE 12 MESES; ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

Preço BPS (Ministério da Saúde) 1:

R\$ 12.870,72

Preço Complementar

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL

Data: 08/02/2022 00:00

Objeto: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE, TIPO: PARA INDICADOR BIOLÓGICO, TEMPERATURA: CONTROLE
TEMPERATURA ATÉ 60 °C, COMPONENTES: COM TAMPA SUPERIOR, OUTROS
COMPONENTES: ATÉ 10 AMPOLAS

Identificação: BR0431126

Fonte: Ministério da Saúde

Modalidade: Pregão

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: ES

Fornecedor: CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Cidade: RIO BANANAL



Item 7: INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTOCONTIDO

Preço Estimado: R\$ 2.632,69 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 2.632,69

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.632,69

Quantidade	Descrição	Observação
100 Caixas	Especificação : Para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo, suporta variações de 118°C a 137°C de temperatura, com tempo de leitura final em 3 horas. CAIXA COM 50 UNIDADES	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca

Objeto: Aquisição de materiais biológicos..

Descrição: Indicador biológico - Indicador Biológico Espécie: Bacillus Stearothermophilus ,
Aplicação: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: Com Indicador Químico E Controle De Processo , Adicionais: Pacote Para Teste , Tipo: Terceira Geração , Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura

CatMat: 340941 - INDICADOR BIOLÓGICO

Data: 23/09/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:72022 / UASG:254450

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: RJ



R\$ 4.169,43

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.137.575/0001-08	MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 3.000,00
Descrição: INDICADOR BIOLÓGICO AUTO CONTIDO CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVES A VAPOR. COMPOSTO DE ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, ACONDICIONADO EM AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO AMPOLA COM CALDO NUTRIENTE. LEITURA FINAL EM ATÉ 3 HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA Cx c/50un		
18.269.125/0001-87	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	R\$ 4.608,30
* VENCEDOR *		
Descrição: INDICADOR BIOLÓGICO ATTEST VAPOR C 50 1292 SERÁ FORNECIDO EM COMODATO 1 (UM) EQUIPAMENTO - CATMAT: 340941 Laboratório: 3M Registro M.S.: ISENT0 Procedência: NACIONAL Marca: 3M Fabricante: 3M		
24.632.970/0001-78	LB DISTRIBUICAO EIRELI	R\$ 4.900,00
Descrição: INDICADOR BIOLÓGICO AUTO CONTIDO CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVES A VAPOR. COMPOSTO DE ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, ACONDICIONADO EM AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO AMPOLA COM CALDO NUTRIENTE. LEITURA FINAL EM ATÉ 3 HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA -		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Serviços Gerais

Objeto: Aquisição de materiais odontológicos e hospitalares para atender às necessidades do curso de Odontologia da Universidade Federal do Paraná.

Descrição: Indicador biológico - Indicador Biológico Espécie: Bacillus Stearothermophilus ,
Aplicação: Para Esterilização A Vapor , Tipo: Terceira Geração , Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura

CatMat: 339628 - INDICADOR BIOLÓGICO

Data: 31/08/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1142022 / UASG:153079

Lote/Item: /38

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: PR

R\$ 1.393,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.924.875/0001-91	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	R\$ 1.393,00
* VENCEDOR *		



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

Descrição: "Indicador Biológico autocontido, de terceira geração, com resposta final em 3 horas, para controle biológico dos processos de esterilização a Vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo. A tira com o esporo do *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 encontra-se armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo do microrganismo. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom com janelas laterais e protegida por um papel filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para a identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. O produto fluorescente que se gera com o resultado da atividade enzimática pode ser detectado com grande sensibilidade pela incubadora Bionova® IC 1020FR, Minibio, ou qualquer outra incubadora por uorescência disponível no mercado, desenvolvida para produtos com especificações similares. Fabricante: Terragene, Marca: Sispac; Modelo: SP220. Procedência: Argentina; Agente esterilizante: Vapor; Parâmetros: Ciclos de 121°C a 135°C; Tipo de leitura: Fluorescência; Temperatura de incubação: 60°C +/- 2°C; Tempo de resposta: 3 horas Apresentação: Caixa com 50 unidades Validade: 2 anos; Registro ANVISA: Dispensado. Norma Regulamentadora: ISO 11138-1: 2016"



27.401.513/0001-60 DEVANT CARE COMERCIAL LTDA

R\$ 1.393,00

Descrição: Indicador Biológico com Leitura Fluorimétrica para Vapor, Leitura Fluorimétrica Final em 3H e Colorimétrica Final em 24H. CAIXA COM 50 UNIDADE S.

38.049.999/0001-36 D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 1.393,00

Descrição: INDICADOR BIOLÓGICO TIPO AUTO-CONTIDO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, RESPOSTA EM 3 HORAS. CAIXA 50 UNIDADE RMS ISENTO RDC 260/2002

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.703,33

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: HOSPITAL REGIONAL DEOCLÉCIO MARQUES DE LUCENA

Data: 01/06/2022 10:00

Objeto: O presente Termo de Referência tem como objetivo à aquisição de material, tipo, testes biológicos e químicos, para uso na central de material e esterilização, para atender as cirurgias realizadas no Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:52022 / UASG:926787

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 09/06/2022 13:10

Homologação: 10/06/2022 11:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

UF: RN

Descrição: Indicador Biológico - Indicador Biológico Espécie: *Bacillus Stearothermophilus*, Aplicação: Para Esterilização A Vapor, Componentes Adicionais: Com Indicador Químico E Controle De Processo, Adicionais: Pacote Para Teste, Tipo: Terceira Geração, Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura

CatMat: 340941 - INDICADOR BIOLÓGICO

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

30.597.921/0001-44 IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 1.200,00

Descrição: Indicador Biológico Espécie: *Bacillus Stearothermophilus*, Aplicação: Para Esterilização A Vapor, Componentes Adicionais: Com Indicador Químico E Controle De Processo, Adicionais: Pacote Para Teste, Tipo: Terceira Geração, Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura MARCA: CLICKTEST / 3H FABRICANTE: MAXXIMED RMS: ISENTO

22.958.146/0001-87 MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

R\$ 1.910,00

Descrição: INDICADOR BIOLÓGICO 40 MINUTOS - STERIS - Sistema de Leitura Rápida por Fluorescência. Indicador Biológico Autocontido para processos de esterilização a Vapor. Os Indicadores Biológicos de Leitura Rápida por Fluorescência BT220 para vapor, foram desenhados para avaliação rápida e fácil de ciclos de esterilização a vapor a 121-134 °C assistidos por vácuo ou com deslocamento de ar por gravidade. Composição: Cada tubo contém uma população *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 esporos inoculados em uma tira (portador de esporos). Conformidade: Conforme ANSI/ AAMI/ ISO1140: 1; 3; 4. Isento de registro conforme RDC 185/01 e RDC 24/09. Atende aos requisitos da RDC 15/12. COMODATO 01 INCUBADORA LCB030. (CX COM 25 UND)

17.624.087/0001-70 RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA

R\$ 2.000,00

Descrição: INDICADOR BIOLÓGICO ESPÉCIE: *BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS*, APLICAÇÃO: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS: COM INDICADOR QUÍMICO E CONTROLE DE PROCESSO, ADICIONAIS: PACOTE PARA TESTE, TIPO: TERCEIRA GERAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESPOSTA EM ATÉ 3 HORAS, APRESENTAÇÃO: AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA.

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 3.265,00



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Uberlândia

Objeto: Aquisição de material de consumo médico, hospitalar, odontológico entre outros relacionados à saúde humana..

Descrição: Indicador Biológico - Espécie: Bacillus Stearothermophilus, Aplicação: Para Esterilização A Vapor, Tipo: Segunda Geração, Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura,

CatMat: 332503 - INDICADOR BIOLÓGICO

Data: 23/05/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:232022 / UASG:154043

Lote/Item: /66

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MG



Valor da Proposta Inicial

CNPJ Razão Social do Fornecedor

06.990.955/0001-10 DATHA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E NUTRICIONAIS EIRELI

R\$ 1.530,00

Descrição: TUBO INDICADOR BIOLÓGICO INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DO TIPO AUTOCONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, INDICADO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES EQUIPADOS COM PRÉ-VACUO OU ESTERILIZADORES GRAVITACIONAIS, COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA DE 100.000(CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOPACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953, COM CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE ASSEGURADA) ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CALDO NUTRIENTE, FECHADO POR TAMPÃO MARROM COM ABERTURAS LATERAIS PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO, COM ROTULO EXTERNO INFORMA LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO CAIXA COM 50 TUBOS.

10.824.101/0001-30 MAKLAB COMERCIAL LTDA

R\$ 5.000,00

* VENCEDOR *

Descrição: Espécie: Bacillus Stearothermophilus, Aplicação: Para Esterilização A Vapor, Tipo: Segunda Geração, Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura,

Item 8: MESA CIRURGICA ELETRICA FORMATO TIPO T

Preço Estimado: R\$ 94.962,49 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 94.962,49

Média dos Preços Obtidos: R\$ 94.962,49

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Especificação : Chapa de aço 1020, com acabamento em pintura epóxi, sistema de fixação e movimentação realizado através de rodízios e pés retráteis, CHASSI confeccionado em chapas de aço, com reforço estrutural, possui acabamento em pintura epóxi e carenagem em aço inoxidável, Com Régua Lateral para colocação de acessórios fabricadas em aço inoxidável TAMPO Radiotransparente dividido em 5 seções, sendo elas: cabeça, renal, dorso, assento e pernas bipartidas. Movimentos de elevação através de sistema elétrico acionado por controle remoto a cabo e controle de emergência no próprio painel da mesa. Capacidade de Carga de até 300 Kg. MOVIMENTOS: Elevação e Regresso do Tampo Trendelemburg e Reverso Trendelemburg Elevação e Regresso do Dorso Lateral Esquerda e Direita Rotação de Pernas e Inversão de Pernas com Cabeceira Deslizamento Longitudinal. Acessórios: 01 jogo de colchonetes injetados em PU, 01 arco de narcose, 01 par de portas coxas, 01 par de suporte de braço, 01 par de ombreira. Dimensões aproximadas: Comprimento 2040mm, Largura 550mm, Altura Máxima 1070mm, Altura mínima 750mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 108.960,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: HOSPITAL REGIONAL DEOCLÉCIO MARQUES DE LUCENA

Data: 26/07/2022 10:00

Objeto: O presente edital tem como objetivo a aquisição de material permanente tipo mesa cirúrgica ortopédica elétrica e rádio-transparente, com ajustes combinados para oferecer uma variedade de posições, inclusive tração de membros inferiores para facilitar reduções de fraturas, e que possibilite ao paciente conforto em todos os procedimentos cirúrgicos para o Centro Cirúrgico do HRDML, visando atender as necessidades do Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:62022 / UASG:926787

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/08/2022 11:31

Homologação: 01/08/2022 14:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RN

Descrição: Mesa Cirúrgica - Mesa Cirúrgica Capacidade: 300 KG, Características Adicionais: Balança Digital, Colchonete Poliuretano Injetado, Tipo Fixação: Arco Narcose, Dispositivo Coleta Líquidos, Tipo Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Tampo Leito: Tampo Radiotransparente C/Suporte E Gaveta P/Rx, Tipo Movimento Elevação: Deslizante, Dividida Em 5 Seções, Elevação Renal, Ombreira: Par De Ombreiras, Suporte Lateral: Com Suporte Lateral, Comando Movimento: Elétrico



Relatório gerado no dia 25/11/2022 12:19:15 (IP: 177.74.58.82)

Código Validação: xHamiWku%2f5nMLK6rUImNOZk45eUI7PEcuhNbHedwt1AqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xHamiWku%2f5nMLK6rUImNOZk45eUI7PEcuhNbHedwt1AqHU8nPtm6WA%3d%3d%3d



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
79.805.263/0001-28	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	R\$ 108.960,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Descritivo: Idealizada para a utilização do arco em C através do movimento deslizante do leito com finalidade de permitir ampla diversidade de procedimentos cirúrgicos. Proporciona movimentos suaves e precisos do leito, por meio de motores de funcionamento absolutamente silencioso. Possui sistema de emergência de acionamento automático para casos de falta de energia. Leito articulável, tampo confeccionado em fenolite radiotransparente para uso do intensificador de imagem, raio X em toda sua extensão, com deslocamento longitudinal (melhorando o desempenho no uso do arco cirúrgico) de 350 mm para direita e 350 mm para a esquerda, através do uso do controle remoto, com réguas laterais em inox para fixação dos acessórios. Sistema anticolisão para evitar danos a mesa em sua movimentação. Base retangular constituída e revestida em aço inoxidável (cromo níquel) anti-corrosão, com espessura mínima capaz de suportar os mais diversos procedimentos, com revestimento de carenagem em polímero ABS reforçado. A movimentação da base é realizada através de 04 rodízios de 5" com giro de 360° podendo ser fixo, com bloqueio e desbloqueio motorizado, (movimentação e fixação e freios motorizados) acionados através de teclas pelo controle remoto com cabo espiralado de 2m e no painel de controle na coluna da mesa. Coluna de elevação composta de 04 colunas guias lineares revestidas em cromo duro retificado e por três seções garantindo um maior curso, com altura mínima menor. Os movimentos de elevação através de sistema elétrico, acionado por controle remoto a cabo e na própria coluna da mesa. Estrutura do leito em chapas de aço inox. Tensão bivolt (127/220V). Capacidade de carga 360 kg. LEITO: Chassi, coluna e estrutura fabricada em aço inoxidável AISI 304 anti-corrosão, perfilada, sistema que permite maior rigidez e proporciona blindagem em de todo o sistema interno evitando a penetração de líquidos, facilitando a limpeza. Leito Articulável e dividida em 05 (cinco) seções (cabeceira, dorso do tampo, assento do tampo, renal e pernas retráteis; Régua em aço inoxidável AISI 304 para colocação de acessórios em toda extensão do leito. Sistema de segurança, tipo fim de curso. MOVIMENTOS DO LEITO: deslizamento longitudinal, trendelenburg, proclive ou reverso de trendelenburg, litotômica, elevação, horizontal, lateral esquerda / lateral direita, Flex / Reflex; semi flexão da perna e coxa, flexão abdominal, semi sentado, sentado, para operação da tireoide, extrema lordose e renal. Dorso e deslocamento longitudinal são realizados por atuadores elétricos lineares, acionados por controle remoto a cabo e na própria estrutura da coluna da mesa. Movimentação de inclinação frontal do tampo, em relação ao eixo horizontal, com faixa de ajuste no mínimo entre 20° para cima e 25° para baixo; Movimentação de inclinação lateral do tampo, em relação ao eixo horizontal de 15° para esquerda e direita; Movimentação do dorso do tampo, em relação ao eixo horizontal, com faixa de ajuste no mínimo entre 70° para cima e 25° para baixo; Movimentação de flexão abdominal, relativo ao ângulo superior entre dorso e assento, com faixa de ajuste no mínimo da posição horizontal (180°) até 120° entre dorso e assento; Movimentação de flexão lombar, relativo ao ângulo superior entre dorso e assento, com faixa de ajuste no mínimo da posição horizontal (180°) até 200° entre dorso e assento; Motorizados: os movimentos de semi-flexão de pernas e coxas, semi sentado, extrema lordose, litotômica, para operação de tiróide, trendelenburg, proclive ou reverso de trendelenburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso e deslocamento longitudinal são realizados por atuadores lineares elétricos. Acompanha a Mesa baterias especiais com duração de uma semana. O estado da carga da bateria é controlado eletronicamente e indicado visualmente. Possui tecla zero para que ao ser acionada produza uma sequência de movimentos até atingir a posição zero (0) inicial ou sequencial de movimentos, conforme a necessidade do usuário. Pneumáticos: sistema de movimentação das pernas que são bi-partidas retráteis em V e removíveis. Mecânicos: sistema de movimentação da cabeceira que é removível. O renal acionado através de manivelas removíveis. Renal: proporcionado por manivela removível localizada na lateral da mesa. Cabeceira: Movimento manual através de sistema de engrenagens. Pernas: apoio de pernas bi-partido removível com sistema de regulação pneumática e movimento de rotação, acionados manualmente, facilita utilização em vídeo-laparoscopia. Controle: Acompanha a Mesa 02 (dois) tipos de controles: controle remoto com fio e controle de emergência no painel de controle na coluna da mesa, com as seguintes teclas: tecla para bloqueio e desbloqueio das demais teclas e funções de teclado / tecla para elevar o tampo / tecla para abaixar o tampo / tecla para elevar o dorso / tecla para abaixar o dorso / tecla para movimento de trendelenburg / e tecla para o reverso do trendelenburg

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 85.863,87

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de estado da Saúde

Data: 06/07/2022 10:00

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades das unidades de saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão/SES, conforme especificação e condições gerais de fornecimento contidas no Termo de Referência (ANEXO I) do edital..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:252022 / UASG:425128

Lote/Item: /12

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: MA

Descrição: Mesa cirúrgica - Tipo Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Tampo Leito: Tampo Radiotransparente C/Suporte E Gaveta P/Rx, Tipo Movimento Elevação: Deslizante, Dividida Em 5 Seções, Elevação Renal, Ombreira: Par De Ombreiras, Suporte Lateral: Com Suporte Lateral, Tipo Fixação: Arco Narcose, Dispositivo Coleta Líquidos, Comando Movimento: Elétrico, Características Adicionais: Balança Digital, Colchonete Poliuretano Injetado, Capacidade: 300 KG,

CatMat: 328269 - MESA CIRÚRGICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.531.928/0001-26	V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 78.600,00



Descrição: MESA CIRURGICA COM TRAÇÃO ORTOPÉDICA, ELÉTRICA com as características mínimas: Mesa cirúrgica elétrica para uso em: Cirurgia Geral, Bariátrica, Neurológica, Vascular, Gástrica, Plástica, Oncológica, Oftalmológica, Otorrinolaringológica, Ginecológica, Urológica, Proctológica, Ortopédica, Laparoscópica e Endoscópica; Base integrada com rodas para movimentação do equipamento e sistema de freio com comando único; Estrutura física feita em aço inoxidável ou superior, e tampo da mesa cirúrgica em material radio transparente e livre de barras transversais, para permitir o uso de equipamentos com tecnologia de Raio-X; Tampo cirúrgico com no mínimo as seguintes partes: cabeceira, dorso, assento, placas de apoio para as pernas; Sistema de engate rápido para a cabeceira e placas de apoio para as pernas; Comprimento do tampo da mesa cirúrgica de 2050 mm (± 100 mm) Largura do tampo da mesa cirúrgica de 550 mm (± 50 mm); Sistema de movimentação eletrohidráulico ou elétrico, com acionamento via comando digital dedicado, através de controle remoto, no mínimo para os seguintes movimentos: dorso, elevação, lateral, trendelemburg, retorno à posição inicial "0" e travamento/destravamento dos rodízios. Os movimentos de cabeceira e pernas poderão ser realizados de forma elétrica, pneumática ou manual; Comandos eletrônicos por controle remoto e painel na mesa; Ajuste manual ou elétrico longitudinal de no mínimo 240 mm, e manual da cabeceira e placas de apoio para as pernas; Sistema de segurança, tipo fim de curso ou similar, para evitar danos ao equipamento durante o acionamento das movimentações eletro-hidráulicas ou elétricas; Altura do tampo, em relação ao piso, com faixa de ajuste no mínimo de 700 mm até 950 mm (± 50 mm); Movimentação de deslocamento longitudinal do tampo, em relação à base do equipamento, com faixa de ajuste no mínimo de 0 até 240 mm; Movimentação de inclinação frontal do tampo, em relação ao eixo horizontal, com faixa de ajuste no mínimo entre 20° para cima e 25° para baixo; Movimentação de inclinação lateral do tampo, em relação ao eixo horizontal de 15° para esquerda e direita; Movimentação de flexão abdominal, relativo ao ângulo superior entre dorso e assento, com faixa de ajuste no mínimo da posição horizontal (180°) até 120° entre dorso e assento; Movimentação de flexão lombar, relativo ao ângulo superior entre dorso e assento, com faixa de ajuste no mínimo da posição horizontal (180°) até 200° entre dorso e assento; Capacidade de peso admissível igual ou superior a 350 kg; Autonomia de energia com bateria interna recarregável de tecnologia MODELO: VISION T 4 ELÉTRICA MARCA: KSS FABRICANTE: FABRICANTE: KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA PROCEDÊNCIA: BRASIL RMS: 10242640023



02.683.235/0001-50 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 83.991,60

Descrição: MESA CIRURGICA COM TRAÇÃO ORTOPÉDICA, ELÉTRICA COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA USO EM: CIRURGIA GERAL, BARIÁTRICA, NEUROLÓGICA, VASCULAR, GÁSTRICA, PLÁSTICA, ONCOLÓGICA, OFTALMOLÓGICA, OTORRINOLARINGOLÓGICA, GINECOLÓGICA, UROLÓGICA, PROCTOLÓGICA, ORTOPÉDICA, LAPAROSCÓPICA E ENDOSCÓPICA; BASE INTEGRADA COM RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO E SISTEMA DE FREIO COM COMANDO ÚNICO; ESTRUTURA FÍSICA FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL OU SUPERIOR, E TAMPO DA MESA CIRÚRGICA EM MATERIAL RADIO TRANSPARENTE E LIVRE DE BARRAS TRANSVERSAIS, PARA PERMITIR O USO DE EQUIPAMENTOS COM TECNOLOGIA DE RAIO-X; TAMPO CIRÚRGICO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE PARTES: CABECEIRA, DORSO, ASSENTO, PLACAS DE APOIO PARA AS PERNAS; SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PARA A CABECEIRA E PLACAS DE APOIO PARA AS PERNAS; COMPRIMENTO DO TAMPO DA MESA CIRÚRGICA DE 2050 MM (± 100 MM) LARGURA DO TAMPO DA MESA CIRÚRGICA DE 550 MM (± 50 MM); SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO ELETROHIDRÁULICO OU ELÉTRICO, COM ACIONAMENTO VIA COMANDO DIGITAL DEDICADO, ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO, NO MÍNIMO PARA OS SEGUINTE MOVIMENTOS: DORSO, PERNAS, ELEVÇÃO, LATERAL, TRENDELEMBURG, RETORNO À POSIÇÃO INICIAL "0" E TRAVAMENTO/DESTRVAMENTO DOS RODÍZIOS; COMANDOS ELETRÔNICOS POR CONTROLE REMOTO E PAINEL NA MESA; AJUSTE MANUAL OU ELÉTRICO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 240 MM, E MANUAL DA CABECEIRA E PLACAS DE APOIO PARA AS PERNAS; SISTEMA DE SEGURANÇA, TIPO FIM DE CURSO OU SIMILAR, PARA EVITAR DANOS AO EQUIPAMENTO DURANTE O ACIONAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES ELETRO HIDRÁULICAS; ALTURA DO TAMPO, EM RELAÇÃO AO PISO, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO DE 700 MM ATÉ 950 MM (± 50 MM); MOVIMENTAÇÃO DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO, EM RELAÇÃO À BASE DO EQUIPAMENTO, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO DE 0 ATÉ 240 MM; MOVIMENTAÇÃO DE INCLINAÇÃO FRONTAL DO TAMPO, EM RELAÇÃO AO EIXO HORIZONTAL, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO ENTRE 20° PARA CIMA E 25° PARA BAIXO; MOVIMENTAÇÃO DE INCLINAÇÃO LATERAL DO TAMPO, EM RELAÇÃO AO EIXO HORIZONTAL DE 15° PARA ESQUERDA E DIREITA; MOVIMENTAÇÃO DO DORSO DO TAMPO, EM RELAÇÃO AO EIXO HORIZONTAL, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO ENTRE 70° PARA CIMA E 25° PARA BAIXO; MOVIMENTAÇÃO DE FLEXÃO ABDOMINAL, RELATIVO AO ÂNGULO SUPERIOR ENTRE DORSO E ASSENTO, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO DA POSIÇÃO HORIZONTAL (180°) ATÉ 120° ENTRE DORSO E ASSENTO; MOVIMENTAÇÃO DE FLEXÃO LOMBAR, RELATIVO AO ÂNGULO SUPERIOR ENTRE 29 DORSO E ASSENTO, COM FAIXA DE AJUSTE NO MÍNIMO DA POSIÇÃO HORIZONTAL (180°) ATÉ 200° ENTRE DORSO E ASSENTO; CAPACIDADE DE PESO ADMISSÍVEL IGUAL OU SUPERIOR A 350 KG; AUTONOMIA DE ENERGIA COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE TECNOLOGIA SEM EFEITO MEMÓRIA E CARREGAMENTO ACOPLADA AO EQUIPAMENTO; INDICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELÉTRICA OU BATERIA; INDICAÇÃO PARA BATERIA COM CARGA BAIXA; TENSÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS / 60 HZ; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 (UM) CONTROLE REMOTO RETRO ILUMINADO, COM TODOS OS COMANDOS DIGITAIS DOS MOVIMENTOS ELETROHIDRÁULICOS, 01 (UM) TAMPO COMPLETO, COMPOSTO POR CABECEIRA (COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, PARA CIMA E PARA BAIXO), DORSO, ASSENTO E PAR DE PLACAS DE APOIO PARA AS PERNAS (SEPARÁVEIS E ARTICULADAS); 01 (UM) CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TODA A EXTENSÃO DO TAMPO, SENDO RADIO TRANSPARENTE, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 60MM E REVESTIMENTO QUE PERMITA FÁCIL ASSEPSIA; 01 (UM) CONJUNTO DE CINTA PARA FIXAÇÃO DO CORPO; 01 (UM) CONJUNTO PORTA COXA 2 UNIDADES COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO NA MESA; 01 (UM) CONJUNTO OMBREIRAS 2 UNIDADES COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO NA MESA; 01 (UM) PAR DE CONJUNTO DE APOIO PARA OS BRAÇOS 2 UNIDADES, COM CINTA DE FIXAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO NA MESA; 01 (UM) CONJUNTO ORTOPÉDICO (FIXADO NO TAMPO) COM OS ITENS: 02 (DOIS) TRAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES COM EXTENSOR FIXADO NO TAMPO E REGULAGEM E TRAVA DE MOVIMENTO GIRATÓRIO E RODÍZIOS, COM COLUNA E TRAVA DE REGULAGEM DE ALTURA, COM BOTA E CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS COM REGULAGEM DE POSICIONAMENTO; 01 (UM) EXTENSOR COM APOIO PÉLVICO; 02 (DOIS) TRAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES WEINBERGER COM REGULAGEM DE ALTURA E POSICIONAMENTO; 01 (UM) SUPORTE PARA CIRURGIA DE MÃO COM REGULAGEM DE ALTURA; 01 (UM) ARCO DE NARCOSE COM ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO; DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E SUAS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. EXIGÊNCIAS: MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS (BRASIL); APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ABAIXO CONFORME AS NORMAS RDC32/2007, IN Nº 04 DE 24/07/2015 E IN Nº22 DE 22/10/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1 (SEGURANÇA ELÉTRICA) E NBR IEC 60601-1-2 (COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA). COMPROVANTE DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA VIGENTE; GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24(VINTE E QUATRO) MESES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DURANTE O PERÍODO, SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE. NO CASO A LICITANTE NÃO SER FABRICANTE, APRESENTAR DECLARAÇÃO DA GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24(VINTE E QUATRO) MESES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DURANTE O PERÍODO,.... E DEMAIS ESPECIFICAÇÃO CONSTANTES TR. REG 80918710002

02.836.248/0001-12 BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS
* VENCEDOR * HOSPITALARES LTDA

R\$ 95.000,00



Relatório gerado no dia 25/11/2022 12:19:15 (IP: 177.74.58.82)

Código Validação: XHamiWku%25f5nMLK6rUlmNOZk45eUI7PEcuhNbHedwt1AqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=XHamiWku%25f5nMLK6rUlmNOZk45eUI7PEcuhNbHedwt1AqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Descrição: MESA CIRURGICA COM TRAÇÃO ORTOPÉDICA ELÉTRICA Mesa cirúrgica elétrica para uso em: Cirurgia Geral, Bariátrica, Neurológica, Vascular, Gás trica, Plástica, Oncológica, Oftalmológica, Otorrinolaringológica, Ginecológica, Urológica, Proctológica, Ortopédica, Laparoscópica e Endoscópica. Base integrada a com rodas para movimentação do equipamento e sistema de freio com comando único; Estrutura física feita em aço inoxidável ou superior, e tampo da mesa cirúrgica em material radio transparente e livre de barras transversais, para permitir o uso de equipamentos com tecnologia de Raio-x; Tampo cirúrgico com as seguintes partes: cabeceira, dorso, assento, placas de apoio para as pernas; Sistema de engate rápido para a cabeceira e placas de apoio para as pernas; Comp rimento do tampo da mesa cirúrgica de 2050 mm (± 100 mm); Largura do tampo da mesa cirúrgica de 550 mm (± 50 mm); Sistema de movimentação elétrico, com acionamento via comando digital dedicado, através de controle remoto, no mínimo para os seguintes movimentos: dorso, pernas, elevação, lateral, trendel emburg, retorno à posição inicial "0" e travamento/destravamento dos rodízios; Comandos eletrônicos por controle remoto e painel na mesa; Ajuste manual ou elétrico longitudinal de 300 mm, e manual da cabeceira e placas de apoio para as pernas; Sistema de segurança, tipo fim de curso ou similar, para evitar danos ao equipamento durante o acionamento das movimentações eletro hidráulicas; Altura do tampo, em relação ao piso, com faixa de ajuste de 700 mm até 1000 mm (± 50 mm); Movimentação de deslocamento longitudinal do tampo, em relação à base do equipamento, com faixa de ajuste no de 0 até 300 mm; Moviment ação de inclinação frontal do tampo, em relação ao eixo horizontal, com faixa de ajuste no mínimo entre 20° para cima e 25° para baixo; Movimentação de incli nação lateral do tampo, em relação ao eixo horizontal de 15° para esquerda e direita; Movimentação do dorso do tampo, em relação ao eixo horizontal, com faix a de ajuste no mínimo entre 70° para cima e 25° para baixo; Movimentação de flexão abdominal, relativo ao ângulo superior entre dorso e assento, com faixa de ajuste no mínimo da posição horizontal (180°) até 120° entre dorso e assento; Movimentação de flexão lombar, relativo ao ângulo superior entre 29 dorso e ass ento, com faixa de ajuste no mínimo da posição horizontal (180°) até 200° entre dorso e assento; Capacidade de peso admissível igual ou superior a 420 kg; Aut onomia de energia com bateria interna recarregável de tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; Indicação para equipamento ligado em rede elétrica ou bateria; Indicação para bateria com carga baixa; Tensão elétrica: 220 Volts / 60 Hz; Acessórios inclusos: 01 (um) Controle remoto ret ro iluminado, com todos os comandos digitais dos movimentos elétricos; 01 (um) Tampo completo, composto por cabeceira (com inclinação ajustável, para ci ma e para baixo), dorso, assento e par de placas de apoio para as pernas (separáveis e articuladas); 01 (um) Conjunto de Colchonete para toda a extensão do T ampo, sendo radio transparente, com espessura de no mínimo 60mm e revestimento que permita fácil assepsia; 01 (um) Conjunto de Cinta para fixação do cor po; 01 (um) Conjunto porta coxa 2 unidades com elementos de fixação na mesa; 01 (um) Conjunto ombreiras 2 unidades com elementos de fixação na mesa; 0 1 (um) Par de Conjunto de apoio para os Braços 2 unidades, com cinta de fixação e elementos de fixação na mesa; 01 (um) Conjunto ortopédico (fixado no tam po) com os itens: 02 (dois) tração de membros inferiores com extensor fixado no tampo e regulagem e trava de movimento giratório e rodízios, com coluna e tr ava de regulagem de altura, com bota e cintas para fixação dos pés com regulagem de posicionamento; 01 (um) extensor com apoio pélvico; 02 (dois) tração d e membros superiores weinberger com regulagem de altura e posicionamento; 01 (um) suporte para cirurgia de mão com regulagem de altura; 01 (um) arco de narcose com elementos para fixação;



R\$ 90.063,60

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde/RR

Data: 25/01/2022 09:30

Objeto: Eventual aquisição de equipamentos hospitalares para Unidade de Saúde do interior: Hospital Pedro Alvares Rodrigues, Município de Bonfim-RR.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Mesa cirúrgica - Capacidade: 450 NaN, Tipo Fixação: Base Em "T" 0, Tipo Estrutura: Aço Inoxidável 0, Acabamento Tampo Leito: Radiotransparente 0, Tipo Movimento Elevação: Elétrica-Hidráulica 0, Comando Movimento: Travas Auto-Reguláveis, Ajuste Automático 0,

Identificação: NºPregão:32022 / UASG:456961

Lote/Item: /42

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 353558 - MESA CIRÚRGICA

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

13.390.706/0001-59

JARAGUA MERCANTIL - EIRELI

R\$ 89.744,80

Descrição: MESA CIRURGICA ELETRICA Características Gerais: BASE: Base em "T", fabricada em aço SAE 1020/45 com 6,5mm de espessura e fundo anticorr osivo aplicado pelo processo e-coat e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, curada a 220°C, revestida em aço inox AISI 304 escovado ou ABS reforç ado resistente contra impactos e saneantes. FIXAÇÃO: O sistema de movimentação e deslocamento é realizado através de rodízios com giro de 360°C, sua fix ação pode ser feita através do travamento das rodas com dispositivo interno ou rodas retráteis onde no acionamento das travas a base é fixada por quatro sap atas de apoio borracha, para garantir uma fixação segura ao piso, qualquer uma das formas de travamento pode ser acionada por sistema eletromotorizada, o u mecânico (pedal), dependendo da escolha do usuário. COLUNA: É fabricada com chapa de aço 1020/45, com 6,5mm de espessura, pintada com fundo antic orrosivo aplicado pelo processo e-coat e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, curada a 220°C, com revestimento de chapa de aço inox 304 (cromo níquel), formada por 04 (quatro) colunas guia e 04 (quatro) hastes de aço 1045 com cromo duro retificado ou formada por roletes esféricos e guias lineares que dispensam a sua lubrificação. CHASSIS: Estrutural da mesa pode ser fabricado em aço inox 304 (cromo níquel), fibra de carbono e/ou aço 1020/45. Esse pin tado com fundo anticorrosivo aplicado pelo processo e-coat e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, curada a 220°C, com revestimento de chapa de aço inox 304 (cromo níquel). TAMPO: Radio transparente em fenolite, acrílico ou fibra de carbono o qual facilita o uso do raio-x e intensificador de imagem em todo o seu comprimento, dividido em cinco seções – cabeceira (removível), dorso, renal assento e perneira (removível), com régua lateral em aço inox AISI 30 4 para fixação dos acessórios. MOVIMENTOS ELETRICOS: Elevação horizontal, trendelenburg e reverso do trendelenburg ou próclive, lateral direito, lateral es querdo, dorso ou semi-sentado e longitudinal para uso do intensificador de imagens 300mm de curso, flexão abdominal, litotômica, flexão/reflexão, todos aci onados por controle remoto com cabo e painel de controle na coluna da mesa. MOVIMENTOS PNEUMATICOS: Pernas e cabeceira que também são removív eis. POSIÇÕES: Trendelenburg, reverso do trendelenburg ou próclive, horizontal, lateral direita, lateral esquerda, semi-flexão de perna e coxa, flexão abdomina l, semi-sentado, sentado, litotômica, operação de tireóide, extrema lordose, longitudinal, altura, flex/reflex., inversão do paciente. Dimensões da Mesa: Compr imento: 1050 mm (mínimo) – 2550 mm (máximo). Largura do leito: 550 mm sem extensores laterais. Altura: 680 mm (mínimo) – 930 mm (máximo). Peso p ara pacientes até: 250 Kg. Acompanha: 01 cabeceira (estreita ou larga); 01 Arco de narcose; 01 Par de suporte lateral injetado em PU; 01 Suporte de braço injetado em PU; 01 01 Jogo de apoio de ombro injetado em PU; 01 Par de porta-coxa injetado em PU; 01 Conjunto de perneira (bipartida ou inteira); 01 Jogo de colchonetes (lavável), injetado em PU; 01 Cabo de alimentação padrão ABNT; 01 Controle remoto com cabo; 01 Manivela em aço inox para movimento rena l; 01 Conjunto de baterias (nobreak).

07.540.203/0001-10 MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA.

R\$ 90.223,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 25/11/2022 12:19:15 (IP: 177.74.58.82)

Código Validação: XHamiVku%2f5nMLK6rUlmNOZk45eUI7PEcuhNbHedwt1AqHu8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=XHamiVku%252f5nMLK6rUlmNOZk45eUI7PEcuhNbHedwt1AqHu8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

Descrição: MESA CIRÚRGICA MECÂNICA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Possui base em formato de T construída em chapa de aço, com revestimento em poliuretano ABS reforçado, com movimentação da base realizada através de rodízios. A fixação do equipamento é realizada através de trava acionada por pedal, com sapatas de apoio de borracha que garantem maior fixação ao piso. Possui coluna com guias com revestimento em aço inoxidável. Possui chassi do tampo com revestimento em aço inoxidável, dividido em 05 seções: cabeceira, dorso do tampo, renal, assento do tampo e pernas. Possui régua em aço inox para colocação de acessórios. Possui Tampo radiotransparente para uso do intensificador de imagem, raio-X em toda sua extensão, dividido em 05 seções: cabeceira, dorso do tampo, renal, assento do tampo e pernas. Os movimentos de trendelemburg, reverso de trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso, pernas e renal são acionados por manivelas removíveis localizados nas laterais ou cabeceira da mesa ou pneumáticamente. Capacidade de peso de até 250 Kg. Acompanha os seguintes acessórios: 01 Jogo de colchonetes em PU; 01 Arco de narcose; 01 Par de suportes para apoio de ombros; 01 Par de suportes de braços. GARANTIA DE 12 MESES. ANVISA: 80918710001

79.805.263/0001-28 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA

R\$ 90.223,00

Descrição: MESA CIRÚRGICA MECÂNICA ELÉTRICA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO: BASE EM FORMATO DE T CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO, COM REVESTIMENTO EM ABS OU MATERIAL SUPERIOR, COM MOVIMENTAÇÃO DA BASE REALIZADA ATRAVÉS DE RODÍZIOS. A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ATRAVÉS DE TRAVA ACIONADA POR PEDAL, COM SAPATAS DE APOIO DE BORRACHA PARA GARANTIR MAIOR FIXAÇÃO AO PISO. COLUNA COM GUIAS COM REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL. CHASSI DO TAMPO COM REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIVIDIDO EM NO MÍNIMO 04 SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO DO TAMPO, ASSENTO DO TAMPO E PERNAS. RÉGUAS EM AÇO INOX PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. TAMPO RADIO TRANSPARENTE PARA USO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM, RX EM TODA SUA EXTENSÃO, DIVIDIDO EM 04 SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO, ASSENTO, PERNAS. OS MOVIMENTOS DE TRENDLEMBURG, REVERSO DE TRENDLEMBURG, LATERAL ESQUERDO, LATERAL DIREITO, DORSO, PERNAS E RENAL DEVERÃO SER ACIONADOS POR MANIVELAS REMOVÍVEIS LOCALIZADAS NAS LATERAIS OU CABECEIRA DA MESA OU PNEUMATICAMENTE. CAPACIDADE DE PESO DE NO MÍNIMO 200 KG. ACESSÓRIOS: DEVERÃO ACOMPANHAR A MESA NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 JOGO DE COLCHONETES EM PU; 01 ARCO DE NARCOSE; 01 PAR DE SUPORTES PARA APOIO DE OMBROS; 01 PAR DE SUPORTES DE BRAÇOS. Registro no MS nº. 10242640036 e Certificado de Conformidade



Item 9: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR.

Preço Estimado: R\$ 5.973,56 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 5.973,56

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.973,56

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Especificação : Microscópio Biológico Binocular com Objetivas Planacromáticas e Óptica Infinit, Voltagem 110volts. Composição: 1 estativa e base compensada (corpo), 1 tubo binocular 30° (tipo Siedentopf), 2 oculares WF 10 x - com campo de 22mm, 1 objetiva PL 4 x planacromática, 1 objetiva PL 10 x planacromática, 1 objetiva PL 20 x planacromática, 1 objetiva PL 40 x planacromática (retrátil), 1 objetiva PL 100 x planacromática (retrátil de imersão), 1 lâmpada de LED, que proporciona melhor visualização, 1 condensador tipo ABBE 1,25 N.A. (campo claro)	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 6.483,33

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: UNESP-CAMPUS EXPERIMENTAL DE DRACENA
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DRACENA

Objeto: MICROSCÓPIOS

Descrição: MICROSCOPIO BINOCULAR COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ANTI FURTO - MICROSCOPIO, BINOCULAR BIOLOGICO, UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DE ENSINO, OCULAR PAR DE OCULARES DE 10X/20MM DE GRANDE CAMPO; FIXAS AO TUBO BINOCULAR C/SISTEMA DE FIXAÇÃO ANTI-FURTO, REVOLVER PARA DENTRO DA ESTATIVA COM 4 OBJETIVAS REVERSO COM SISTEMA DE CLICK PARA TRAVAR NA POSICAO, OBJETIVAS: PLANACROMATICAS C/CORRECAO INFINITA E TRAT. ANTI-FUNGOS: AUMENTOS 4X; 10X; 40X (RETRÁTIL) E 100X, CONDENSADOR ABBE COM ABERTURA NUMERICA 0.90/1.25 PRE-CENTRADO; P/ USO EM CAMPO CLARO C/ DIAFRAG IRIS, ILUMINACAO: ILUMINADOR ATRAVES DE LED; LUZ FRIA 60000K COM CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA, FOCO POR BOTOES BILATERAIS: MACROMETRICO; MICROMETRICO/ DIVISAO DE BILATERAIS E COAXIAIS, PLATINA MECANICA C/CHARRIOT DO LADO DIREITO MILIMETRADO C/ MOV ERGONOMICO RETANGULAR 150 X 140MM, DIMENSOES: TUBO: BINOCULAR TIPO SIEDENTOPF INCLINACAO 30 GRAUS MOVIMENTOS X E Y, ALIMENTACAO: BIVOLT AUTOMATICO, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

Data: 24/08/2022 11:17

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 102329100612022OC00071

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

10.806.205/0001-12

OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO

R\$ 2.950,00

* VENCEDOR *

LTDA



Relatório gerado no dia 25/11/2022 12:19:15 (IP: 177.74.58.82)

Código Validação: XHamiWku%2f5nMLK6rUlmNOZk45eUI7PEcuhNbHedwt1AqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=XHamiWku%252f5nMLK6rUlmNOZk45eUI7PEcuhNbHedwt1AqHU8nPtm6WA%253d%253d>

25 / 40

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

Descrição: MICROSCOPIO, BINOCULAR BIOLÓGICO, UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DE ENSINO, OCULAR PAR DE OCULARES DE 10X/20MM DE GRANDE CAMPO; FIXAS AO TUBO BINOCULAR C/SISTEMA DE FIXAÇÃO ANTI-FURTO, REVOLVER PARA DENTRO DA ESTATIVA COM 4 OBJETIVAS REVERSO COM SISTEMA DE CLICK PARA TRAVAR NA POSICAO, OBJETIVAS: PLANACROMATICAS C/CORRECAO INFINITA E TRAT. ANTI-FUNGOS: AUMENTOS 4X; 10X; 40X (RETRÁ TIL) E 100X, CONDENSADOR ABBE COM ABERTURA NUMERICA 0.90/1.25 PRE-CENTRADO; P/ USO EM CAMPO CLARO C/ DIAFRAG IRIS, ILUMINACAO: ILUMINADOR ATRAVES DE LED; LUZ FRIA 60000K COM CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA, FOCO POR BOTOES BILATERAIS: MACROMETRICO; MICROMETRICO C/ DIVISAO DE BILATERAIS E COAXIAIS, PLATINA MECANICA C/CHARRIOT DO LADO DIREITO MILIMETRADO C/ MOV ERGONOMICO RETANGULAR 150 X 140MM, DIMENSOES: TUBO: BINOCULAR TIPO SIEDENTOPF INCLINACAO 30 GRAUS MOVIMENTOS X E Y, ALIMENTACAO: BIVOLT AUTOMATICO, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

07.752.137/0001-41 TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA

R\$ 8.000,00

Descrição: MICROSCOPIO, BINOCULAR BIOLÓGICO, UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DE ENSINO, OCULAR PAR DE OCULARES DE 10X/20MM DE GRANDE CAMPO; FIXAS AO TUBO BINOCULAR C/SISTEMA DE FIXAÇÃO ANTI-FURTO, REVOLVER PARA DENTRO DA ESTATIVA COM 4 OBJETIVAS REVERSO COM SISTEMA DE CLICK PARA TRAVAR NA POSICAO, OBJETIVAS: PLANACROMATICAS C/CORRECAO INFINITA E TRAT. ANTI-FUNGOS: AUMENTOS 4X; 10X; 40X (RETRÁ TIL) E 100X, CONDENSADOR ABBE COM ABERTURA NUMERICA 0.90/1.25 PRE-CENTRADO; P/ USO EM CAMPO CLARO C/ DIAFRAG IRIS, ILUMINACAO: ILUMINADOR ATRAVES DE LED; LUZ FRIA 60000K COM CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA, FOCO POR BOTOES BILATERAIS: MACROMETRICO; MICROMETRICO C/ DIVISAO DE BILATERAIS E COAXIAIS, PLATINA MECANICA C/CHARRIOT DO LADO DIREITO MILIMETRADO C/ MOV ERGONOMICO RETANGULAR 150 X 140MM, DIMENSOES: TUBO: BINOCULAR TIPO SIEDENTOPF INCLINACAO 30 GRAUS MOVIMENTOS X E Y, ALIMENTACAO: BIVOLT AUTOMATICO, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

05.230.436/0001-90 MCIENTIFICA EIRELI

R\$ 8.500,00

Descrição: MICROSCOPIO, BINOCULAR BIOLÓGICO, UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DE ENSINO, OCULAR PAR DE OCULARES DE 10X/20MM DE GRANDE CAMPO; FIXAS AO TUBO BINOCULAR C/SISTEMA DE FIXAÇÃO ANTI-FURTO, REVOLVER PARA DENTRO DA ESTATIVA COM 4 OBJETIVAS REVERSO COM SISTEMA DE CLICK PARA TRAVAR NA POSICAO, OBJETIVAS: PLANACROMATICAS C/CORRECAO INFINITA E TRAT. ANTI-FUNGOS: AUMENTOS 4X; 10X; 40X (RETRÁ TIL) E 100X, CONDENSADOR ABBE COM ABERTURA NUMERICA 0.90/1.25 PRE-CENTRADO; P/ USO EM CAMPO CLARO C/ DIAFRAG IRIS, ILUMINACAO: ILUMINADOR ATRAVES DE LED; LUZ FRIA 60000K COM CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA, FOCO POR BOTOES BILATERAIS: MACROMETRICO; MICROMETRICO C/ DIVISAO DE BILATERAIS E COAXIAIS, PLATINA MECANICA C/CHARRIOT DO LADO DIREITO MILIMETRADO C/ MOV ERGONOMICO RETANGULAR 150 X 140MM, DIMENSOES: TUBO: BINOCULAR TIPO SIEDENTOPF INCLINACAO 30 GRAUS MOVIMENTOS X E Y, ALIMENTACAO: BIVOLT AUTOMATICO, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 6.483,33

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: UNESP-CAMPUS EXPERIMENTAL DE DRACENA
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DRACENA

Objeto: MICROSCÓPIOS

Descrição: MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLÓGICO DE CAMPO CLARO AULAS PRÁTICAS ENSINO - MICROSCOPIO, BINOCULAR; BIOLÓGICO DE CAMPO CLARO, UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DE ENSINO, OCULAR FIXAS AO TUBO; 10X COM CAMPO MINIMO DE 20MM; COM AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES, REVOLVER PARA QUATRO POSICOES (QUADRUPLA), OBJETIVAS: PLANACROMATICAS: 4X/0.1/25; 10X/0.25/6,5; 40X/0.65/0.6; 100X/1.25/0.135 (OLEO DE IMERSAO), CONDENSADOR FIXO E ABERTURA NUMERICA DE 1.25, ILUMINACAO: LED, FOCO MACROMETRICO E MICROMETRICO EM AMBOS OS LADOS, PLATINA DE CHARRIOT MANUAL COM MOVIMENTACAO 76MM (PLANO X) POR 30 MM (PLANO Y) COM SUPORTE DE LAMINA, ALIMENTACAO: AC 100/240 V; 50-60HZ; COM CABO DE ALIMENTACAO PADRAO BRASILEIRO, ACOMPANHA CAPA DE PROTECAO; SETA EM UMA DAS OCULARES; TRATAMENTO ANTI-MOFO, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

Data: 24/08/2022 11:17

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 102329100612022OC00071

Lote/Item: 1/3

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

10.806.205/0001-12 OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO
* VENCEDOR * LTDA

R\$ 2.950,00

Descrição: MICROSCOPIO, BINOCULAR; BIOLÓGICO DE CAMPO CLARO, UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DE ENSINO, OCULAR FIXAS AO TUBO; 10X COM CAMPO MINIMO DE 20MM; COM AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES, REVOLVER PARA QUATRO POSICOES (QUADRUPLA), OBJETIVAS: PLANACROMATICAS: 4X/0.1/25; 10X/0.25/6,5; 40X/0.65/0.6; 100X/1.25/0.135 (OLEO DE IMERSAO), CONDENSADOR FIXO E ABERTURA NUMERICA DE 1.25, ILUMINACAO: LED, FOCO MACROMETRICO E MICROMETRICO EM AMBOS OS LADOS, PLATINA DE CHARRIOT MANUAL COM MOVIMENTACAO 76MM (PLANO X) POR 30 MM (PLANO Y) COM SUPORTE DE LAMINA, ALIMENTACAO: AC 100/240 V; 50-60HZ; COM CABO DE ALIMENTACAO PADRAO BRASILEIRO, ACOMPANHA CAPA DE PROTECAO; SETA EM UMA DAS OCULARES; TRATAMENTO ANTI-MOFO, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

07.752.137/0001-41 TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA

R\$ 8.000,00



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

Descrição: MICROSCOPIO, BINOCULAR; BIOLÓGICO DE CAMPO CLARO, UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DE ENSINO, OCULAR FIXAS AO TUBO; 10X COM CAMPO MINIMO DE 20MM; COM AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES, REVOLVER PARA QUATRO POSICOES (QUADRUPLA), OBJETIVAS: PLANACROMATICAS: 4X/0.1/25; 10X/0.25/6,5; 40X/0.65/0.6; 100X/1,25/0,135 (OLEO DE IMERSAO), CONDENSADOR FIXO E ABERTURA NUMERICA DE 1.25, ILUMINACAO: LED, FOCO MACROMETRICO E MICROMETRICO EM AMBOS OS LADOS, PLATINA DE CHARRIOT MANUAL COM MOVIMENTACAO 76MM (PLANO X) POR 30 MM (PLANO Y) COM SUPORTE DE LAMINA, ALIMENTACAO: AC 100/240 V; 50-60HZ; COM CABO DE ALIMENTACAO PADRAO BRASILEIRO, ACOMPANHA CAPA DE PROTECAO; SETA EM UMA DAS OCULARES; TRATAMENTO ANTI-MOFO, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

05.230.436/0001-90 MCIENTIFICA EIRELI

R\$ 8.500,00

Descrição: MICROSCOPIO, BINOCULAR; BIOLÓGICO DE CAMPO CLARO, UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DE ENSINO, OCULAR FIXAS AO TUBO; 10X COM CAMPO MINIMO DE 20MM; COM AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS AS OCULARES, REVOLVER PARA QUATRO POSICOES (QUADRUPLA), OBJETIVAS: PLANACROMATICAS: 4X/0.1/25; 10X/0.25/6,5; 40X/0.65/0.6; 100X/1,25/0,135 (OLEO DE IMERSAO), CONDENSADOR FIXO E ABERTURA NUMERICA DE 1.25, ILUMINACAO: LED, FOCO MACROMETRICO E MICROMETRICO EM AMBOS OS LADOS, PLATINA DE CHARRIOT MANUAL COM MOVIMENTACAO 76MM (PLANO X) POR 30 MM (PLANO Y) COM SUPORTE DE LAMINA, ALIMENTACAO: AC 100/240 V; 50-60HZ; COM CABO DE ALIMENTACAO PADRAO BRASILEIRO, ACOMPANHA CAPA DE PROTECAO; SETA EM UMA DAS OCULARES; TRATAMENTO ANTI-MOFO, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 4.954,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MUNICIPIO DE GOIANA / (1) MUNICIPIO DE GOIANA

Data: 15/12/2021 09:00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: Nº Licitação: 911943

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/12/2021 11:36

Homologação: 21/12/2021 11:36

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 5

UF: PE

Descrição: MICROSCOPIO - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO Microscópio biológico binocular /Objetivas 4X, 10X, 40X, 100X

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA

R\$ 3.500,00

Descrição: Lote 03) MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO Microscópio biológico binocular /Objetivas 4X, 10X, 40X, 100X Quantidade: 05 Unidades Marca/Fabricante: ANATOMIC MODELO: TIM 18 P.U. R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) P.T. R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais) VALOR TOTAL DO LOTE 03 R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais). Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Validade de Proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

R\$ 4.962,00

Descrição: 5 Unid MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO Microscópio biológico binocular /Objetivas 4X, 10X, 40X, 100X COLEMAN N107/BAT

N. C. CARVALHO EIRELI ME

R\$ 6.400,00

Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS Marca: Brax Tecnologia Referência: BTM-02-B Função: Este Microscópio foi projetado com as mais novas tecnologias existentes. Seu desenho moderno é fruto de intensa pesquisa para produção de equipamentos que privilegiam a ergonomia e conforto do usuário. Seus componentes de primeira qualidade, garantem resultados confiáveis tanto em laboratório de análises clínicas quanto em pesquisas acadêmicas. Características: Microscópio Biológico Binocular com Objetivas Planacromáticas. Aumento: 40-1.000x; (1.600x com a utilização da Ocular de 16x Opcional não inclusa). Cabeça: Binocular Siedentopf de 160mm, inclinação de 30°, giro de 360° com ajuste de dioptria no lado esquerdo de + 5di e tratamento anti-fungo; Distância interpupilar: 48-75 mm; Ocular: WF 10x/18mm; Objetivas planacromáticas: 4x/0.10; 10x/0.25; 40x/0.65 (retrátil); 100x/1,25 (retrátil) (imersão / óleo); Revolver: Quádruplo Reverso; Platina Dupla: 140x135mm com charriot graduado, área de trabalho de 50x75mm e controle coaxial; Condensador: ABBE 1,25 N.A ajustável; Diafragma: Íris com suporte para filtro; Filtro: Azul 32mm; Iluminação: LED 3W Equivalente à Lâmpada de halogênio 6V/20W. Possui controle de luminosidade; Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado em botões bilaterais. Trava mecânica para proteção contra quebra de lâminas; Alimentação: Bivolt Automático. Embalagem: Caixa de papelão e isopor; Acompanha: Frasco com Óleo de Imersão, um fusível reserva, capa plástica e Manual de Instruções em Português; Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Acessórios Opcionais não inclusos: Oculares de 16x, Cabeçote Trinocular, Objetivas Semi-Plana cromáticas, Objetivas Plana cromáticas, Seta para Ocular, Campo Escuro. ***EM CASO DE LICITAÇÃO, VERIFICAR O DESCRITIVO DA PROPOSTA, SE ESTIVER DESCRITO QUALQUER DOS OPCIONAIS ACIMA COMO INCLUSO, CONSIDERAR QUE SERÁ ENTREGUE COM O OPCIONAL***



Item 10: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO.

Preço Estimado: R\$ 38.500,00 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 38.500,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 38.500,00

Quantidade	Descrição	Observação
45 Unidades	Especificação : Com bateria interna de lítio, com duração mínima de 90 minutos, para a monitoração dos seguintes parâmetros e sinais vitais: ECG, RESP(Respiração), SpO2 (Saturação de Oxigênio), PNI (Pressão Não Invasiva), e Débito Cardíaco; Deve possuir tela de cristal líquido colorida (LCD), sensível ao toque de, pelo menos, 12"(polegadas); Deve permitir a execução de cálculos de parâmetros hemodinâmicos; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros; Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 72 horas; Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo), com níveis de prioridade estabelecidos (baixo, médio e alto), e alarmes funcionais relacionados ao monitor multiparamétrico e seus acessórios (sensor, eletrodo solto, etc.); Deve permitir possibilidade de conexão a uma Central de Monitorização. Especificações dos parâmetros de monitoração: ECG - Monitoração em 7(sete) Derivações (I, II, III, aVF, aVR, aVL, V) através de um Cabo de ECG 5 (cinco) Vias; Faixa de medida da Frequência Cardíaca (FC): 30 a 300 BPM; Resolução da medida de FC: 1 BPM; Deve possuir Análise de Segmento ST em todas as derivações de forma simultânea; Deve possuir pelo menos 20 Análises de Arritmias (Assistolia, Fibrilação Ventricular / Taquicardia Ventricular, Fib Atrial, etc.), detecção automática de pulso Marca Passo Deve monitorizar parâmetros de QT/QTc com cabo de 05 ou 06 vias no máximo Acessórios: 1 (um) cabo de ECG 5 ou 6 vias. RESPIRAÇÃO - Aquisição da Frequência Respiratória através da tecnologia de Impedância Transtorácica, feita pelo Cabo de ECG; Faixa de medida da Frequência Respiratória (FR): 6 a 100 RPM; Resolução da medida da FR: 1 RPM; Deve permitir ajuste de alarme de apnéia. OXIMETRIA (SpO2)- Deve apresentar a curva pletismográfica, Índice de perfusão com indicação gráfica e numérica; Faixa de Saturação de O2 (SpO2): Precisão entre 70% e 100% de saturação, não superior a $\pm 2\%$ Resolução da medida de SpO2: 1%; Faixa da Frequência de Pulso (FP): 40 a 300BPM; Resolução da medida de FP: 1 BPM; Acessórios: 1 (uma) extensão para sensor de SpO2, 1 (um) sensor de SpO2 reutilizável adulto; PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) - Deve apresentar os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS) de no mínimo 40 a 260mmHg Pressão Arterial Diastólica (PAD) de no mínimo 25 a 220 mmHg e Pressão Arterial Média (PAM) de no mínimo 25 a 250 mmHg; Modos de medida: Manual, Automático Acessórios: 1 (uma) extensões de ar 1 (uma) braçadeira adulto. TEMPERATURA-Deve possuir, pelo menos, 2 (dois) canais de monitoração da Temperatura; Deve permitir a medida da Temperatura por sensor aderido na pele do paciente, ou através de cavidades, como o esôfago ou reto; Faixa de medida da Temperatura: 5 a 45 °C; Acessórios: 1 (um) sensor de temperatura reutilizável tipo pele. VOLTAGEM: BIVOLT	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 41.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes

Data: 07/10/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de monitores de alta resolução para atender a Unidade de Diagnóstico por Imagem do HUCAM.

Identificação: NºPregão:1282022 / UASG:155012

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: ES

Descrição: Monitor multiparâmetro - Monitor Multiparâmetro Componentes: Bateria Recarregável, Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Tipo De Tela: Monitor Monocromático, Opcionais 02: Índice Bispectral, Tipo: Pré Configurado, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

CatMat: 405374 - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO:PRÉ CONFIGURADO, PARÂMETROS:ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, TIPO DE TELA:MONITOR MONOCROMÁTICO, COMPONENTES:BATERIA RECARREGÁVEL, OPCIONAIS 02:ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS:COMPLETO COM CABOS E SENSORES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
58.598.368/0001-83	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	R\$ 34.000,00
* VENCEDOR *		

Descrição: LG MONITOR DIAGNOSTICO - 21HK512D 3MP 21" (SINGLE) Monitor SINGLE Diagnóstico LG 21" 3MP Qualidade de Imagem para Diagnósticos Precisos: Visando garantir o sombreamento mais preciso e consistente das imagens, o monitor de diagnóstico da LG cumpre estritamente o padrão DICOM Part 14 (padrão internacional relacionado à expressão de imagens em escala de cinza), oferecendo imagens precisas e consistentes. *DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine (Comunicação de Imagens Digitais em Medicina). DICOM Part 14 O Monitor LG tem um sensor que mede a estabilidade do brilho da tela, compensando automaticamente a diferença de brilho causada pelo envelhecimento do painel e permitindo a visualização estável de exames durante toda a sua vida útil. Estabilização de Brilho DICOM Part 14: A autocalibração automaticamente detecta e ajusta as diferenças na qualidade da imagem por um sensor embutido no painel do monitor LG. Dessa forma, obtém-se uma imagem com qualidade consistente e sem custos adicionais. Com Autocalibração Convencional Color Calibrated Hardware Calibration Ready Wide Viewing Angle Auto Luminance Sensor DICOM O Monitor Diagnóstico da LG conta com recurso de pivot bidirecional que permite a rotação da tela em 90° para ambos os lados, tornando mais conveniente o uso com os softwares de diagnóstico. Resolução 3MP com 18bit LUT O Monitor Diagnóstico LG 21" 3MP oferece uma escala de cinzas mais profunda e precisa com o recurso 18bit LUT (Look Up Table) para análises mais detalhadas. *3MP(Mega Pixel): 2048 x 1536 O alto brilho de 1000nits do Monitor Diagnóstico da LG permite a visualização de imagens médicas mais vivas e detalhadas para diagnósticos precisos. Para garantir o sombreamento mais preciso e consistente das imagens, o monitor de diagnóstico da LG cumpre estritamente o padrão DICOM Part 14 (padrão internacional de expressão de imagens em escala de cinza), entregando imagens precisas e consistentes. *DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine (Comunicação de Imagens Digitais em Medicina). DICOM Part 14 * Conforto de Visão O recurso Flicker Safe minimiza o cansaço dos olhos ao reduzir as tremulações de luz da tela. A combinação desse recurso com a qualidade de imagem do Painel IPS faz com que os usuários possam trabalhar ao longo do dia com todo o conforto. Flicker Safe Placa Gráfica: Memória da GPU: mínimo de 2GB GDDR5 Interface de Memória: mínimo de 128 bits Garantia: 60 (sessenta) dias



Relatório gerado no dia 25/11/2022 12:19:15 (IP: 177.74.58.82)

Código Validação: XHamiWku%2f5nMLK6rUlmNOZk45eUI7PEcuhNbHedwt1AqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=XHamiWku%2f5nMLK6rUlmNOZk45eUI7PEcuhNbHedwt1AqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
59.269.654/0001-68	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	R\$ 44.000,00

Descrição: Modelo: Unidade / "Single" - Proteção de tela: antirreflexo - Profundidade (Bits/Pixel): mínimo de 10 bits/pixel - Proteção dos monitores: Capa de proteção externa confeccionada de corino - Calibração: padrão DICOM 14 (GSDF) - Inclinação da tela: mínimo -5° a +30° - Rotação da tela: mínimo de -40° a +40° - Ângulo de visualização: de 178° - Pivô: 90° - Modos de exibição de tela: retrato e paisagem - Ajuste da altura: regulável - Tamanho da tela (largura x altura): mínimo de 320 mm x 430 mm, cada monitor único - Tamanho do painel (diagonal): mínimo de 50 cm - Resolução (Matriz): mínima de 3 MP - Luminância calibrada DICOM: 500 cd/m2 - Luminância: mínima de 750 cd/m2 - Razão Contraste: mínimo de 1000:1 - Sensores: calibração, presença, luz ambiente - Tipo de painel do display: tecnologia IPS - Voltagem: corrente alternada | 100 - 240 V | 50 - 60 Hz. / ACESSÓRIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS (monitores monocromáticos e coloridos) - Software: controle de qualidade e calibração - Registro: registrado na ANVISA como monitores médicos (81596770002) - Guia do Usuário: Sim - Cabo de vídeo (1 x DisplayPort): Sim - Cabo USB 2.0: Sim - Fonte de alimentação: Sim - Cabos de alimentação principal e conectores: Sim - Manual: Versão original, do País de origem, explicitando qual a modalidade de imagem que o monitor atende. / PLACA GRÁFICA PARA OS MONITORES MONOCROMÁTICOS E COLORIDOS (acessório obrigatório) - Memória da GPU: mínimo de 2GB GDDR5 - Interface de Memória: mínimo de 128 bits - Interface do Sistema: PCI Express 3.0 x 16 - Entrada s Mini display Port: mínimo 2 portas - Resolução mínima: 4096x2160 @ 60Hz - Suporte API gráficas nas versões iguais ou superior: Shader Model 5.1, OpenGL 4.5, DirectX 12.0, Vulkan 1.0, CUDA, DirectCompute, OpenCL. - Altura Espelho: Compatível com gabinete Slim.

07.416.887/0001-42	DIAGITAL DIAGNOSTICOS DIGITAIS EIRELI	R\$ 45.000,00
--------------------	---------------------------------------	---------------

Descrição: Monitor Multiparâmetro Componentes: Bateria Recarregável, Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Tipo De Tela: Monitor Monocromático, Opcionais 02: Índice Bispectral, Tipo: Pré Configurado, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores.



Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

R\$ 42.000,00

Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Filial Hospital UNIVERSITÁRIO
PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO

Data: 29/07/2022 08:30

Objeto: Registro de Preços para eventual Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares (EMHs) para o Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC)..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1342022 / UASG:155913

Lote/Item: 2/17

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Monitor multiparâmetro - Componentes: Alarmes/Bateria, Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St, Tipo: Pré Configurado/Modular, Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória, Opcionais: Capnografia, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores,

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

UF: SC

CatMat: 405370 - MONITOR MULTIPARÂMETRO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 39.000,00



Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETRO MONITOR MULTIPARÂMETROS COM ECG/RESPIRAÇÃO, PNI, PI (2 CANAIS), SPO2 E TEMPERATURA (2 CANAIS) PARA USO EM PACIENTES NEONATAL E ADULTOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MONITOR MULTIPARÂMETROS: PARA USO GERAL EM PACIENTES ADULTOS E NEONATAL DEVENDO APRESENTAR OS SEGUINTE PARÂMETROS: MONITORAÇÃO DE ECG/RESPIRAÇÃO; MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA (2 CANAIS, NO MÍNIMO); MONITORAÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA; MONITORAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA (02 CANAIS, NO MÍNIMO); OXIMETRIA DE PULSO; DEVE POSSIBILITAR A EXPANSÃO FUTURA DE NO MÍNIMO OS PARÂMETROS: CAPNOGRAFIA (ETCO2), PRESSÃO INVASIVA (MAIS 04 CANAIS), DÉBITO CARDÍACO, BIS (IN DICE BIESPECTRAL), EEG; INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELÉTRICA OU BATERIA, COM AVISO DE BATERIA COM CARGA BAIXA; REGISTRADOR DE EVENTOS (ALARME, ARRITMIAS ETC.) E TENDÊNCIAS DE PELO MENOS 72 (SETENTA E DUAS) HORAS APRESENTADAS NO MONITOR; DEVE POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO, ISTO É, AO MESMO TEMPO, DE NO MÍNIMO OS SEGUINTE PARÂMETROS: ECG, SPO2, PNI, 2 TEMPERATURAS, 4 PI (PRESSÃO INVASIVA), DÉBITO CARDÍACO (CONTÍNUO / TERMO DILUIÇÃO), ETCO2, BIS E EEG; DEVE APRESENTAR DISPLAY LCD OU LED COLORIDO, TAMANHO MÍNIMO DE 12", RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1024 X 768 PIXELS, RECURSO DE ACESSO RÁPIDO ÀS FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES NA TELA ATRAVÉS DE TOUCHSCREEN (TELA SENSÍVEL AO TOQUE) COM TECNOLOGIA CAPACITIVA; DEVE PERMITIR A VISUALIZAÇÃO E CAPACIDADE PARA APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE PELO MENOS 14 CURVAS E 06 CAMPOS DIGITAIS NA TELA, SENDO O OPERADOR RESPONSÁVEL PELA ESCOLHA DOS PARÂMETROS A SEREM VISUALIZADOS, ASSIM COMO ESCOLHER AS CORES DE CADA CURVA MONITORADA; CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRAÇADO DAS CURVAS VARIÁVEIS MINIMAMENTE ENTRE 6,25, 12,5, 25 E 50MM/S. DEVE SER CONSTITUÍDO POR MONITOR, PROCESSADOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM UM ÚNICO BLOCO, COM PARÂMETROS BÁSICOS INICIAIS (ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PNI, PI E SPO2) PRÉ-CONFIGURADOS OU EM UM ÚNICO MÓDULO, PODENDO OS DEMAIS PARÂMETROS SEREM OFERECIDOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS OU COMPARTEILHADOS. DEVE POSSUIR OXICARDIORESPIROGRAMA; AS ENTRADAS DOS PARÂMETROS DEVEM POSSUIR CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORAÇÃO JÁ INSTALADA NA INSTITUIÇÃO VIA CABO DE REDE E/OU WIRELESS. INDICAÇÕES: EM FORMA DE GRÁFICOS: CURVAS - O MONITOR DEVERÁ APRESENTAR GRAFICAMENTE CURVAS (FORMAS DE ONDAS) ESCOLHIDAS PELO OPERADOR. SENDO ELAS: ECG E RESPIRAÇÃO; PLEISMOGRAMA; CAPNOGRAMA; PRESSÃO INVASIVA (2 CURVAS); TENDÊNCIAS: O MONITOR DEVERÁ APRESENTAR GRAFICAMENTE AS TENDÊNCIAS DOS PARÂMETROS MONITORADOS. NUMÉRICAS: DOS PARÂMETROS MONITORADOS: O MONITOR DEVERÁ APRESENTAR NUMERICAMENTE OS SEGUINTE PARÂMETROS, SENDO ESTES ESCOLHIDOS PELO OPERADOR; A FREQUÊNCIA CARDÍACA; A FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO; TAXA DE CO2 EXPIRADO; TEMPERATURA; AS PRESSÕES DIASTÓLICA, SISTÓLICA E MÉDIA; PRESSÕES INVASIVAS; PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA, PRESSÃO INTRACRANIANA, PRESSÃO VENOSA CENTRAL, PRESSÃO ATRIAL ESQUERDA, PRESSÃO ATRIAL DIREITA, PRESSÃO ARTERIAL PULMONAR, NO MÍNIMO. VISUAIS: O MONITOR DEVE PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DE: TABELAS E GRÁFICOS DE TENDÊNCIAS DOS PARÂMETROS MONITORADOS; CURVAS E VALORES NUMÉRICOS, MONITORADOS SIMULTANEAMENTE; ALARMES; AS FALHAS OCORRIDAS COM O SISTEMA. SONORAS: A SÍSTOLE (BATEMENTO CARDÍACO); ALARMES: ALARMES: OS LIMITES DE ALARMES DEVEM SER SELECIONADOS PELO OPERADOR. O MONITOR DEVE POSSUIR: ALARME DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA; ALARME PARA ELETRODO DE ECG SOLTTO; ALARME PARA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; ALARME PARA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO MÁXIMA E MÍNIMA; ALARME DE SENSOR DE SPO2 DESCONECTADO; ALARME PARA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA; ALARME PARA PRESSÃO NÃO-INVASIVA MÁXIMA E MÍNIMA; DIASTÓLICA E SISTÓLICA; ALARME PARA VALORES DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA. MONITORAÇÃO DE ECG; SELEÇÃO DE, NO MÍNIMO, SETE DERIVAÇÕES PELO OPERADOR (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V); FAIXA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 A 280BPM; INCERTEZA DA MEDIÇÃO: + OU - 1BPM (ENTRE 30 A 250BPM); DEVE APRESENTAR AMPLITUDES SELECIONÁVEIS: (5MM/MV (N/2) 10MM/MV (N), 20MM/MV (2N), 40MM/MV (4N)); ANÁLISE DE ARRITMIAS E TENDÊNCIA, NO MÍNIMO DE 18 ARRITMIAS; ANÁLISE DE SEGMENTO ST; ANÁLISE DE ARRITMIA SIMULTÂNEA EM NO MÍNIMO DOIS CANAIS; DETECÇÃO DE FA EM TODAS AS DERIVAÇÕES; MEDIDA DE ST EM TODAS AS DERIVAÇÕES. MONITORAÇÃO DE PRESSÃO NÃO-INVASIVA: MEDIR AS PRESSÕES DIASTÓLICA E MÉDIA, ATRAVÉS DE MÉTODO OSCILOMÉTRICO; DEVE OPERAR EM MODO MANUAL E AUTOMÁTICO COM PROGRAMAÇÃO; FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO PARA PRESSÃO; SISTÓLICA: 40 A 245MMHG, NO MÍNIMO; DIASTÓLICA: 20 A 200MMHG, NO MÍNIMO. MÁXIMA PRESSÃO ADMISSÍVEL NO MANGUITO: 300MMHG ±10%; DEVE PERMITIR MEDIDAS AUTOMÁTICAS REALIZADAS EM INTERVALOS PRÉPROGRAMADAS ENTRE 1 A 30 MINUTOS. MONITORAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA: MEDIR PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA- PAM, PRESSÃO VENOSA CENT



Descrição: Características Gerais: Ideal para a monitoração de pacientes de alta complexidade em centros cirúrgicos e nas internações em unidades de terapia intensiva adulto, pediátricas e neonatais. O Monitor CSM-1501 é um monitor multiparamétrico que pode ser configurado somente com os parâmetros básicos de monitoração ou adicionar parâmetros avançados, dependendo de suas necessidades. Tal maleabilidade é possível através de nosso inovador sistema de Smart Cable, novo conceito de tecnologia modular: Quando você conecta um Smart Cable em um MULTI conector (entradas amarelas), ele detecta automaticamente o tipo de parâmetro e inicia a mensuração. A combinação de parâmetros básicos e parâmetros avançados (por meio do MULTI conector) permite uma monitorização flexível e completa para as diferentes condições do paciente. Tudo isto com uma significativa redução de custos e sem o inconveniente associado com sistemas modulares tradicionais. O equipamento possui tela de LCD colorida de alta resolução e sensível ao toque com tamanho de 12,1 polegadas, possibilitando a visualização de até 14 curvas na mesma simultaneamente. Tela específica de OCG (Oxygen Cardiorespirogram) para viabilizar monitoração neonatal. PWTT: método de monitoração ininterrupta para detecção de grandes variações da pressão arterial, que leva em conta a correlação entre o espaço de tempo do pico da onda R e o início da onda de SpO2, fazendo assim, uma mensuração automática de PNI. Armazena até 72 horas de todas as curvas e parâmetros com sistema de Full Disclosure. Permite interligação de até 20 monitores sem a necessidade de conexão a uma central. Possibilidade de conexão com central de monitorização e telemetria. Permite comunicação RS232, HDMI, RJ-45, USB e Cartão de Memória. Possui os seguintes parâmetros básicos: ECG/r espiração, SpO2, PNI e Temperatura. A expansão dos parâmetros pode ser feita através de um inovador sistema de multiconectores, cuja quantidade pode ser configurada através da escolha da Unidade de Entrada (Input Unit), com 1 ou 3 multiconectores; e Unidade de Expansão (Smart Unit) com 2 ou 4 multiconectores. Assim, permitindo diversos parâmetros adicionais além dos básicos. Parâmetros Avançados (configuração opcional): Pressão Invasiva, Débito Cardíaco, Capnografia mainstream, respiração através de termistor, dual SpO2, FiO2, BIS, APCO, Agentes Anestésicos e Fluxo/Paw. Soquete para comunicação com dispositivos externos, como balão intra-aórtico, desfibrilador, entre outros. Grau de proteção contra entrada nociva de água: IPX1.



R\$ 40.333,33

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

Data: 06/05/2022 08:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares para atender as necessidades da Casa de Saúde de Santa Izabel do Município de Santa Izabel do Oeste – PR, para um período de 12 (doze) meses, com recursos Estadual provenientes do Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de equipamentos para Hospitais Municipais e Fundações Públicas Municipais provenientes da Resolução da SESA nº 935/2021 e recursos próprios.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:332022 / UASG:987851

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

Descrição: Monitor multiparâmetro - Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado/Modular, Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória, Componentes: Alarmes/Bateria, Opcionais: Capnografia, Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

CatMat: 405370 - MONITOR MULTIPARÂMETRO

26.749.239/0001-52 SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

R\$ 40.000,00

Descrição: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM CAPNOGRAFIA Monitor multiparamétrico com tela integrada de 12 a 15 polegadas com controles e ajustes através de tela sensível ao toque. Parâmetros Básicos: pré-configurados ou disponíveis através de módulo. Deve possibilitar monitoração de no mínimo 12 curvas em tela para pacientes adulto, pediátrica e neonatais, além de possuir um temporizador para contagem de tempo em minutos e segundos. Possuir armazenamento de no mínimo 24 horas de tendências gráficas e numéricas com revisão dos valores. Apresentar retrospecto de uma derivação de ECG em "full-disclosure". Capaz de realizar aquisição de ECG de 12 derivações e imprimir o exame. Apresentar ainda monitoração remota de outros monitores (mínimo vinte) integrado à rede para supervisão de outro paciente. Possibilidade de uso através do controle remoto. Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros. Deve se conectar à rede do hospital (obrigatoriamente). Capacidade de comunicação com outros dispositivos médicos, monitores hemodinâmicos, ventiladores, etc. Bateria recarregável com autonomia mínima de 45 minutos. Características técnicas mínimas dos parâmetros: ECG: 3, 7 ou 12 derivações. Faixa de leitura da F requência Cardíaca: 30 a 300bpm; Padrão de cores dos cabos de ECG: - Somente será permitido padrão IEC. Respiração (Impedância): Faixa de leitura: 0 a 150r pm; Oximetria de pulso: Tecnologia de baixa perfusão nos padrões: Nellcor, Bluepro ou Masimo SET. Deve apresentar a curva pletismográfica com o respectivo valor numérico; Deve apresentar faixa de leitura de 1 a 100%; Medição de pulso: 30 a 300bpm; Pressão Não Invasiva: Faixa de medição de 10 a 270mmHg; Temperatura: Deve ter a possibilidade de medir ao menos 02 temperaturas; Faixa de medição de 0 a 45°C. Pressão Invasiva: 2 pressões invasivas, habilitado para calibração simultânea; Faixa de medição: -40 a 300mmHg; possuir tecnologia para medição de PPV/VPP (Variação da Pressão de Pulso/Delta PP). Possibilidade de expansão para uso simultâneo de até 07 pressões invasivas; CAPNOGRAFIA: Mensuração de EtCO2 através do método mainstream / fluxo principal; Para pacientes adultos, pediátricos e neonatos; Alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente. Débito Cardíaco Contínuo: Deve usar uma das seguintes tecnologias - PICCO, FLOTRAC, SOFTWARE PRÓPRIO ou através de interface com outros monitores; Deve aceitar também Débito Cardíaco por termodiluição; BIS (Índice Bispectral): Deve permitir monitorização de BIS (Índice bi espectral) em 2 canais; Faixas de medição: BIS (Índice bi espectral) mínimo de 0 a 100 SQI (Índice de qualidade do sinal) mínimo de 0 a 100% SEF (Frequência de borda espectral) mínimo de 0,5 a 30Hz SR (taxa de supressão de sinal) mínimo de 10, 15 e 30s. Deve permitir a detecção de impedância do sensor. Transmissão Neuromuscular - TNM. Estimulação: Controle de estímulo do módulo TNM com teclas no dispositivo e em teclas virtuais no monitor; Operar 5 modos de estimulação: Single, TOF (Train Of Four), DBS, TET, PTC (Post Tetanic Count); Corrente de estímulo: 0 a 60 mA ±30% (no pico); Intervalo selecionável: incrementos de 1 Ma; Sensor de temperatura: 20,0 a 42,5 °C ±0,5 °C; EEG: Possibilidade futura de inclusão de módulo de EEG com no mínimo 08 (oi) canais; É imprescindível para economicidade da instituição que o monitor já venha pré configurado ou que acompanhe os módulos para monitorização de ECG, respiração por impedância, SpO2, PNI (pressão não invasiva), F requência de Pulso, 02 temperaturas, Pressão invasiva, Capnografia Mainstream, Débito Cardíaco Contínuo, Débito Cardíaco por Termodiluição, BIS e TNM/TOF. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Cabo de ECG de 5 vias (padrão IEC); 01 pré-cabo de ECG (cabo tronco); 01 Sensor de temperatura tipo disco pele; 01 Sensor de SpO2 tipo clip, reutilizável, tamanho infantil/adulto; 01 pré-cabo de SpO2 (cabo tronco); 01 Mangueira de ar para mensuração de PNI, tamanho adulto; 01 bateria recarregável; 01 Cabo de alimentação para rede elétrica ABNT. Os equipamentos devem ter registro na ANVISA – Ministério da Saúde; Garantia mínima de 24 meses para equipamentos e todos acessórios

42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

R\$ 40.500,00



Descrição: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM CAPNOGRAFIAMonitor multiparamétrico com tela integrada de 12 a 15 polegadas com controles e ajustes a través de tela sensível ao toque. Parâmetros Básicos: pré-configurados ou disponíveis através de módulo. Deve possibilitar monitoração de no mínimo 12 curvas em tela para pacientes adulto, pediátrica e neonatais, além de possuir um temporizador para contagem de tempo em minutos e segundos. Possuir armazenamento de no mínimo 24 horas de tendências gráficas e numéricas com revisão dos valores. Apresentar retrospecto de uma derivação de ECG em "full-disclosure". Capaz de realizar aquisição de ECG de 12 derivações e imprimir o exame. Apresentar ainda monitoração remota de outros monitores (mínimo vinte) integrada à rede para supervisão de outro paciente. Possibilidade de uso através do controle remoto. Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros. Deve se conectar à rede do hospital (obrigatoriamente). Capacidade de comunicação com outros dispositivos médicos, monitores hemodinâmicos, ventiladores, etc. Bateria recarregável com autonomia mínima de 45 minutos. Características técnicas mínimas dos parâmetros: ECG: 3, 7 ou 12 derivações. Faixa de leitura da Frequência Cardíaca: 30 a 300bpm; Padrão de cores dos cabos de ECG: - Somente será permitido padrão IEC. Respiração (Impedância): Faixa de leitura: 0 a 150rpm; Oximetria de pulso: Tecnologia de baixa perfusão nos padrões: Nellcor, Bluepro ou Masimo SET. Deve apresentar a curva pletismográfica com o respectivo valor numérico; Deve apresentar faixa de leitura de 1 a 100%; Medição de pulso: 30 a 300bpm; Pressão Não Invasiva: Faixa de medição de 10 a 270mmHg; Temperatura: Deve ter a possibilidade de medir ao menos 02 temperaturas; Faixa de medição de 0 a 45°C. Pressão Invasiva: 2 pressões invasivas, habilitado para calibração simultânea; Faixa de medição: -40 a 300mmHg; possuir tecnologia para medição de PPV/VPP (Variação da Pressão de Pulso/Delta PP). Possibilidade de expansão para uso simultâneo de até 07 pressões invasivas; CAPNOGRAFIA: Mensuração de EtCO2 através do método mainstream / fluxo principal; Para pacientes adultos, pediátricos e neonatos; Alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente. Débito Cardíaco Contínuo: Deve usar uma das seguintes tecnologias - PICCO, FLOTRAC, SOFTWARE PRÓPRIO ou através de interface com outros monitores; Deve acionar também Débito Cardíaco por termodiluição; BIS (Índice Bispectral): Deve permitir monitorização de BIS (índice bi espectral) em 2 canais; Faixas de medição: BIS (Índice bi espectral) mínimo de 0 a 100 SQI (Índice de qualidade do sinal) mínimo de 0 a 100% SEF (Frequência de borda espectral) mínimo de 0,5 a 30Hz SR (taxa de supressão de sinal) mínimo de 10, 15 e 30s. Deve permitir a detecção de impedância do sensor. Transmissão Neuromuscular - TNM. Estimulação: Controle de estímulo do módulo TNM com teclas no dispositivo e em teclas virtuais no monitor; Operar 5 modos de estimulação: Single, TOF (Train Of Four), DBS, TET, PTC (Post Tetanic Count); Corrente de estímulo: 0 a 60 mA ±30% (no pico); Intervalo selecionável: incrementos de 1 Ma; Sensor de temperatura: 20,0 a 42,5 °C ±0,5 °C; EEG: Possibilidade futura de inclusão de módulo de EEG com no mínimo 08 (oito) canais É imprescindível para economicidade da instituição que o monitor já venha pré configurado ou que acompanhe os módulos para monitorização de ECG, respiração por impedância, SpO2, PNI (pressão não invasiva), Frequência de Pulso, 02 temperaturas, Pressão invasiva, Capnografia Mainstream, Débito Cardíaco Contínuo, Débito Cardíaco por Termodiluição, BIS e TNM/TOF. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Cabo de ECG de 5 vias (padrão IEC); 01 pré-cabo de ECG (cabo tronco); 01 Sensor de Temperatura tipo disco pele; 01 Sensor de SPO2 tipo clip, reutilizável, tamanho infantil/adulto; 01 pré-cabo de SPO2 (cabo tronco); 01 Mangueira de ar para mensuração de PNI, tamanho adulto; 01 bateria recarregável; 01 Cabo de alimentação para rede elétrica ABNT. Os equipamentos devem ter registro na ANVISA - Ministério da Saúde; Garantia mínima de 24 meses para equipamentos e todos acessórios.



06.019.610/0001-13 FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 40.500,00

Descrição: Monitor multiparâmetros, tipo beira de leito, portátil, estrutura mista, possui alça inclusa para eventual transporte, utilizável em pacientes neonatal, pediátrico e adulto. Tela de cristal líquido de 12 polegadas, touch-screen, visualização de no mínimo 8 ondas simultâneas de fácil interpretação, exibição de tendências com dados gráficos e/ou numéricos, possui todos alarmes individuais visual e sonora e configuração direta do usuário para todos parâmetros e bateria. Fácil integração, software amigável e prática utilização. Aceita parâmetros futuros. Acompanha todos acessórios/sensores necessários para o completo funcionamento do aparelho e conforme solicitado no edital. Marca: WorldLife. Origem: Nacional. Mod. WL 80, tela 12". RMS 80884260002. Possui parâmetros: ECG-FC/RESP/SPO2/PNI/TEMP/PI/CAP

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 30.666,67

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS/SP

Data: 12/04/2022 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares (Ventilador pulmonar e Monitor Multiparamétrico) emenda impositiva 41/20 Lei 59/2020, e emenda parlamentar nº 08691.564000/1180-01 e 08691.564000/1200-001..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:172022 / UASG:927826

Descrição: Monitor multiparâmetro - Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré

Lote/Item: /2

Configurado/Modular, Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Registros:

Ata: Link Ata

Mínimo 8 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 15", Alta Resolução,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Características Adicionais: Conectividade De Rede, Componentes: Alarmes,

Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores, Uso: De Neonatal A Adulto

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

10.444.624/0001-51

SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

R\$ 27.000,00

* VENCEDOR *



Descrição: Monitor Multiparamétrico que pode ser utilizado em pacientes adulto, pediátricos e recém-nascidos neonatos Sistema de monitorização com Tela de Cristal Líquido Colorido TFT de 12.1" Tela sensível ao toque touch screen Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG Respiração Temperatura 2 canais Oximetria SPO2 PNI PI 2 canais Capnografia ETCO2 Mainstream Possibilidade de expansão de parâmetros Débito Cardíaco CO Débito Cardíaco Não Invasivo ICG Análise de Gases AG Índice de Nível de Consciência BIS Possibilidade de utilização de Capnografia Sidestream apenas com a troca uso de acessórios Cálculo de Dose de Medicamentos Drogas Armazenamento de informações do paciente e gerenciamento de admissões e altas Conectividade via HL7 para o interfaceamento bidirecional entre os monitores e o prontuário eletrônico do hospital HIS ou outros sistemas que conversem em HL7 Via Central de Monitorização Gravação e Impressora térmica opcionais Indicação de equipamento ligado em rede elétrica e nível de bateria Bateria de Lítio com autonomia de 2 horas com possibilidade de aumento para 4 horas Software em língua portuguesa Conformidade Classificação II de acordo com a diretiva 93/42/EEC como corrigido por 2007/47/EC TI po antichoque elétrico Classe I de acordo com IECEN 60601-1 com fonte de alimentação interna Normas de segurança elétrica atendidas IEC 60601-1 IEC 60601-2 IEC 60601-16 IEC 60601-18 IEC 60601-227 IEC 60601-230 IEC 60601-234 IEC 60601-249 IEC 60601-256 IEC 60601-261 EN 10601 EN 10603 Gabinete com proteção IPX1 contra derramamento de líquidos Alimentação elétrica Bivolt CA 110 240 V 50 60 Hz Dimensões 344 mm x 291 mm x 165 mm Peso 3,9 Kg com bateria e sem acessórios REGISTRO DO PRODUTO 80047300544



72.852.536/0001-46 L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA

R\$ 30.000,00

Descrição: O uMEC-12 é um monitor multiparamétrico sofisticado e portátil, que fornece uma solução altamente eficiente para as várias necessidades cotidianas das instituições médicas. Este monitor é versátil e facilmente adaptável para atender qualquer aplicação médica e perfil de paciente, aliado à conectividade a uma central de monitorização. Este equipamento inovador fornece tendências gráficas e tabulares de longa duração e está disponível em diversas configurações: desde a monitorização não invasiva básica até a multiparamétrica, cobrindo todos os requisitos médicos. Especificações Técnicas: Segurança Conforme as exigências da norma IEC e NBR IEC 60601, Marca CE de acordo com a MDD93/42/EEC Tamanho e Peso Dimensões: 345 mm (larg.) x 255 mm (alt.) x 160 mm (prof.) Peso: até 4,0 kg Grau de Proteção contra Ingresso de Água: IPX1 Ambiente Operacional Alimentação: 100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz Temperatura: 0 a 40 °C Umidade: 15 a 95 % (não condensado) Tipos de Paciente Adulto, Pediátrico e Neonato Especificações de Desempenho Tela: TFT Colorida de 12,1 polegadas Resolução: 800 x 600 pixels Traçado: até 8 formas de onda (esse no. é aumentado através da Tela Multiderivações) Velocidade de Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s Indicadores: Alarme, Alimentação, Bateria, Bip de QRS e Alarme Sonoro Rede: Conexão com ou sem fio (wireless; opcional) à Central de Monitorização Bateria: Lítio 11,1 V, 2,5 Ah, recarregável, até 4 horas em funcionamento contínuo Tempo de Tendência: 120 horas Alarme: Sonoro (10 níveis) e Visual, para todos os parâmetros e situações Saída VGA: SIM Registrador opcional: Embutido, Térmico, 3 canais Papel para Registro: 50 mm Velocidade de Registro: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s ECG Cabo: 3 ou 5 Vias Derivações: I, II, III (Cabo 3 Vias) ou I, II, III, aVR, aVL, aVF, V (Cabo 5 Vias) Forma de Onda de ECG: 2 canais (padrão; pela Tela Multiderivações, é possível exibir todas as derivações disponíveis) Seleção de Ganho: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; Auto Velocidade de Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s Faixa de Frequência Cardíaca: Adulto: 15 a 300 bpm; Pediátrico e Neonatal: 15 a 350 bpm Exatidão: 1 bpm ou 1% (o que for maior) Resolução: 1 bpm Proteção: Suporta uma tensão de 4000 VAC / 50 Hz; isolamento contra interferência eletrocirúrgica e desfibrilação Taxa de Rejeição em Modo Comum (CMRR): Modo Diagnóstico: >= 90 dB; Modo Monitor, Modo Cirurgia e Modo ST: >= 105 dB Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia Resposta de Frequência (Largura da Faixa): Diagnóstico: 0,05 a 150 Hz; Monitor: 0,5 a 40 Hz; Cirurgia: 1 a 20 Hz; Modo ST: 0,05 a 40 Hz Escala do Sinal: 1 mV ±5% Faixa de Alarme: 15 a 350 bpm Detecção de Marcapasso: SIM Detecção do Segmento ST: SIM Faixa de Medida: -2,0 mV a 2,0 mV Análise de Arritmia: SIM Respiração Método: Impedância Torácica Faixa de medida da Frequência Respiratória: Adulto e Pediátrico: 0 a 120 rpm; Neonato: 0 a 150 rpm Resolução: 1 rpm Exatidão: 0 a 6 rpm; sem especificação; 7 a 150 rpm: ±2 rpm ou ±2% (o que for maior) Alarme de Apnéia ajustável Pressão Não Invasiva (PNI) Método: Oscilométrico Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo (STAT) Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média Faixa de Medida: Adulto: 10 a 290 mmHg; Pediátrico: 10 a 240 mmHg; Neonato: 10 a 140 mmHg Proteção contra sobrepressão: SIM Resolução: 1 mmHg Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI SP10 Temperatura (Superficial e Intracavitária) Canal: 2 canais Faixa de Medida: 0 a 50 °C Resolução: 0,1 °C Exatidão: ±0,1 °C (sem incluir o sensor) SpO2 Mindray Faixa de Medida: 0 a 100% Resolução: 1% Precisão: 0 a 69: sem especificação; 70 a 100%: ±3% (neonatos); 70 a 100%: ±2% (adultos / pediátricos) Faixa de Frequência de Pulso: 20 a 300 bpm Resolução: 1 bpm Exatidão: ±3 bpm Pressão Invasiva (PI) 02 (dois) canais simultâneos Faixa de Medida: -50 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg Precisão: +2% ou +1 mmHg, o que for maior Taxa de Atualização: 1 segundo Possibilidades de Medida: PA, Ao, PAU, PAB, PAF, Art, PVC, PAE, PAD, PIC, PVU, LV, P1 a P4. Capnografia: (CO2) Faixa de Medida: 0 a 20% ou 0 a 152 mmHg Faixa de Resp.: 0 a 150 rpm Tempo de resposta: Para Neonatos <4,5 s a 90 ml/min; Para Adultos <5,5 s a 120 ml/min Acessórios conforme o edital em especificação e quantidade Demais detalhes do descritivo estão em proposta e catálogo.

14.365.637/0001-96 NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

R\$ 35.000,00

Descrição: Monitor Multiparametro Especificações detalhadas em Anexo. Modelo: BSM-3562 Marca: Nihon Kohden Fabricante: Nihon Kohden Corporation RM S: 80914690021 Procedência: Importado - Japão



Item 11: VENTILADOR PULMONAR


Preço Estimado: R\$ 66.988,56 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 66.988,56

Média dos Preços Obtidos: R\$ 66.988,56

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Especificação: Ventilador mecânico pulmonar micro processado, com monitor gráfico de ventilação LCD colorido sensível ao toque de no mínimo 12 polegadas, destinado a beira de leito e ao transporte intra-hospitalar de pacientes adultos, pediátricos, neonatais deve operar por rede de O2 e gerar o ar comprimido por sistema de turbina ou compressor. O ventilador deve possuir sistema de auto teste para detecção de vazamento no circuito respiratório bem como medir a complacência e resistência do circuito para maior precisão de leitura deve possuir válvulas (insp e exp) protegidas internas ao equipamento totalmente autoclaváveis inclusive sensor de fluxo. Deve possuir sensibilidade de disparo a fluxo ou a pressão com resolução de 0,1 em toda a faixa de ciclagem a fluxo com ajuste manual nas modalidades que permitam a utilização da pressão de suporte blender de O2 eletrônico interno, com calibração do sensor de oxigênio deve possuir ajuste de alarmes e deverá armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados quando o aparelho for colocado em modo de espera (stand-by) deve possuir baterias internas com autonomia de no mínimo 120 minutos, braço articulado para suporte do circuito respiratório. Modos de ventilação: VCV - ventilação controlada a volume PCV - ventilação controlada a pressão PRVC - pressão controlada com garantia de volume corrente SIMV/VC+PS - ventilação mandatória intermitente sincronizada a volume controlado, associada a pressão de suporte SIMV/PC+PS - ventilação mandatória intermitente sincronizada a pressão controlada, associada a pressão de suporte APRV - ventilação com dois níveis de pressão (pressão baixa e pressão alta), ciclada a tempo e que permite ao paciente respirar em qualquer fase do ciclo respiratório, permitindo também a inversão de relação i.e BINIVEL, BILEVEL, DUOLEVEL ou similar - ventilação com dois níveis de pressão (pressão baixa e pressão alta), ciclada a tempo e que permite ao paciente respirar em qualquer fase do ciclo respiratório, associada a pressão de suporte PSV - pressão de suporte e ventilação não invasiva nos modos PSV e PC, com compensação automática de fuga. Modo ou recurso ventilatório que permita a transição automática entre a ventilação espontânea e controlada de acordo com a mecânica pulmonar do paciente. HFNC - terapia de alto fluxo ventilador com ajuste do tempo de apneia de até 60 segundos, com ventilação de back-up, nos modos espontâneos, que permita o retorno automático do paciente ao modo de origem caso o paciente apresente estímulo respiratório novamente. Ajustes: frequência respiratória programável de no mínimo 01 até 100 ciclos/min tempo inspiratório programável de no mínimo 0,2 a 5,0 segundos volume corrente programável de no mínimo 20ml até 2000 ml fluxo inspiratório livre de no mínimo 200 l/min pressão controlada inspiratória ajustável de no mínimo 05 a 60 cmH2O pressão de suporte até 60 cmH2O PEEP/CPAP até 40 cmH2O concentração de oxigênio: 21 - 100% pausa inspiratória e expiratória manual de até 2,0 segundos no mínimo e ajuste de alarmes. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V. ACESSÓRIOS: 02 (dois) circuito reutilizável adulto/pediátrico/neonatal 01 (um) kit de válvula expiratória adicional ou cassete respiratório completo: 01 (uma) base móvel com rodízios e freios 01 (um) braço articulado com suporte para os circuitos respiratórios 01 (um) mangueira para O2. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 VOLTS ou Bivolt	



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 74.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

Brigada de Infantaria Paraquedista

Objeto: Aquisição de Material Permanente de Saúde, para atender ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista e suas 16 (dezesseis) Organizações Militares Diretamente Subordinadas..

Descrição: Ventilador industrial - Ventilador pulmonar de transporte com sistema inteligente de alarme, bateria com 6 a 7 horas de autonomia, com monitor completo de ventilação com gráficos e valores numéricos, atende paciente neonatal, pediátrico e adulto, com modos ventilatórios: VCV, PCV, PLV, V-SIMV + PS, P-SIMV + PS, DualPAP/APRV, CPAP/PSV E VNI. Possui display sensível ao toque 5,7", fonte elétrica bivolt, conexão padrão DISS, volume corrente de 20 a 2500 ml, frequência respiratória de 0 a 150 rpm, fluxo inspiratório 0 a 150l/min, 5 a 80% de ciclagem por fluxo, curva de monitorização P_{XT}, F_{XT} e V_{XT}/SpO₂/CO₂. Volume expirado e inspirado, FiO₂, complacência dinâmica, PEEP intrínseca, resistência, pressão de O₂, consumo de O₂, EtCO₂, CO₂, SpO₂, frequência cardíaca, índice de perfusão.

CatMat: 129747 - VENTILADOR INDUSTRIAL

Data: 26/05/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:372021 / UASG:160296

Lote/Item: /74

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

03.234.021/0001-60 BRASI-RIO COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS EIRELI

R\$ 74.000,00



Descrição: VENTILADOR pulmonar Estacionário / Transporte Ventilador para assistência ventilatória e suporte respiratório para pacientes adultos, pediátrico e bebês, com tela touch screen TFT colorida de 12,1 polegadas com resolução de 1280 X 800 e ângulo de tela de 0-30 graus ajustável. Exibição na mesma tela pelo menos 4 formas de onda, suportando a mesma exibição de tela do anal respiratório, forma de onda e parâmetros de monitoramento. Aparelho com bateria para pelo menos 280 minutos de funcionamento pleno. Ventilador de controle elétrico (fonte de ar gerado pelo acionamento da turbina) para possibilidade de uso em transporte. Possibilita exportação por meio de disco flash USB dos dados do paciente, dos registros de alarme, do formulário de calibração automática e de outros dados. Os componentes da válvula de segurança inspiratória e válvula de segurança expiratória deverão possibilitar desmontagem manual para serem esterilizadas por alta temperatura e vapor de alta pressão (134 °C) para prevenir infecção cruzada. 2.1 Modo e função respiratória 2.1 modo de configuração padrão: cinco modos de ventilação: V-A / C, v-simv, P-A / C, P-SIMV e CPAP / PSV 2.2 Possibilidade de Atualização para inclusão dos modos avançados: ventilação de pressão positiva das vias aéreas de nível duplo duvent, ventilação controlada por volume regulada por pressão adaptativa (PRVC, prvc-simv), ventilação de liberação de pressão APRV, ventilação de suporte de pressão - ventilação autônoma / controlada por tempo psv-s / T, suporte de volume ventilação vs. 2.3 outras funções: oxigenação, oxigenoterapia, aspiração de escarro, atomização, manutenção inspiratória, manutenção expiratória, respiração manual, função de suspiro, função derivada de dióxido de carbono expiratória final opcional, ferramenta P-V, ferramenta de recrutamento pulmonar e outras funções. 2.4 função de compensação de intubação inteligente automática pode ser selecionada. A intubação endotraqueal com diferentes aberturas pode ser selecionada. O ventilador pode ajustar automaticamente a pressão de suprimento de ar para manter a pressão no final da intubação consistente com o valor de configuração de pressão do ventilador. 2.5 tecnologia de sincronização inteligente: de acordo com as características pulmonares do paciente, ajuste inteligente e dinamicamente o [gatilho de expiração] para o valor ideal, melhore a sincronização homem-máquina, faça o paciente respirar mais confortável e reduza o ajuste frequente do valor de configuração do ventilador durante tratamento. 2.6 tem a função de oxigenoterapia de alto fluxo, que pode ajustar a taxa de fluxo e a concentração de oxigênio da oxigenoterapia. Possui umidificador para aquecer e umidificar o gás, para que o paciente respire com mais conforto. 2.7 A medição de peep endógeno (PE EPI) e a ferramenta P-V podem ser selecionadas para ajudar a determinar o melhor valor de peep. 2.8 ferramenta de recrutamento pulmonar opcional. Durante a ventilação mecânica, a pressão superior à pressão média convencional nas vias aéreas é administrada e mantida por um certo tempo, o que pode tornar o recrutamento alveolar mais colapsado e prevenir atelectasia secundária causada pela ventilação com baixo volume corrente. 2.9 possui uma interface de visualização pulmonar dinâmica para exibir os parâmetros dinâmicos pulmonares em tempo real de forma gráfica. 3.1 Parâmetros 3.1 volume corrente: 20ml-2200ml 3, 2 frequência respiratória: 1-100 vezes / min 3,3 frequência SIMV: 1-60 vezes / min Razão de sucção / expiração de 3,4: 4: 1-1: 10 Taxa máxima de fluxo de pico de 3,5: $\geq 210\text{L} / \text{min}$ 3,6 pressão de sucção: 5-80 cmH₂O 3,7 suporte de pressão: 0-80cmh₂o 3,8 sensibilidade do gatilho de pressão: - 0,5 - 10cmh₂o 3,9 sensibilidade de disparo de taxa de fluxo: 0,5-15l / min 3.10 fluxo de oxigenoterapia: 2 ~ 60L / min 4 Parâmetros de monitoramento 4.1 monitoramento de pressão: peep, pico de pressão das vias aéreas, pressão de platô, pressão média, etc. 4.2 ventilação exalada por minuto: monitoramento da ventilação minuto total, ventilação o minuto da respiração espontânea e ventilação minuto vazada. 4.3 Monitoramento do volume corrente: volume corrente de inalação, volume corrente de exalação e monitoramento do volume corrente de suporte. 4.4 monitoração da frequência respiratória: monitoramento da frequência respiratória total, frequência respiratória autônoma e frequência respiratória controlada por máquina. Exibição das formas de onda: pressão / tempo, taxa de fluxo / tempo, capacidade / tempo. 4.6 monitoramento da concentração de oxigênio inalado. 4.7 monitoramento de SpO₂ opcional: SpO₂ de saturação de oxigênio de pulso, monitoramento de pulso de taxa de pulso. 4.8 tem gráfico de tendência de 72 horas e armazenamento de dados da tabela de tendência. Marca : SHENZHEN COMEN ; Modelo: V3 + Pedestal ; REG ANVISA: 80047300813, POR FALTA DE ESPAÇO , PROPOSTA COMPLETA EM ANEXO



01.298.443/0002-54 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A

R\$ 75.000,00

* VENCEDOR *

Descrição: Item 74 – 3 equip. O Oxymag é um ventilador de transporte e emergência, atende desde pacientes neonatais até adultos, para medicina de urgência para atendimento em campo, em resgates via terrestre ou aérea incluindo helicópteros, no pronto atendimento hospitalar, no pós-operatório, na sala de recuperação pós-anestésica (RPA) e no transporte intra-hospitalar e inter-hospitalar. Modalidades Ventilatórias: VCV (assistida); PCV (assistida); PLV; V-SIMV+PS; P-SI MV+PS; DualPAP/APRV, CPAP/PSV; PRVC; NIV. Ajustes dos Parâmetros de Ventilação: Vol Corrente: 10 a 2500 ml; Freq Respiratória: 0 a 150 min; Tempo de Su bida (Rise Time): 0 a 2,0 s; Pausa: 0 a 70%; Pressão Limite Máx: 0 a 60 cmH₂O; Pressão Inspiratória: 1 a 60 cmH₂O; APS: OFF; 5 a 60 cmH₂O; PEEP : 0 a 40 cm H₂O; Sensibilidade Assistida (Pressão): OFF; -0,2 a -10 cmH₂O; Sensibilidade Assistida (Fluxo): OFF; 0,5 a 30,0 L/min; Ciclagem por Fluxo em Pressão de Suporte : 5 a 80%; Concentração de O₂: 35 a 100% (21 a 100% com utilização de blender externo –opcional) ; Tempo Inspiratório: 0,1 a 10 s; Forma de Onda do Fluxo Ins piratório: Quadrado, Desacelerado, Acelerado, Senoidal; CPAP: 1 a 40 cmH₂O; Pressão Superior: 1 a 60 cmH₂O; Pressão Inferior: 0 a 40 cmH₂O; Tempo Superior : 0,20 a 59,80 s; Tempo Inferior: 0,20 a 59,80 s; Relação: 1:4 a 4:1; Backup: em todas as modalidades espontâneas; Fluxo inspiratório: 0 a 180l/min; Fluxômetro d igital: 0 a 15 l/min.; Ajuste automático dos parâmetros conforme tipo de paciente. Monitor de ventilação: Curvas de Pressão x Tempo; Fluxo x Tempo; Vol. x Te mpo; Loops de Vol. x Pressão; Fluxo x Vol.; Bargraph de pressão instantânea; Pressão máxima, média e platô; PEEP e PEEP intrínseco; Vol. corrente expirado e i nspirado; Vol. Min./ espontâneo; Complacência estática e dinâmica; Resistência das vias aéreas; Tempo inspiratório e expiratório; Relação I:E; Freq. respiratória total e espontânea; FIO₂. Sistema de alarme e segurança: Válvula Antiasfixia; Válvula de Alívio de Segurança de 100 cmH₂O ; Pressão - Alarme de Alta: OFF; 1 a 80 cmH₂O; Pressão - Alarme de Baixa: OFF; 1 a 80 cmH₂O; PEEP – Alarme de Alta: OFF; 1 a 40 cmH₂O; PEEP – Alarme de Baixa: OFF; 1 a 40 cmH₂O; Vol. Min. – Alarme de Alto: OFF, 0,1 a 99 L ; Vol. Min. – Alarme de Baixa: OFF, 0,1 a 99 L; Freq. Resp. – Alarme de Alta: OFF; 1 a 150 rpm; Freq. Resp. – Alarme de Baixa: O FF; 1 a 150 rpm; Tempo de Apnéia: OFF, 5 a 60 s; Ajuste Automático dos Limites de Alarmes: OFF, 10%, 20% e 30%; Bateria Fraca; Pressão de rede baixa; Descon exão/obstrução do Circuito Resp.; S/ Rede Elétrica; Bat. Interna Li-Ion 11,8VDC; Autonomia 6,5 h; Entrada de Oxigênio – Rosca DISS macho 9/16"; Pressão do g ás: 40 a 150 psi (280 a 1035 Kpa); Dimensões: A 231mm x L 254 mm x P 185 mm; Peso: 3,25 Kg; Equip. a prova de respingos IPX4; Acessórios: 01 Kit de senso res de fluxo (adu/ped/neo) com linha de silicone do sensor de fluxo proximal; 01 Fonte elétrica 12V com conector 4 vias; 02 Válvulas expiratórias com diafragma ; 01 Circuito respiratório 1,2m completo adulto autoclavável; 02 Circuito respiratório 1,2m completo pediátrico autoclavável; 02 Circuito respiratório 1,2m compl eto neonatal autoclavável; 01 Extensão de O₂ Diss X2 – 3m; 01 Máscara para ventilação não invasiva para paciente adulto; 01 Máscara para ventilação não inv asiva para paciente pediátrico; 01 Máscara para ventilação não invasiva para paciente neonatal; 01 cabo e sensor oximetria de pulso permanente tipo clipe ault o/pediátrico; 01 Sensor oximetria permanente tipo "y" pediátrico/neonatal; 01 Simulador pulmonar adulto. Necessário resistência; 01 Simulador pulmonar pediá trico. Necessário resistência; 01 Simulador pulmonar neonatal. Necessário resistência; Suporte para fixação em maca; Pedestal com rodízios; Bolsa de transpo rte compatível com o equipamento; 01 Envelope cm 3 filtros de barreira; 01 Manual em CD e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equ ipamento Marca/Fab: Magnamed; Modelo: Oxymag; Registro MS 80659160004; Val. Proposta: 90 dias Garantia: 12 meses Prazo de entrega: 30 dias Valor Unit. R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais); Valor Total da Proposta: R\$ 225.000,00 (Duzentos e vinte e cinco mil reais).

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 60.499,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO

Data: 04/08/2022 00:00



Relatório gerado no dia 25/11/2022 12:19:15 (IP: 177.74.58.82)

Código Validação: XHamiWku%2f5nMLK6rUlmNOZk45eUI7PEcuhNbHedwt1AqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancoderecursos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=XHamiWku%2f5nMLK6rUlmNOZk45eUI7PEcuhNbHedwt1AqHU8nPtm6WA%253d%253d

Objeto: AQUISICAO EMERGENCIAL DE VENTILADOR PULMONAR VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAO DE MELGACO-MT

Descrição: VENTILADOR PULMONAR - PARA SUPORTE VENTILATORIO DE PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS,MICROPROCESSADO,CICLADO A TEMPO, VOLUME E FLUXO,EXIBIR GRAFICOS EM REMPO REAL DE NO MINIMO 3 CURVAS: PRESSAO X TEMPO, FLUXO X TEMPO E VOLUME X TEMPO,COM AJUSTES ORE-PROGRAM - VENTILADOR PULMONAR - PARA SUPORTE VENTILATORIO DE PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS,MICROPROCESSADO,CICLADO A TEMPO, VOLUME E FLUXO,EXIBIR GRAFICOS EM REMPO REAL DE NO MINIMO 3 CURVAS: PRESSAO X TEMPO, FLUXO X TEMPO E VOLUME X TEMPO,COM AJUSTES ORE-PROGRAMADOS PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS,ALIMENTACAO PNEUMATICA PO REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO,ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS PARA O DEVIDO USO

Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços

SRP: NÃO

Identificação: 510160-7-036-2022

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MT



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

12.185.306/0001-49 XMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

* VENCEDOR *

Descrição: Descrição não informada

Valor da Proposta Inicial

R\$ 60.499,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 65.966,67

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE/BA

Objeto: Eventual Contratação de Empresa para Aquisição de Equipamentos Médicos hospitalares a fim de atender as necessidades do Hospital Municipal ACM de Conceição do Jacuípe/BA, conforme informações e quantitativos constantes neste Edital e seus anexos.

Data: 09/02/2022 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 35779

Lote/Item: 4/4

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 2

Unidade: UND

UF: BA



Descrição: Ventilador mecânico (Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais - Ventilador mecânico (Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas CPAP; Ciclado a tempo e com pressão limitada; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touchscreen ou outra tecnologia similar; Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências para os principais dados monitorados. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento; Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 120 minutos; Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.)



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.187.384/0001-54 * VENCEDOR *	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 60.000,00
Descrição: Descrição não informada		
49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 61.500,00
Descrição: Descrição não informada		
01.298.443/0002-54	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	R\$ 76.400,00
Descrição: Descrição não informada		





Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - AGITADOR DE KLINE 110 VOLTS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 15/03/2022, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 27/12/2021, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 2 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BARREIRA

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/12/2021 e 13/06/2022, calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 12/08/2022, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 3 - BERÇO AQUECIDO COM SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 27/04/2022, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 14/12/2021 e 25/01/2022, calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 4 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CÚPULAS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 13/06/2022, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 25/01/2022 e 13/05/2022, calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 5 - FOCO CIRURGICO MÓVEL COM RODÍZIO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/07/2022, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 16/05/2022 e 08/07/2022, calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 6 - INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLÓGICO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 20/09/2022, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 03/06/2022, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.
- 1 preço do BPS (fonte complementar), coletado no dia 08/02/2022 00:00:00

Item 7 - INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTOCONTIDO

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/05/2022 e 23/09/2022, calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 8 - MESA CIRURGICA ELETRICA FORMATO TIPO T

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/01/2022 e 26/07/2022, calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 9 - MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR.

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 15/12/2021 e 24/08/2022, calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.



Item 10 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO.

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 12/04/2022 e 07/10/2022, calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 11 - VENTILADOR PULMONAR

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 26/05/2022, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 09/02/2022 e 04/08/2022, calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS



Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

- Capta as 3 melhores propostas iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Licitanet - Licitações on-line
licitanet.com.br

Data:
Acessar a fonte aqui

2 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 21/11/2022 11:02:39
Acessar a fonte aqui

3 - Compras MT
cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao

Data: 29/08/2022 12:35:51
Acessar a fonte aqui

4 - Bolsa Eletrônica de Compras
www.bec.sp.gov.br

Data:
Acessar a fonte aqui

5 - Banrisul
www.banrisul.com.br

Data:
Acessar a fonte aqui

6 - Licitações-E
www.licitacoes-e.com.br

Data:
Acessar a fonte aqui




Antônia de Jesus B. Gonçalves
Suplente de Vereador
Mat. 2015109
Prefeitura Municipal de Paragominas



Buscar produtos, marcas e muito mais

Enviar para Paragominas 68625245

Voltar à lista Saúde > Equipamento Médico > Materiais para Laboratório > Autoclaves Esterilizadoras

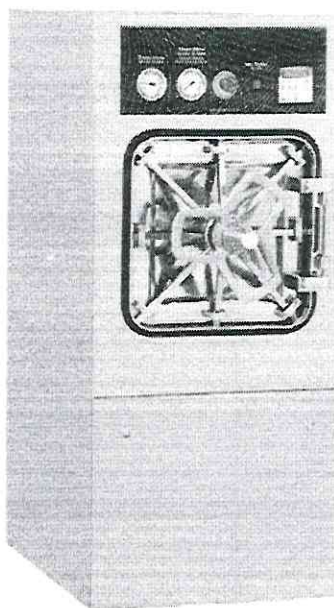

Compartilhar

Novo

Autoclave Hospitalar 200 Litros Duas Portas

R\$ 175.376³⁵

Pague em parcelas

Ver os meios de pagamento

🚚 Chegará grátis entre os dias 3

Ver mais formas de entrega

Disponível 30 dias após sua compra


Quantidade: 1 unidade ▾ (10 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

🏆 Mercado Pontos. Você acumula 431

Anúncios do vendedor



R\$ 79²⁹

6x R\$ 13,22 sem juros

Frete grátis


Eletrodo De Ecg Descartavel
Espuma Adesivo, 3m 2223



R\$ 283⁰⁶

Frete grátis

Frasco P/ Aspirador De
Secreções Nevoni 1.3 Litros...



R\$ 3.202⁶⁵

10x R\$ 320,27 sem juros

Frete grátis

Aspirador Cirúrgico 3.2 Litros
14014poc

Ver mais anúncios do vendedor

Informações sobre o vendedor

📍 Localização

São Paulo, São Paulo

🏆 MercadoLíder Gold

É um dos melhores do site

254

Vendas nos
últimos 60 dias

🗨️

Presta bom
atendimento

👤
pro

Ver mais dados deste vendedor

Garantia

Garantia do vendedor

1 ano após o recebimento do produto

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão

Cartões de crédito

Conheça outros meios de pagamento

Características principais

Marca	LUFERCO
Modelo	39209

Wania M. Clara B. Gonçalves
Suprimentos e Maxarifado
Mec. 1013409
Prefeitura Municipal de Paragominas

Descrição



Equipamento projetado e construído para ser usado em hospitais, clínicas médicas e centros de saúde para esterilização de materiais e utensílios diversos. Procedência nacional, registrado no Ministério da Saúde sob número 80004710004, elaborados com base nas normas ABNT NBR ISO 11816:2003, ABNT NBR ISO 17665-1:2010, cumpre o padrão regulatório NR-13. Fabricada e certificada de acordo com os padrões internacionais ABNT NBR ISO 9001:2008, ABNT NBR ISO 13485:2012 e GMP ANVISA (RDC 16).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Comando: Controlador microprocessado **PHA-08**
Capacidade nominal da câmara: 200 litros
Dimensões internas (AxLxP): 41x41x120 cm
Dimensões externas aproximadas (AxLxP): 170x65x150 cm

Peso **575 kg**
Tipo/Número de portas Volante Central (**2P/VC**)
Potência: 18KW
Tensão: **220 V Trifásico**
Funcionamento: Através de gerador elétrico acoplado (E)
Secagem: Bomba de vácuo de 1,5 HP 220/380V 60Hz trifásica
Instrumentos: Manovacuômetro indicativo para pressão e vácuo na câmara interna
Instrumentos: Manômetro indicativo para pressão na câmara externa (jaqueta) e gerador de vapor
Instrumentos: Dois sensores de temperatura tipo PT-100 classe 1
Instrumentos: Dois transmissores de pressão Acompanha bomba de vácuo

COMANDO

Comando automático microprocessado eletrônico, possui 8 programas de esterilização pré definidos, tais como: Pacotes; Instrumentais; Líquidos/Vidraria; Termo-Sensíveis; Teste de Bowie Dick e Ciclo Flash, mais dois programas livres totalmente alteráveis e selecionáveis pelo usuário e protegido por meio de senha para uma maior segurança. Possibilita a configuração da temperatura de trabalho de 90 a 135C e tempo de esterilização e secagem de até 99 minutos cada. A visualização dos parâmetros dos programas, fases do ciclo pressão tempo e temperatura são visualizados através de uma interface de display LCD (2 linhas x 16 colunas com fundo azul e caracteres em branco com backlight) e teclado numérico de 0 a 9 mais teclas de função. Possui entradas analógica para sensor PT-100, para controle da pressão do gerador/câmara externa e para controle de pressão e vácuo da câmara interna. Possui entradas digitais sendo porta aberta, pressostato e controle de nível do gerador de vapor alto e baixo. Possui saídas digitais a relê protegidas por fusível para controle das válvulas, bomba de água e vácuo. Possibilita a comunicação serial RS-232 para Impressora (opcional), possibilitando registro e impressão dos dados de cada ciclo realizado. A visualização dos parâmetros programada é através de display (L.C.D.), sendo que os instrumentos para controle estão dispostos em um painel superior frontal contendo:
Chave Geral interruptora com Lâmpada piloto;
Controlador digital microprocessado com teclado para seleção dos ciclos;
Manômetro indicativo de pressão na câmara externa;
Manovacuômetro indicativo de pressão e vácuo na câmara interna;

Antônia Maria B. Gonçalves
Suprimentos e Almoxarifado
Mato Grosso 15109
Prefeitura Municipal de Paragominas



CÂMARAS

Câmara interna em formato retangular com capacidade de 200 litros, fabricada em aço inoxidável AISI 316L, com acabamento polido sanitário brilhante, utilizada para a acomodação, esterilização e secagem dos materiais e câmara externa fabricada em aço inoxidável AISI 304. Testadas hidrostaticamente conforme norma NR 13. Possui isolamento térmica, através de camadas de lã de rocha aluminizada, e revestimento externo com chapas galvanizadas para evitar perda de calor e aquecimento do ambiente de trabalho. Dotada de ponto de tomada de temperatura e validação.

FECHAMENTO

Uma porta fabricada em aço inoxidável, maciça e abaulada internamente, com acabamento polido sanitário e brilhante. Comandada por volante central, tem seu fechamento hermético através da introdução de hastes de aperto nos orifícios do flange, e dotado de guarnição de silicone, que garante total vedação do vapor. Flange fabricada em chapa de aço inoxidável, com acabamento polido, brilhante. Opcionalmente o equipamento pode ser dotado de uma carenagem de proteção termo isolante na porta.

SISTEMAS DE SEGURANÇA

Trava de segurança mecânica, colocada no interior do eixo central da porta, impedindo a sua abertura quando houver pressão na câmara interna;
Válvulas de segurança para alívio imediato na câmara externa, caso a pressão ultrapassar o limite máximo de trabalho;
Válvula manual, para descarga total do vapor e pressão em caso de emergência;
Pressostato de segurança e controle na câmara externa e câmara interna;
Controle de nível e eletrodos, para controle da energia elétrica nas resistências conforme o nível de água, protegendo-as contra queima;
Registro de agulha acoplado à câmara interna para descompressão lenta e eliminação da umidade;
Registro de controle de vazão entre a câmara interna e externa para controle da injeção de vapor nos testes de Bowie Dick;

PAINEL

Com painel superior que acomoda os instrumentos de medição e controle, dotado de ventilação forçada além de acomodar o controlador do equipamento.

Antônio Alcides B. Gonçalves
Suplente do Almojarifado
Matrícula 0015109
Prefeitura Municipal de Paragominas

ESTRUTURA

Gabinete montado em armação de cantoneiras SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura esmalte.
Revestimento externo em chapas de aço inoxidável com acabamento escovado.

FUNCIONAMENTO

Através de gerador de vapor acoplado à câmara externa. Fabricado em aço inoxidável AISI 304.
Abastecido automaticamente por meio de bomba de água, com funcionamento elétrico feito através de resistências acopladas ao equipamento. Com eletrodos ou bóia para controlar o nível de água e cortar a corrente elétrica no caso de obstrução do fornecimento de água, protegendo as resistências contra queima. Externamente revestido com camadas de lã de rocha aluminizada e revestimento externo com chapas galvanizadas para evitar perda de calor e aquecimento do ambiente de trabalho.

Sistema de Vácuo: Dotado de uma bomba de vácuo para processar as operações

de pré-vácuo e secagem, por extração da umidade dos materiais esterilizados.

Carro interno de carga em aço inoxidável, com prateleira em tamanho compatível com a câmara interna. Qtde: 1,00 -

Impressora serial térmica, para registro das informações do ciclo selecionado

Carro externo, fabricado em aço carbono, com rodízios, para transporte do carro interno. (1 carro para uma porta e dois carros com 2 portas)

Manual de instruções

Disponível nos modelos de uma ou duas portas (barreira sanitária - By-pass)



Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio

Meios de pagamento

Garantia

Esta com dúvidas?

Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca

Pergunte ao vendedor

Escreva sua pergunta...

Perguntar

Últimas perguntas feitas

Tem osmose?

↳ Não opcional a entrega 30 dias 20/09/2022

Boa tarde, você teria Autoclave Hospitalar Horizontal de 100 litro ou 150 litros?

↳ Tenho 30/06/2022

Antonia Myrtila P. Gonçalves
Suprimentos e Armazenamento
Mat. N° 5109
Prefeitura Municipal de Paragominas

Anúncio #1342448:

Copyright © 1999-2022 Ebnzer.com.br LTDA.

CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Baixe grátis o app do Mercado Livre!